



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
DI CASERTA**

Determina Dirigenziale N. 8 del 03/01/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: E-Procurement della Pubblica Amministrazione - Acquisizioni in economia ai sensi dell'art.36 D.Lgs. n.50/2016 mediante RDO (richiesta di offerta) su market place Consip. RDO n.1457118 per la fornitura di n.9 letti di degenza per T.I. Cardiochirurgica - CIG ZE41C9AFA9.

Oggetto: E-Procurement della Pubblica Amministrazione - Acquisizioni in economia ai sensi dell'art.36 D.Lgs. n.50/2016 mediante RDO (richiesta di offerta) su market place Consip. RDO n.1457118 per la fornitura di n.9 letti di degenza per T.I. Cardiocirurgica - CIG ZE41C9AFA9.

Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- con nota pec del 16-02.2016 il Direttore UOC DI Cardiocirurgia di questa AORN ha trasmesso richiesta urgente di sostituzione di n.9 letti elettrici 4 sezioni di cui n. 2 con bilancia per la T.I. CCH (allegato 1);
- al riguardo, è stata attivata apposita RDO n. 1457118 su ME.PA. Consip alla quale sono state invitate n.5 società individuate, con criterio di rotazione, tra le società regolarmente iscritte al mercato elettronico categoria Beni e Servizi per la Sanità a fronte di una base d'asta pari ad € 39.950,00 (allegato 2);
- entro i termini stabiliti (ore 17:35 del 22.12.2016), sono pervenute tre offerte da parte delle ditte:
 1. Elmed Service SRL, che ha offerto n. 7 letti elettrici 4 sezioni al costo unitario pari ad € 3.996,5 oltre Iva al 22% e n. 2 letti elettrici 4 sezioni con bilancia al costo unitario pari ad € 5.985,00 oltre Iva al 22%, per un importo complessivo pari ad € **39.975,50** oltre IVA al 22% (all.n.3);
 2. Riamed SRL, che ha offerto n. 7 letti elettrici 4 sezioni al costo unitario pari ad € 4.438,39 oltre IVA al 22% e n. 2 letti elettrici con bilancia al costo unitario pari ad € 4.438,89 IVA esclusa al 22%, per un importo complessivo pari ad € **39.946,51** oltre Iva al 22% (all. n.4);
 3. Gm Medica SRL, che ha offerto n. 7 elettrici 4 sezioni al costo unitario pari ad € 4.000,00 oltre IVA al 22% e n. 2 letti elettrici 4 sezioni con bilancia al costo unitario pari ad € 5.950,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad € **39.900,00** oltre IVA al 22%;
 4. Nuova Imel SRL, risultata non conforme in quanto non ha presentato garanzia provvisoria e il prodotto offerto (senza bilancia) non è idoneo avendo un'altezza minima da terra di circa 50 cm a fronte di una richiesta di 40 cm., come da comunicazione inviata sul portale MEPA Consip;
- la ditta partecipante che ha offerto i prodotti richiesti conformi e a migliore prezzo risulta la Gm Medica per complessivi € 39.900,00 oltre IVA al 22%;
- che in data 27.12.2016 con nota prot.n.23997 è stata inviata al fornitore aggiudicatario la stipula del contratto telematico (All.7);

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
DI CASERTA

Considerato che:

- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che *“per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto....”*;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. di prendere atto della RDO n. 1457118 - CIG ZE41C9AFA9 attivata su ME.PA. Consip e di aggiudicare alla ditta Gm Medica srl con sede legale alla via Breccie A S. Erasmo n. 112/114- Napoli P.I. 05025691212, la fornitura di n. 9 letti elettrici 4 sezioni di cui n. 7 al costo unitario pari ad € 4.880,00 Iva al 22% inclusa e n. 2 letti con bilancia al costo unitario pari ad € 7.259,00 Iva inclusa al 22% per complessivi € 48.678,00 Iva inclusa al 22%;
2. di imputare la spesa complessiva pari ad 48.678,00 IVA 22% inclusa, all'autorizzazione figurativa patrimoniale n.1 del bilancio 2016, come da scheda contabile informatizzata allegata (allegato 8) ;
3. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. n.92 e n.100 del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, ed alla UOC GEF e della Progettualità Europea;
5. di pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

avv. Donato Cavallo

Da "cardiochirurgia" <cardiochirurgia@ospedalecasertapec.it>

A "provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data martedì 16 febbraio 2016 - 13:55




sostituzione letti T.I.

Allegato(i)

10081000.PDF (58 Kb)

ALLEGATO N. 1

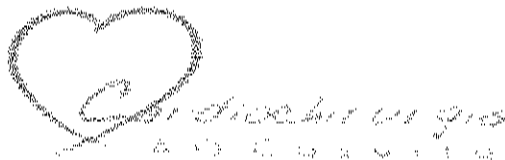

Dir. Dott. Luigi Piazza

Al Direttore della U.O. Provveditorato.

Dott. G. Cavallo

Sede

Oggetto: Richiesta urgente sostituzione letti per la T.I. CCH.

La T.I. CCH, è dotata di nove postazioni per assistenza ai pazienti nella fase post-chirurgica e spesso anche a pazienti complessi provenienti da altre unità operative prevalentemente appartenenti al dipartimento di scienze cardiologiche.

Una di queste postazioni è riservata ai pazienti con necessità di isolamento per problemi di natura settica.

La dotazione dei letti è in gran parte ancora quella originaria del Novembre 2002 (con presenza di ruggine diffusa su tutta la struttura, materassi di schiuma che hanno perso la loro elasticità e quindi inefficaci per la prevenzione delle ulcere da pressione) e ciò comporta una assistenza post-operatoria non ottimale per pazienti particolarmente delicati con talvolta lunghi periodi di allettamento in posizioni obbligate perché collegati a ventilatori in sedazione farmacologica.

E' indispensabile quindi, che si provveda con urgenza alla sostituzione dei letti oggi disponibili con altri nuovi che abbiano le seguenti caratteristiche:

la struttura del letto deve essere ricoperta di materiale plastico per una facile sanificazione, comandi ben visibili per gli operatori, un telecomando a filo per il paziente, manovra di RCP, porta bombole integrato da 5-10lt, un reggi busto per urine sia a destra che a sinistra del letto, capacità di posizionarsi a poltrona permettendo al paziente il passaggio dalla posizione seduta a quella eretta.

Il materasso deve essere a celle d'aria con movimenti alternati per la prevenzione da ulcere da pressione, coprimaterassi sostituibili.

Inoltre si rappresenta la necessità che due dei nove letti richiesti siano letti bilancia per consentire l'effettuazione della emodialisi in pazienti con insufficienza renale acuta o cronica non trasferibili neanche temporaneamente.

Si avvince chiaramente infatti, che solo con le suddette caratteristiche è possibile effettuare un'assistenza dei pazienti a noi affidati, tale da consentire di ridurre l'incidenza di ulcere da pressione, di iniziare una attività fisioterapica precoce con riduzione dei tempi di degenza e di conseguenza dei costi.

Certi di un sollecito riscontro vi porgono i più sentiti saluti.

Caserta 16/02/2016

Il Direttore

Dott. Luigi Piazza

OSPEDALE CIVILE
SAN SEBASTIANO CASERTA
U.O. DI CARDIOLOGIA
Dott. Luigi PIAZZA

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1457118
Descrizione RDO:	Fornitura 9 letti di degenza
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
Punto Ordinante	DONATO CAVALLO
Soggetto stipulante	Nome: DONATO CAVALLO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA	Non disponibile
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	donato cavallo
Data e ora inizio presentazione offerte:	19/12/2016 17:36
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	22/12/2016 17:35
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	20/12/2016 17:35
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2016 17:35
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RDO:	ARREDI104
Numero fornitori invitati:	5
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	9 letti per TI CARDIOCHIRURGIA
CIG	ZE41C9AFA9
CUP	
Dati di consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione:

	22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta	39950,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Letti degenza
Quantita'	7

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MALVESTIO
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	346860HT
3	* Nome commerciale del letto degenza	Tecnico	Valore minimo ammesso	LETTO ELETTRICO 4 SEZIONI
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Attuatori elettrici	Tecnico	Valore minimo ammesso	sì
7	Altezza dal suolo del piano di coricamento	Tecnico	Valore minimo ammesso	fissa
8	Sezioni piano di coricamento [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	4
9	Sollevamento del piano di coricamento	Tecnico	Valore minimo ammesso	ELETTRICO
10	Regolazione schienale	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
11	Regolazione sezione femorale	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
12	Regolazione sezione gambale	Tecnico	Valore minimo	SI

			ammesso	
13	Movimentazione trendelemburg e antitrendelemburg	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
14	Carico di funzionamento / Portata massima in sicurezza [kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	260KG
15	Tipologia ruote	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
16	Servizio di progettazione	Tecnico	Nessuna regola	
17	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
18	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
19	Iscrizione al repertorio del riciclaggio	Tecnico	Nessuna regola	
20	Codice CND	Tecnico	Nessuna regola	
21	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Letti degenza
Quantita'	2

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MALVESTIO
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	346860HB
3	* Nome commerciale del letto degenza	Tecnico	Valore minimo ammesso	LETTO ELETTRICO 4 SEZIONI CON BILANCIA
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo

5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Attuatori elettrici	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
7	Altezza dal suolo del piano di coricamento	Tecnico	Valore minimo ammesso	fissa
8	Sezioni piano di coricamento [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	4
9	Sollevamento del piano di coricamento	Tecnico	Valore minimo ammesso	ELETTRICO
10	Regolazione schienale	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
11	Regolazione sezione femorale	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
12	Regolazione sezione gambale	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
13	Movimentazione trendelemburg e antitrendelemburg	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
14	Carico di funzionamento / Portata massima in sicurezza [kg]	Tecnico	Valore minimo ammesso	260KG
15	Tipologia ruote	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
16	Servizio di progettazione	Tecnico	Nessuna regola	
17	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
18	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
19	Iscrizione al repertorio del riciclaggio	Tecnico	Nessuna regola	
20	Codice CND	Tecnico	Nessuna regola	
21	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
all a1	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
all a2	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
all a3	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
capitolato speciale da restituire timbrato e firmato	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
schede tecniche dei prodotti	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	9 letti per TI CARDIOCHIRURGIA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale
1	BMC TEC SRL	07699621210	07699621210
2	ELMED SERVICE SRL	04763721216	04763721216
3	GM. MEDICA SRL	05025691212	05025691212
4	NUOVA IMEL	01796140927	01796140927
5	RIAMED SRL	07763691214	07763691214

acquistinretepa.it

Il Portale degli appalti della Pubblica Amministrazione

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	1457118
Nome RDO	RDO per aggiudicazione Fornitura 9 letti di degenza
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (9 letti per TI CARDIOCHIRURGIA)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Partita IVA	02201130610
Indirizzo	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono	0823232462
Fax	0823232512
E-mail di Contatto	PROVVEDITORATO@OSPEDALE.CASERTA.IT
Punto Ordinante	CAVALLO DONATO
RUP	donato cavallo

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	ELMED SERVICE SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	04763721216
Codice Fiscale Impresa	04763721216
Provincia sede registro imprese	NA
Numero iscrizione registro imprese	04763721216
Codice Ditta INAIL	14062221
n. P.A.T.	14062221
Matricola aziendale INPS	5106
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	TERZIARIO
Indirizzo sede legale	VIA RIPUARIA 225 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Telefono	0818390018
Fax	0818390034
PEC Registro Imprese	INFO@ELMEDSRL.IT
Offerta sottoscritta da	Cestaro Raffaele
L'Offerta irrevocabile ed	31/12/2016 17:35

impegnativa fino al	
---------------------	--

OGGETTO (1 DI 2) DELL'OFFERTA	
Descrizione	Letti degenza
Metaprodotto	Letti degenza
Quantità Richiesta	7
Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Marca	Mechus
Codice Articolo Produttore	9LI3S
Nome Commerciale	Letto degenza
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unità di misura	Pezzo
Tipo contratto	Acquisto
Attuatori elettrici	
Altezza dal suolo del piano di coricamento	
Sezioni piano di coricamento [numero]	
Sollevamento del piano di coricamento	
Regolazione schienale	
Regolazione sezione femorale	
Regolazione sezione gambale	
Movimentazione trendelemburg e antitrendelemburg	
Carico di funzionamento / Portata massima in sicurezza [kg]	
Tipologia ruote	
Servizio di progettazione	
Certificazioni fornitore	
Certificazioni produttore	
Iscrizione al repertorio del riciclaggio	
Codice CND	
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	3996,5

OGGETTO (2 DI 2) DELL'OFFERTA	
Descrizione	Letti degenza
Metaprodotto	Letti degenza
Quantità Richiesta	2

Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Marca	Mechus
Codice Articolo Produttore	9LI7SR
Nome Commerciale	Letto con bilancia
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unità di misura	Pezzo
Tipo contratto	Acquisto
Attuatori elettrici	
Altezza dal suolo del piano di coricamento	
Sezioni piano di coricamento [numero]	
Sollevamento del piano di coricamento	
Regolazione schienale	
Regolazione sezione femorale	
Regolazione sezione gambale	
Movimentazione trendelemburg e antitrendelemburg	
Carico di funzionamento / Portata massima in sicurezza [kg]	
Tipologia ruote	
Servizio di progettazione	
Certificazioni fornitore	
Certificazioni produttore	
Iscrizione al repertorio del riciclaggio	
Codice CND	
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	5985

OFFERTA ECONOMICA	
VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA ECONOMICA	39945,50 trentanovemilanovecentoquarantacinque/50 /00 (Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e compresi nell'Offerta	(non specificati)
Costi della Sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta	0,00 (Euro)

dall'impresa, compresi nell'Offerta	
--	--

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
• Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 15 giorni dalla stipula • Dati di Consegna: Via tescioneCaserta - 81100 (CE) • Dati di Fatturazione: Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE) • Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo verrà spedita a: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA / CODICE FISCALE: 02201130610 • Termini di pagamento: 60 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Accettazione sopra indicata.
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore dichiara che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.


Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni

Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.


**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**




PROFESSIONISTI DEI SISTEMI DI PESATURA

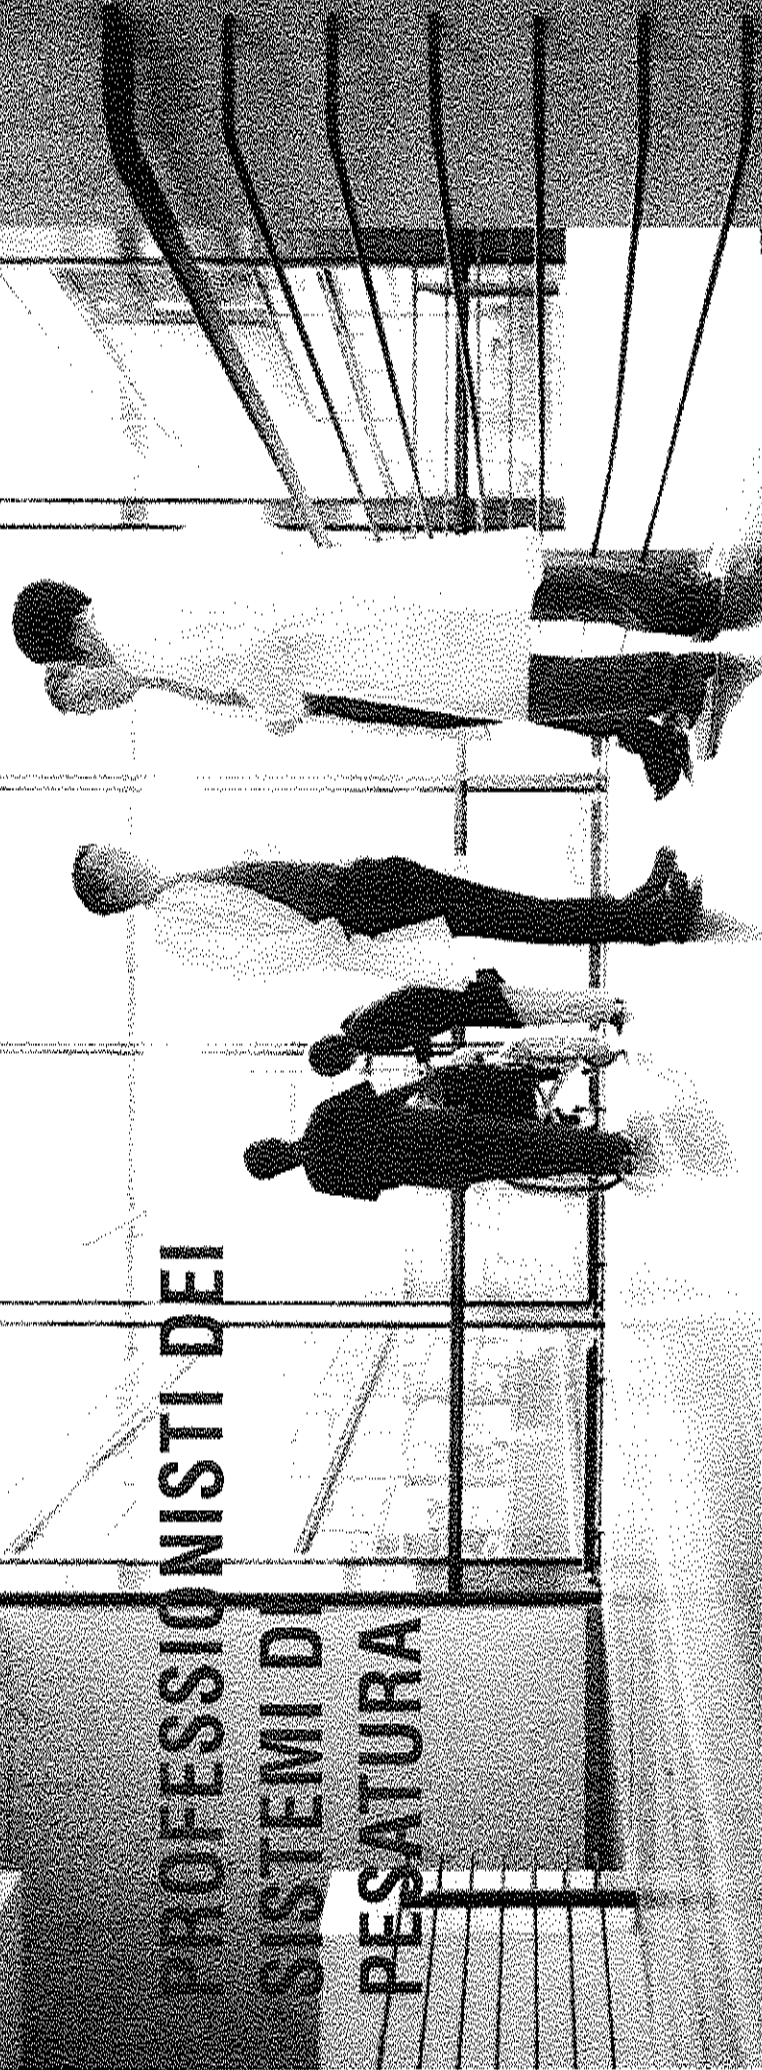

Mechus Srl - il cui nome trae origine dal Greco che inventò pesi e misura - nasce all'interno del Gruppo Italiano Favero, specializzato nel settore dell'arredo specialistico e delle attrezzature medicali.

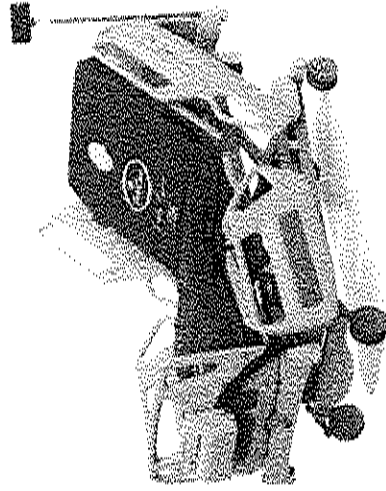

LETTI RIANIMAZIONE
CON SISTEMA DI PESATURA

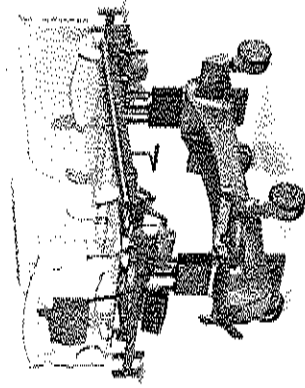


LETTI RIANIMAZIONE PEDIATRICO
CON SISTEMA DI PESATURA

INSPIRE PRECISION LETTI RIANIMAZIONE


Letto rianimazione per aree critiche dotato di sistema di pesatura a 4 celle di carico integrate nella struttura. Programma di pesatura dedicato.

Il letto Inspire Precision è un letto per dialisti, rianimazione, terapia intensiva e per centri ustionati o politraumatizzati. Questo è provvisto di una serie di caratteristiche che gli permettono di adattarsi a qualsiasi situazione clinica critica, di fornire un ambiente sano e pulito nel quale l'infermiere può prendersi cura dei pazienti.




Piano rete a 4 sezioni realizzate con elementi monoscocca stampati.

- L'inclinazione di schienale e gamba è accompagnata da una traslazione che riduce la compressione addominale e migliora il comfort del paziente.
- N. 4 SENSORI collocati nei 4 angoli (classe E3).
- Spalle realizzate con elementi monoscocca stampati, dotate di meccanismo di blocco.
- Visualizzatore elettronico del peso tramite display.
- Spalle con maniglione di spinta ergonomico, integrato.
- Tastiera a 4 tasti semplice ed intuitiva con siggratia su i tasti
- Variazione dell'altezza, Trendelenburg e contro Trendelenburg elettrici.

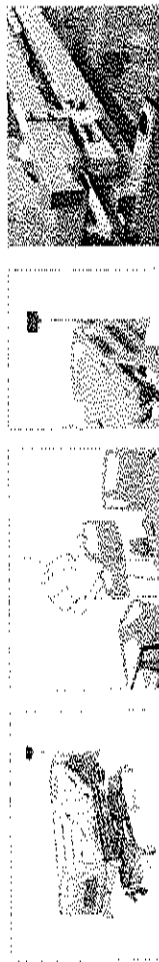

INSPIRE PRECISION CON SISTEMA ANTIDECUBITO

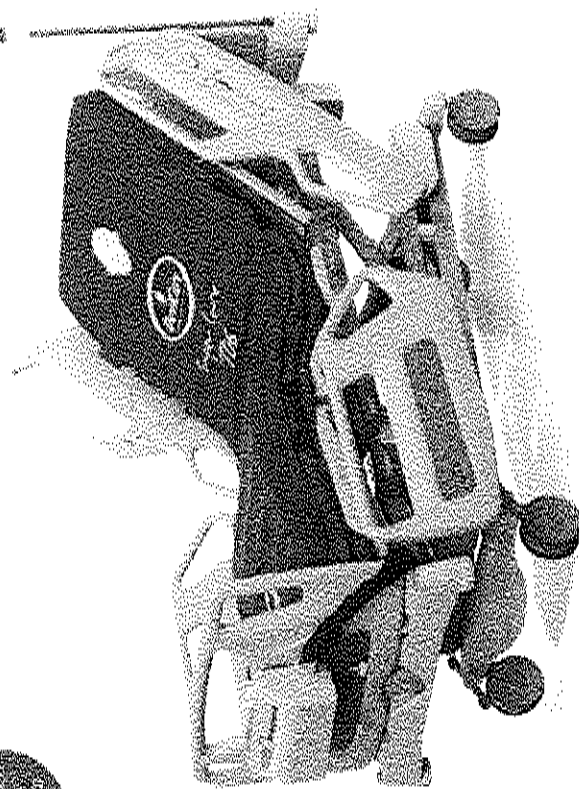

Materasso per i pazienti longodegenti con rischio medio-alto di formazione di piaghe da decubito.

composto da 18 elementi intercambiabili, di cui i 3 della testa sempre giunti, mentre gli altri 15 elementi possono funzionare in modalità ALTERNATA a 3 vie oppure STATICA in base alle indicazioni del compressore che viene utilizzata anche come funzione NURSING.

- La federa bielasica, batteriostatica Sanitized, trasparente e riduce le forze di trazione durante le fasi di allettamento e mobilitazione del paziente.
- Il telo di copertura in Nylon/PV è dotato di cerniera su 4 lati permettendo così una facile pulizia e disinfezione.
- La valvola CPR in dotazione, permette lo sgonfiaggio rapido del materasso in 10 secondi.




HORIZON 400 PRECISION


Letto pediatrico rianimazione dotato di sistema di pesatura integrato nella struttura. Programma dedicato.

Letto rianimazione provvisto di una serie di caratteristiche che gli permettono di adattarsi a qualsiasi situazione clinica critica, di fornire un ambiente sano e pulito nel quale l'infermiere può prendersi cura dei neonati.

- Sponde progettate per una facile pulizia e visibilità.
- Gradi di protezione IPX6: tutti gli attuatori elettrici sono lavabili e impediscono l'infiltrazione di acqua.
- Pannelli testaletto rimovibili per un accesso totale al piano rete di 360° gradi, con maniglie di spinta ergonomiche e 4 paracolpi angolari.
- Variazione elettrica dell'altezza, Trendelenburg e contro Trendelenburg elettrico.
- Piano rete elettrico a 4 sezioni e radiotrasparente.
- Le movimentazioni Trendelenburg e contro Trendelenburg elettriche offrono una grande flessibilità sia nel posizionamento che nella cura del paziente.



L'osservazione e il monitoraggio del paziente pediatrico sono una priorità del personale medico. Il design unico di Horizon 400 permette una totale visibilità del bambino durante la cura anche con sponde alzate. In terapia intensiva è importante avere un totale accesso al paziente, soprattutto dal lato della testa nel caso sia necessario intubarlo. Horizon 400 con pannelli testaletto rimovibili e sponde eiettriche, crea un unico piano rete con un accesso a 360° gradi. Caratteristica fondamentale per prevenire incidenti e per garantire una massima sicurezza al paziente in ogni momento.

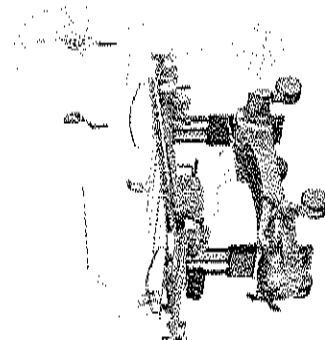


I componenti del lettino: sponde, sponde e piano rete realizzati in Plexiglas sono estremamente facili e veloci da pulire e sanificare. Possono essere sfiorati velocemente e qualsiasi fuoriuscita di fluido può essere facilmente individuata e rimossa senza problemi, per offrire un ambiente pulito e sicuro.

Sponde progettate per una facile pulizia e visibilità

Pannello operatore con comandi bloccabili


Pannelli testaletto rimovibili per un accesso totale al piano rete di 360° gradi

Maniglie di spinta ergonomiche

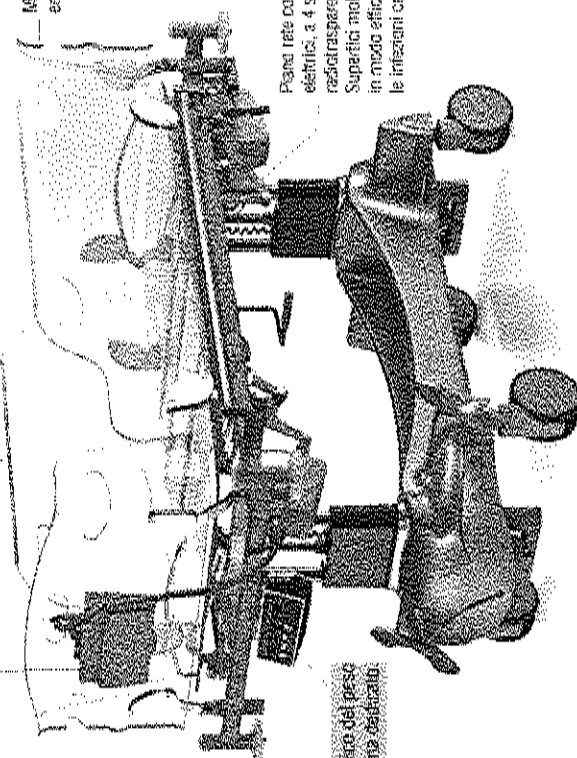

Vetro elettroscuro del peso con programma dedicato

Piano rete con movimenti elettrici a 4 sezioni e radiotrasparente. Superfici molto facili da pulire in modo efficace per prevenire le infezioni crociate del paziente.

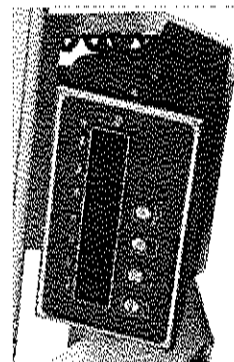

Horizon 400 PRECISION con sistema di pesatura integrato nel letto che permette di monitorare costantemente il paziente pediatrico durante il trattamento del paziente in ogni momento.




Supporto cassella radiologica scorrevole per eseguire procedure a raggi X su tutta la lunghezza del piano rete.

INSPIRE PRECISION 9LI7SR

La sezione schienale è radiotrasparente in HPL e le sezioni bacino, gambale superiore e inferiore sono elementi monoscocca in materiale plastico


Spalle realizzate con elementi monoscocca stampati, dotate di meccanismo di blocco

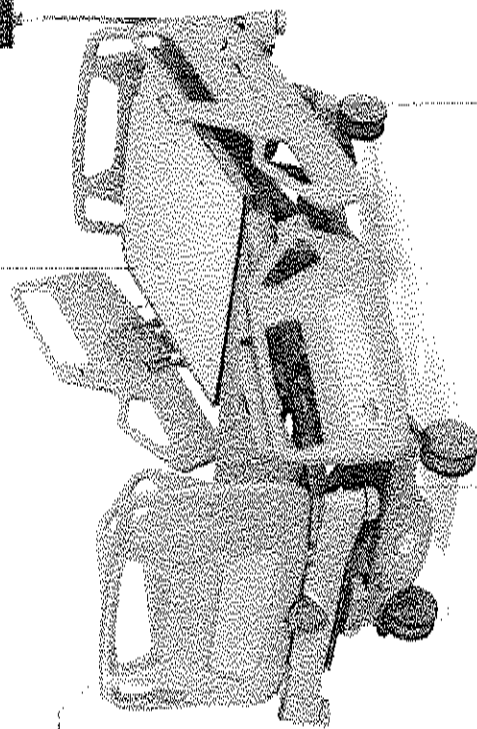


Visore elettronico del peso con programmazione dedicata

I comandi integrati alle sponde, interni ed esterni, sono facilmente accessibili da pazienti ed operatori. Un sistema rallenta la discesa della sponda, ammortizzandola. Indicatori angolari integrabili

Silenziosa dotata di 4 sensori (celle di carico) in classe C3



La sezione schienale in HPL permette esami radiografici con apparecchi mobili direttamente sul letto. La zona radiotrasparente è 730x510 mm.




Rimuovendo la testiera si ha libero accesso al paziente e si possono effettuare gli esami radiografici senza impedimenti.

INSPIRE PRECISION 9LI3S-9LI5S

Piano rete a 4 sezioni realizzate con elementi monoscocca stampati


Spalle realizzate con elementi monoscocca stampati, dotate di meccanismo di blocco

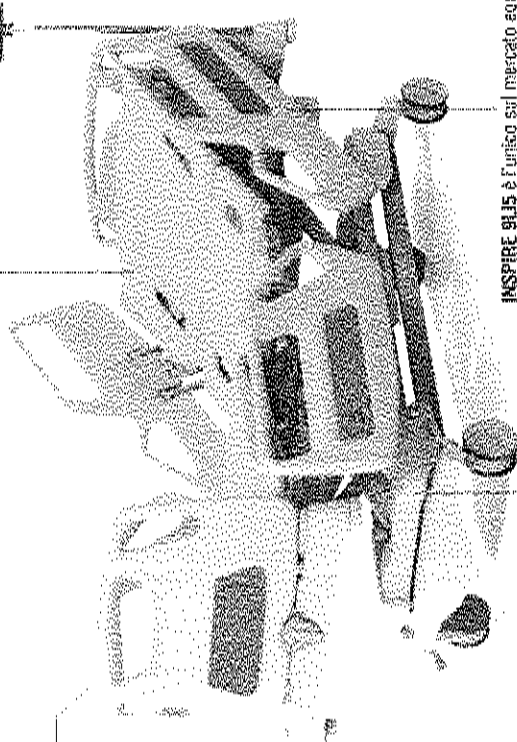

Visore elettronico del peso con programmazione dedicata

INSPIRE 9LI5 è l'unico sul mercato equipaggiato con sponde rimovibili ed è uno strumento che aiuta gli operatori durante le operazioni di pulizia e disinfezione, il sistema di rimozione è stato brevettato.

Silenziosa dotata di 4 sensori (celle di carico) in classe C3



Maniglia per alzarsi in modo sicuro.



Piano rete monoscocca, stampato in PE riciclabile, molto robusto e privo di spigoli vivi.




Sistema brevettato di rimozione delle sponde.

INSPIRE PRECISION 9LH1S

Spalle realizzate con elementi monoscocca stampati, dotate di meccanismo di blocco


Piano rete a 4 sezioni realizzate con elementi monoscocca stampati.

Visore elettronico del peso con programmazione dedicata.

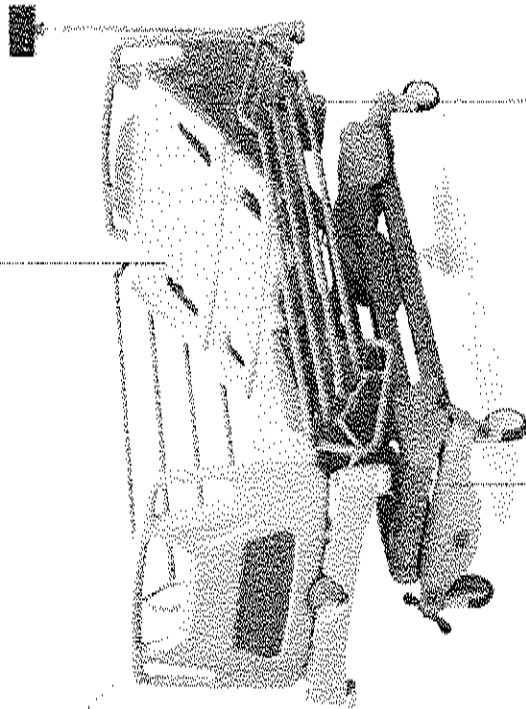


Sponde integrali in acciaio verniciato con sistema di rallentamento che ammortizza la discesa.

Struttura dotata di 4 sensori (celle di carico) in classe F3

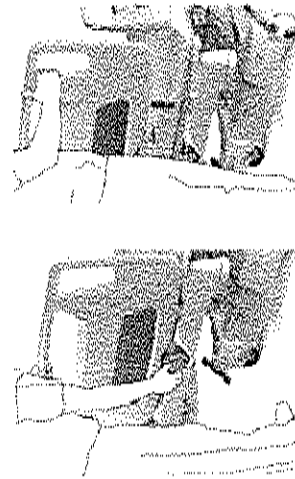

Spalle in materiale plastico, prive di spigoli, bordi arrotondati con profili di contenimento del materasso, molto leggere. Sistema di blocco dell'aspirazione di serie, attivabile dall'operatore. Possibilità di colorazione dello specchio. Additivato con antibatterico Microban®

ACCESSORI



Aste flebo 2 ganci in materiale plastico o acciaio inox, altezza standard o regolabile

Aste flebo 4 ganci in materiale plastico o acciaio inox, altezza standard o regolabile

Coppia barre porta sacche

Asta solleva paziente con maniglia regolabile

Supporto per pappegallo

Alzacoperte

Supporto portapadelle

Portabombaia verticale ø 110 mm

Portabombaia verticale ø 150 mm

Materasso ignifugo

Quinta ruota girevole

Colori



Verde



Blu



Giallo



Zucca



Rovere

Partire dalla tradizione storica affiancandovi innovazioni che permettano di elevare non solo il peso ma anche molti altri parametri essenziali.



MechuS

Medical and Industrial weighing Solutions



Visita il nuovo sito
Visit our new website

www.mechus.it

Azienda certificata UNI EN ISO 9001
Azienda certificata UNI EN ISO 13485

SEDE LEGALE

Via Schiavonesca Priula, 23
31044 Montebelluna, Treviso - Italy
Tel +39 0423 612682 - Fax +39 0423 612680

acquistinretepa.it

« Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione »

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	1457118
Nome RDO	RDO per aggiudicazione Fornitura 9 letti di degenza
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (9 letti per TI CARDIOCHIRURGIA)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Partita IVA	02201130610
Indirizzo	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono	0823232462
Fax	0823232512
E-mail di Contatto	PROVVEDITORATO@OSPEDALE.CASERTA.IT
Punto Ordinante	CAVALLO DONATO
RUP	donato cavallo

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	RIAMED SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	07763691214
Codice Fiscale Impresa	07763691214
Provincia sede registro imprese	NA
Numero iscrizione registro imprese	07763691214
Codice Ditta INAIL	19509150151
n. P.A.T.	22173707/36
Matricola aziendale INPS	5134528017
CCNL applicato	TERZIARIO
Settore	MEDICALE ELETTROMEDICALE ORTOPEDICI
Indirizzo sede legale	VIA ADOLFO OMODEO 45 - NAPOLI (NA)
Telefono	0815870202
Fax	0815870202
PEC Registro Imprese	RIAMED@PEC.IT
Offerta sottoscritta da	RITONDALE ANDREA

L'Offerta irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2016 17:35
--	------------------

OGGETTO (1 DI 2) DELL'OFFERTA	
Descrizione	Letti degenza
Metaprodotto	Letti degenza
Quantità Richiesta	7
Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Marca	gardhen
Codice Articolo Produttore	346860HT
Nome Commerciale	LETTO ELETTRICO 4 SEZIONI
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unità di misura	Pezzo
Tipo contratto	Acquisto
Attuatori elettrici	si
Altezza dal suolo del piano di coricamento	fissa
Sezioni piano di coricamento [numero]	4
Sollevamento del piano di coricamento	elettrico
Regolazione schienale	si
Regolazione sezione femorale	si
Regolazione sezione gambale	si
Movimentazione trendelemburg e antitrendelemburg	si
Carico di funzionamento / Portata massima in sicurezza [kg]	260kg
Tipologia ruote	no
Servizio di progettazione	nd
Certificazioni fornitore	nd
Certificazioni produttore	nd
Iscrizione al repertorio del riciclaggio	nd
Codice CND	nd
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	4438,39

OGGETTO (2 DI 2) DELL'OFFERTA	
Descrizione	Letti degenza
Metaprodotto	Letti degenza
Quantità Richiesta	2

Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Marca	gardhen
Codice Articolo Produttore	346860HB
Nome Commerciale	LETTO ELETTRICO 4 SEZIONI CON BILANCIA
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unità di misura	Pezzo
Tipo contratto	Acquisto
Attuatori elettrici	si
Altezza dal suolo del piano di coricamento	fissa
Sezioni piano di coricamento [numero]	4
Sollevamento del piano di coricamento	elettrico
Regolazione schienale	si
Regolazione sezione femorale	si
Regolazione sezione gambale	si
Movimentazione trendelemburg e antitrendelemburg	si
Carico di funzionamento / Portata massima in sicurezza [kg]	260KG
Tipologia ruote	no
Servizio di progettazione	nd
Certificazioni fornitore	nd
Certificazioni produttore	nd
Iscrizione al repertorio del riciclaggio	nd
Codice CND	nd
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	4438,89

OFFERTA ECONOMICA		
VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA ECONOMICA	39946,51 (Euro)	trentanovemilannovecentoquarantasei/51 /00 (Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e compresi nell'Offerta		(non specificati)
Costi della Sicurezza afferenti all'esercizio		0,00 (Euro)

dell'attività svolta dall'impresa, compresi nell'Offerta	
--	--

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

- Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 15 giorni dalla stipula
- Dati di Consegna:
Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
- Dati di Fatturazione:
Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
- Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo verrà spedita a:

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA / CODICE FISCALE:
02201130610
- Termini di pagamento:
60 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Accettazione sopra indicata.
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni

Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Letto hospital
con e senza bilancia integrata

Hospital Bed
with or without integrated scale



ALEX ■ ALEX HOSPITAL



Gardhen bilance

sblocco rapido dello schienale, per favorire la manovra RCP, ns. codice AC81 / quick release back section for CPR, code AC81
 motori elettrici a bassa tensione del tipo antischiaffamento ed anticevimento, ns. codice AC70 / low voltage motors spline, code AC70
 piano rete 4 sezioni tripla articolazione / 4 sections, 3 joints
 schienale motorizzato / motorized back section
 femorale motorizzato / motorized femoral section
 gambale pneumatico / motorized leg section
 verniciatura con polveri epossidiche (colore a scelta) / epoxy painted, colour charts available
 avvingicavo / cable support
 nodo equipotenziale / equipotential node
 batterie di emergenza / emergency battery
 spine testiera e pediera immediatamente asportabili; codice AC65/1 o AC65 / head/foot board fully removable without tools AC65/1 or AC65
 piano rete con termoplastico in ABS asportabili e lavabili / ABS removable panels for the bed surface
 altezza variabile tramite colonne motorizzate / height adjustment columns
 trendelenburg / trendelenburg
 anti-trendelenburg / inverse trendelenburg
 4 paraurti periferici / No. 4 bumper
 freno simultaneo 2x1 e sistema direzionale, codice AC71/L15 / simultaneous 2x1 brake and directional brake AC71/L15
 chiave/dispositivo inibizione pulsantiera, codice AC34/L / key for locking of the handset AC34/L
 ruote diametro 150mm / wheels 150 mm diameter
 sistema di pesatura integrato / integrated weighing system

Per l'identificazione degli accessori disponibili, riferirsi al catalogo relativo e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti tra catalogo e proposte commerciali, farà fede il contenuto delle proposte commerciali.

For additional on accessories, please contact us to receive a brochure. In any case please refer to the technical data included in the commercial proposal.

Sistema di pesatura / weighing system

Il letto bilancia ALEX è dotato di un sistema digitale di pesatura, integrato nella struttura del letto che Detiene primato di grande fedeltà metrologica, in conformità ai requisiti restrittivi previsti dalla norma UNI EN 45501.

the bed scale ALEX has an integrated weighing system, metrologically approved and at the top of accuracy, compliant to EN45501

funzione per visualizzazione in doppia scala della divisione minima. La programmazione a doppia scala, consente di visualizzare automaticamente la divisione minima di 50g fino a 150kg e di 100g fino a fondo scala. Ottimale per il controllo di pazienti con basso peso corporeo.

double scale availability: it provides an automatic displaying of the division 50g until 150kg of max load and 100g until full scale, for the best weighing of low weight patients

visore a led luminoso di colore rosso, visibile facilmente fino a 20mt. di distanza / display with red LED light, visibility until 20m distance

box visore inossidabile con isolamento IP67 / Display IP67

funzione anti-blockout tramite batterie on-line con autonomia 10 cicli almeno / anti blockout function with batteries, autonomy 10 cycles minimum

tara: sottrazione della tara prima e durante la dialisi / tare subtraction before and during dialysis

modalità di tara: automatica e manuale / tare mode: automatic and manual mode

interfaccia collegamento a PC tramite uscita collegata RS232 o LAN 10/100 / data transmission RS232 or LAN 10/100

memorizzazione e trasferimento dati / storage and transfer of the data

letto / bed

sblocco rapido dello schienale mediante apposita leva di sgancio, per la manovra di emergenza RCP / quick release back section for CPR

motori elettrici a bassa tensione del tipo antischiaffamento ed anticevimento / low voltage motors spline

assenza di meccanismi e leverismi sottorete per una sanificazione completa ed efficace / total absence of mechanisms and leverism underneath the bed surface for an efficient sanitification

sezioni piano rete protette con cover in tecnopolimero termoplastico asportabile per la sanificazione / bed section protected with polymer ABS cover, fully removable

piano rete privo di sagome ed interstizi a rischio di accumulo / bed surface lack of cavities

batterie di emergenza assicurano il funzionamento del letto anche durante il trasporto di pazienti / emergency batteries to assure the working of the bed during the patient transfer as well

spine testiera e pediera immediatamente asportabili e molto leggere per quanto robuste / head/foot panels immediately removable

telaio rinforzato distante dal pavimento per una efficace e rapida sanificazione / good clearance of the frame for an easy cleaning

motorizzazione LINAK, preferita per qualità ed idoneità / Linak motors

il letto è predisposto per accogliere sponde laterali ribaltabili a compassa e semi sponde abbattibili / predisposition for cot sides

letto privo di parti e componenti soggetti ad usura e grippaggio / absence of wear parts

nulla da lubrificare / no needs of lubrication

vasto assortimento di colori / wide range of colours

base protetta da covers in tecnopolimero termoplastico / base frame protected by covers

senza latex / latex free

senza ftalati / phthalates free




design e tecnologia

italiana nel mondo


italian design

and technology in the world

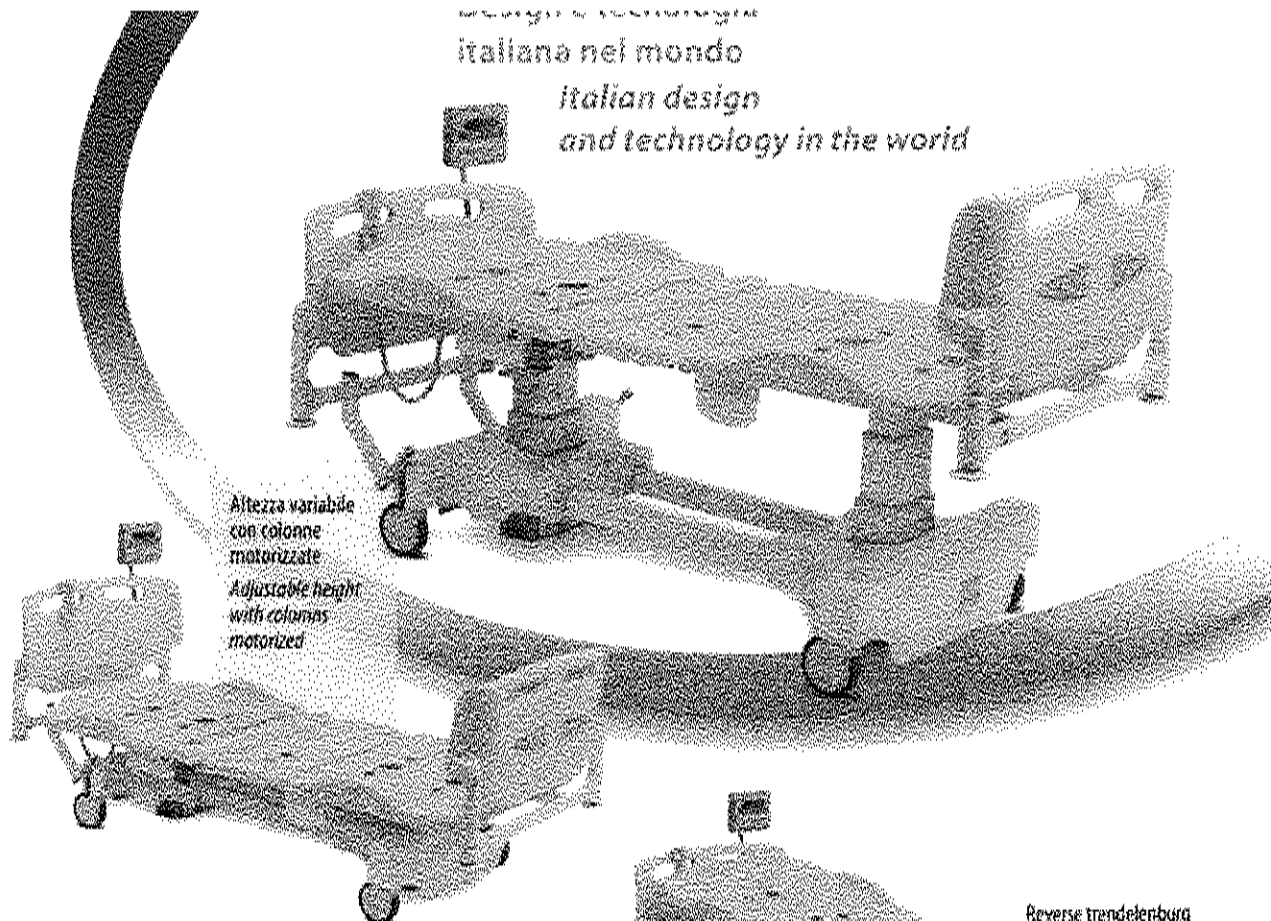

Altezza variabile
con colonne
motorizzate
Adjustable height
with columns
motorized

Reverse trendelenburg

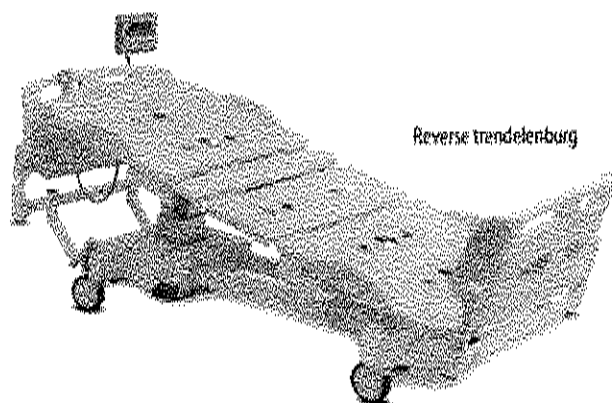

Accessori disponibili / Accessories

Accessori disponibili / Accessories

AC4/L asta flebo / AC4/L IV pole


AC21/S predisposizione per sponde e semisponde laterali

AC21/S predisposition for half cot sides

AC43 asta sollevapaziente / AC43 monkey pole

AC44/1 materasso / AC44/1 mattress

AC45/1 guanciale / AC45/1 pillow

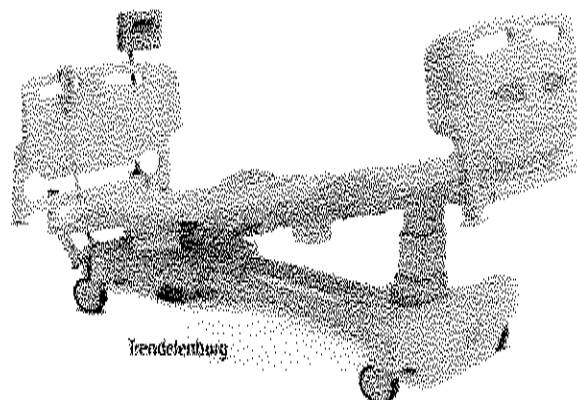

Trendelenburg

Indicazioni / Indications

Indicazioni / Indications

✓ cardiologia

cardiology

✓ chemioterapia

chemotherapy

✓ day hospital

day surgery

✓ degenza

hospitalization

✓ dialisi

dialysis

✓ domiciliare

domiciliary

✓ terapia semi-intensiva

semi-intensive therapy


✓ trasporto pazienti

patient transport

Dimensioni



Dimensions

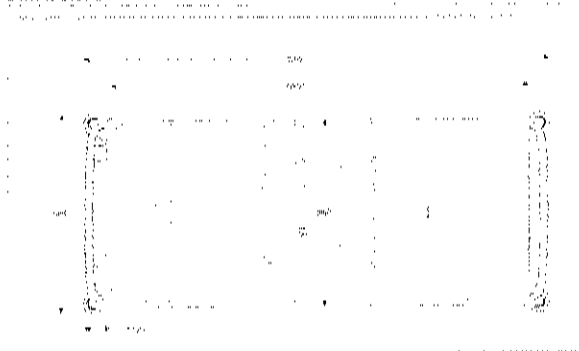

Dati tecnici

Codice (EN)	Z12080003
N. progressivo	90601/01
Destinazione d'uso	Impiegato per la determinazione della massa corporea nella pratica medica per i scopi di controllo, diagnosi e cura GARDHEN BALANCE 50R non inferiore ai 10 anni Direttiva 93/42/CEE del 14/06/93 Decreto 51/42/CEE e s.m.i. allegato 4 / Direttiva 2006/23/CE e s.m.i. Norma CEI EN 60601-1 / Norma CEI EN 60601-2-52
Produttore	
Disponibilità ricambi	
Conformità	
Peso del letto	112 kg
Tipologia di controllo	polivalente con chiave
Batteria	autonomia 10 cicli
Alimentazione	multisorse: 100-240 Vac 50/60 Hz
Tipologia cavo d'alimentazione	Schuko o altro su richiesta
Ruote	inossidabili girevoli es. 4 e mm 160 con sistema frenante
Motore elettrico	bassa tensione (24 V)
Assorbimento	max 450 VA
Isolamento	IP44
Portata massima	250 kg (sospensibile anche in versione bariatrica)
Ciclo di lavoro tipico	230 kg

Data

Cod. EN	Z12080003
Progressivo N. R	90601/01
Intended use	weight determination of the patient for assessment, diagnosis and care purposes GARDHEN BALANCE 50R 10 years for directive 93/42/EC and its revised version, Annex I - 2006/23/EC - CEI EN 60601-1 - CEI EN 60601-2-52
Manufacturer	
Spare parts availability	
Conformity	
Weight	112 kg
Control	Monoflex with locking key
Battery	autonomy 10 cycles
Main supply	multisource 100-240 Vac 50/60 Hz
Main cord	Shuko or other on request
Wheels	two 4 swiveling 160 mm diameter with brake system
Motors voltage	low voltage 24Vdc
Max electrical input	44
Insulation	IP44
Max Load	250 kg
Safety working limit	230 kg

Dati tecnici del sistema integrato di pesatura

Portata max	150kg	200kg	300kg
Divisione minima	50g	50/100g	50/100g (lettura tipo doppia scala)
Box display	integrabile		
Display	6 cifre a led rosso - 7 segmenti h 20mm		
Indicatori di stato	es 4 - a led laminiati		
Funzione	6 tasti		
Trasmissione dati	seriale RS232 (opt. RS422/485/Ethernet 10/100)		
I/O (opt.)	1 ingresso / 2 uscite		
Dimensioni display	mm 228 x 160 x 35h		
Alimentazione display	7.5 Vdc		
Funzione antishock-out	con batteria a lunga durata (24 ore circa)		
Tara	istruzioni della tara piena e durante la display		
Modalità di taro	automatica e manuale		
Classe di isolamento	IP67		

La programmazione a doppia scala, consente di visualizzare automaticamente la divisione minima di 50g fino a 150kg e di 100g fino a doppia scala.

Dati tecnici del sistema integrato di pesatura

Display box	optional
Display	red led, 6 digits 7 segments h 20mm
Status indicators	ex 4 - laminiati led
Function	6 keys
Data transmission	serial RS232 (opt. RS422/485/Ethernet 10/100)
I/O (optional)	1 input / 2 output
Dimensions display	mm 228x160x35h
Power display	7.5 Vdc
Anti-shock-out feature	long life back-up battery
Tare	tare instructions before and during analysis
Tare mode	automatic, and manual mode
The double scale version provides an automatic displaying of the division 50g until 150kg at max load and 100g until full scale	

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare modifiche ai progetti senza alcun preavviso.
The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements. The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.

Sistema certificato di gestione aziendale per la qualità - Quality certifications



Dispositivo medico conforme
93/42/CEE e s.m.i.
Medical device 93/42/EEC compliant
and its revised version
*solo per la versione con bilancia
*only for scale version

Deposito rev. 10.11.2015

Per l'identificazione degli accessori riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
For the accessories identification please refer to the accessories catalogue and/or to the commercial offers. When the data are different please refer to commercial offer.

g/b
Gardhen balance

acquistinretepa.it
• Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	1457118
Nome RDO	RDO per aggiudicazione Fornitura 9 letti di degenza
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (9 letti per TI CARDIOCHIRURGIA)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Partita IVA	02201130610
Indirizzo	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono	0823232462
Fax	0823232512
E-mail di Contatto	PROVVEDITORATO@OSPEDALE.CASERTA.IT
Punto Ordinante	CAVALLO DONATO
RUP	donato cavallo

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	GM. MEDICA SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	05025691212
Codice Fiscale Impresa	05025691212
Provincia sede registro imprese	NA
Numero iscrizione registro imprese	05025691212
Codice Ditta INAIL	18343539
n. P.A.T.	20463243/46
Matricola aziendale INPS	5128342326
CCNL applicato	COMMERCIO E TERZIARIO
Settore	COMMERCIO E TERZIARIO
Indirizzo sede legale	VIA BRECCE A S. ERASMO N. 112/114 - NAPOLI (NA)
Telefono	0812411827
Fax	0812417322
PEC Registro imprese	INFO@GMMEDICA.IT
Offerta sottoscritta da	MARIGO ALESSANDRO
L'Offerta irrevocabile ed	31/12/2016 17:35

impegnativa fino al	
---------------------	--

OGGETTO (1 DI 2) DELL'OFFERTA	
Descrizione	Letti degenza
Metaprodotto	Letti degenza
Quantità Richiesta	7
Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Marca	MALVESTIO
Codice Articolo Produttore	346860HT
Nome Commerciale	LETTO ELETTRICO 4 SEZIONI
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unità di misura	Pezzo
Tipo contratto	Acquisto
Attuatori elettrici	SI
Altezza dal suolo del piano di coricamento	FISSA
Sezioni piano di coricamento [numero]	4
Sollevamento del piano di coricamento	ELETTRICO
Regolazione schienale	SI
Regolazione sezione femorale	SI
Regolazione sezione gambale	SI
Movimentazione trendelemburg e antitrendelemburg	SI
Carico di funzionamento / Portata massima in sicurezza [kg]	260KG
Tipologia ruote	NO
Servizio di progettazione	
Certificazioni fornitore	
Certificazioni produttore	
Iscrizione al repertorio del riciclaggio	
Codice CND	
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	4000

OGGETTO (2 DI 2) DELL'OFFERTA	
Descrizione	Letti degenza
Metaprodotto	Letti degenza
Quantità Richiesta	2

Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Marca	MALVESTIO
Codice Articolo Produttore	346860HB
Nome Commerciale	LETTO ELETTRICO 4 SEZIONI CON BILANCIA
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unità di misura	Pezzo
Tipo contratto	Acquisto
Attuatori elettrici	SI
Altezza dal suolo del piano di coricamento	FISSA
Sezioni piano di coricamento [numero]	4
Sollevamento del piano di coricamento	ELETTRICO
Regolazione schienale	SI
Regolazione sezione femorale	SI
Regolazione sezione gambale	SI
Movimentazione trendelemburg e antitrendelemburg	SI
Carico di funzionamento / Portata massima in sicurezza [kg]	260KG
Tipologia ruote	NO
Servizio di progettazione	
Certificazioni fornitore	
Certificazioni produttore	
Iscrizione al repertorio del riciclaggio	
Codice CND	
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	5950

OFFERTA ECONOMICA		
VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA ECONOMICA	39900,00 (Euro)	trentanovemilannovecento /00 (Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e compresi nell'Offerta		(non specificati)
Costi della Sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, compresi nell'Offerta		0,00 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

- Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 15 giorni dalla stipula
- Dati di Consegna:
Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
- Dati di Fatturazione:
Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
- Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo verrà spedita a:

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA / CODICE FISCALE:
02201130610
- Termini di pagamento:
60 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Accettazione sopra indicata.
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni

Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



**LETTO ELETTRICO A 4 SEZIONI CON
MOVIMENTO SU COMPASSI, PIANO IN ABS,
SCHIENALE E BACINO TRASLANTI,
TRENDLENBURG E
CONTROTRENDLENBURG ELETTRICI.**

346860HT

LETTO ELETTRICO (SOLO PER SCHEDE)

Immagine Indicativa / Indicative Example

MD10 Rev 05 data: 13/06/16

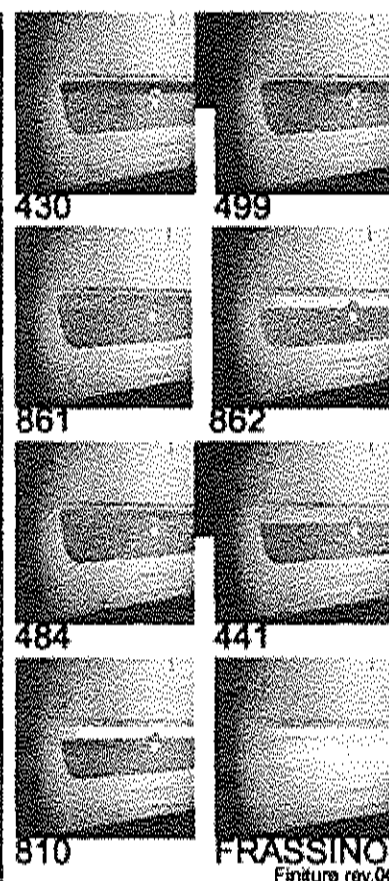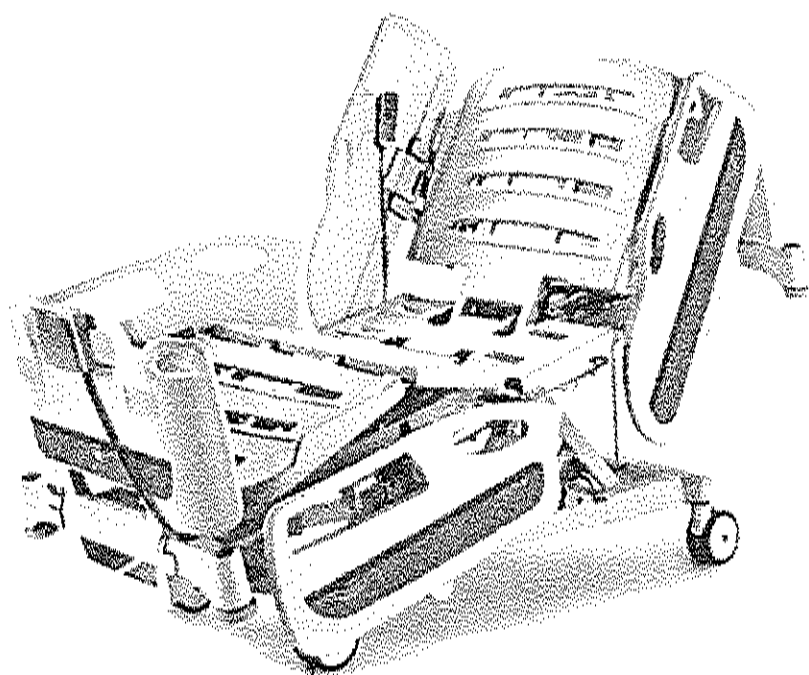

Letto elettrico a 4 sezioni, di cui 3 snodate e 1 fissa centrale.

Il piano di coricamento e' realizzato in abs facilmente sanificabile ed asportabile (rimovibile) senza spigoli vivi, completo di ferma-materasso integrati.

Il basamento e' realizzato da due longheroni e due traversi in acciaio saldati e verniciati, con alle estremità i meccanismi di bloccaggio delle ruote e dotato di coperture in abs termoformato.

Il telaio intermedio e' realizzato in traversi in trafilato verniciato sostenente il piano dotato di predisposizione per il montaggio di sponde a compasso o a bastoni abbattibili, su ambo i lati del telaio è saldata una barra porta accessori in struttura metallica verniciata con n. 2 ganci in materiale plastico, ognuno con portata di 3 kg, scorrevoli e riposizionabili. Completo di apposite sedi per l'inserimento di asta sollevamaterasso, aste flebo ed accessori dedicati ai 4 angoli.

**LETTO ELETTRICO A 4 SEZIONI CON
 MOVIMENTO SU COMPASSI, PIANO IN ABS,
 SCHIENALE E BACINO TRASLANTI,
 TRENDELENBURG E
 CONTROTRENDELENBURG ELETTRICI.**
346860HT
LETTO ELETTRICO (SOLO PER SCHEDE)

La regolazione in altezza e' ottenuta tramite una coppia di attuatori elettrici a bassa tensione 24 V, con carico di sollevamento in sicurezza di 260 kg.

Il letto ha di serie una pulsantiera in uso al paziente ed una consolle comando "SUPERVISOR" ad uso esclusivo del personale specializzato.

Il comando a pulsantiera secondario per paziente e' integrabile alle sponde con cavo spiralato ed ha le seguenti funzioni:

- tasto di attivazione/spegnimento di sicurezza, con led di accensione
- sollevamento/abbassamento schienale con indicazione a led per funzione inibita;
- sollevamento/abbassamento femorale con indicazione a led per funzione inibita;
- sollevamento/abbassamento contemporaneo di schienale e femorale;
- sollevamento/abbassamento altezza variabile con indicazione a led per funzione inibita;

Tutti i comandi elettrici della pulsantiera paziente sono disattivabili da parte del personale direttamente dalla tastiera operatore.

Il comando a tastiera "SUPERVISOR" per operatore e' integrabile alle spalle ed alle sponde o in apposita sede lato piedi con cavo spiralato e dotato dei seguenti tasti funzione:

- tasto di attivazione/spegnimento di sicurezza, con coppia di led di accensione indicanti il tipo di alimentazione, rete o batteria in funzione al momento dell'accensione. Quando il letto e' alimentato tramite rete, il led batteria segnala lo stato di carica della batteria.
- sollevamento/abbassamento altezza variabile con indicazione a led per funzione disattivata;
- sollevamento/abbassamento schienale con indicazione a led per funzione disattivata;
- sollevamento/abbassamento femorale con indicazione a led per funzione disattivata;
- sollevamento/abbassamento contemporaneo schienale-femorale (autocontour);
- tasto inibizione funzioni pulsantiera paziente;
- tasto posizione sedia cardiologica con unico comando progressivo;
- coppia tasti comando trendelenburg - controtrendelenburg;
- tasto per l'azzeramento piani rete con contemporaneo sollevamento ad altezza visita (posizione visita);
- tasto per l'azzeramento veloce piani rete con contemporanea discesa ad altezza minima (posizione rianimazione) e uscita sicura letto;
- tasto per l'azzeramento veloce piani rete con contemporaneo movimento di trendelenburg di emergenza (posizione anti-shock).

Le pulsantiere sono dotate di avviso acustico per la segnalazione delle funzioni inibite.

Dopo alcuni minuti di non utilizzo delle pulsantiere, la centralina entra automaticamente in auto-spegnimento, per garantire un bassissimo consumo di energia. Il sistema si riattiva istantaneamente azionando un qualsiasi comando.

Lo schienale ed il femorale traslano automaticamente quando vengono alzati, in modo da compensare la spinta del paziente verso il fondo del letto, alleggerire la compressione nella zona torace/bacino, favorire la respirazione e le corrette posture, riducendo la possibilità di formazione di piaghe da decubito ed evitando il continuo riposizionamento del paziente. Lo schienale trasla di cm 12 mentre il femorale trasla di cm 4,5 con una traslazione complessiva di cm 16,5.

GM. Medica Srl

2016/2220 13/12/16

**LETTO ELETTRICO A 4 SEZIONI CON
 MOVIMENTO SU COMPASSI, PIANO IN ABS,
 SCHIENALE E BACINO TRASLANTI,
 TRENDELENBURG E
 CONTROTRENDELENBURG ELETTRICI.**
346860HT
LETTO ELETTRICO (SOLO PER SCHEDE)

In caso di emergenza, lo schienale e' abbattibile manualmente tramite la leva di sblocco rapido posto su ambo i lati (cpr); il tutto e' controllato da un sistema di sicurezza anticaduta accidentale servoassistito da doppia molla a gas, le leve sono facilmente individuabili in qualsiasi posizione del letto, anche ad altezza minima, e con le sponde sia in uso che abbassate.

Il letto e' dotato di batteria ausiliaria ricaricabile, che assicura il movimento anche durante il trasporto ed in assenza di corrente elettrica.

La zona gambale e' regolabile manualmente mediante cremagliere ed e' dotata di un controllo meccanico di sicurezza per evitare un'errata angolazione/controrotazione negativa del ginocchio.

Il vassoio portabiancheria con vano porta pulsantiera e' integrato a scomparsa nella zona piedi.

Le spalle del letto in materiale plastico con tubolari di innesto e rinforzo in acciaio inox, hanno una particolare conformazione studiata per l'aggancio della fastiera operatore e per la contemporanea eventuale collocazione del compressore per materasso ad aria, con sedi per il passaggio/sostegno delle relative tubature.

Le spalle sono inserite sul letto in apposite sedi dotate di blocco di sicurezza antisfilamento, sbloccabile tramite levette ad eccentrico integrate nella struttura.

La spalla lato testa e' solidale al piano rete e ne segue tutte le movimentazioni.

E' presente un sistema di allarme acustico di segnalazione in caso di allacciamento alla presa elettrica e ruote non frenate.

Il letto e' completamente verniciato con polveri epossidiche contenenti un particolare additivo antibatterico, il biocole, a base di ioni naturali d'argento.

Viene garantita la lavabilità e la disinfezione.

Dati tecnici:

Dimensioni piano rete: lungh. cm 201x87 idoneo all'uso di materassi compatibili con la tipologia di accessorio-sponde prescelte (in conformità alla norma UNI CEI EN 60601-2-52).

Dimensioni senza sponde: cm 219x92

Dimensioni con sponde in uso: cm 219x99 (max)

Dimensioni con sponde abbattute: cm 219x98 (max)

Altezza piano rete: H min. cm 40 H max cm 80

Inclinazione schienale: 0°- 71°

Inclinazione femorale: 0°- 30°

Inclinazione gambale: 0°- 20°

Inclinazione trendelenburg/controtrend. +/- 17°

Peso del letto (senza accessori): 120 kg.

Carico di lavoro sicuro: 260 kg.

Caratteristiche elettriche:

Alimentazione: 230 V +/- 10 % 50 HZ trasformata in 24 V; spina tipo SCHÜKO

Potenza massima assorbita: 370 VA Classe di isolamento: I - TIPO: B

Grado di protezione: attuatori schienale e femorale: IPX6, attuatori di sollevamento: IPX4; batteria: IP55; centralina: IP56.

GM. Medica Srl

2016/2220 13/12/16

**LETTO ELETTRICO A 4 SEZIONI CON
MOVIMENTO SU COMPASSI, PIANO IN ABS,
SCHIENALE E BACINO TRASLANTI,
TRENDLENBURG E
CONTOTRENDLENBURG ELETTRICI.**

346860HT

LETTO ELETTRICO (SOLO PER SCHEDE)

Il letto e' completamente collegato tra i vari componenti tramite ponticelli in rame per eseguire una connessione equipotenziale. Il letto e' dotato di connettore equipotenziale.

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/47/CE.

NORME TECNICHE APPLICATE: CEI EN 60601-1; CEI EN 60601-1-2; UNI CEI EN 60601-2-52.

DISPOSITIVO MEDICO REALIZZATO IN CONFORMITA' ALLA CERTIFICAZIONE ISO 9001 E ISO 13485.

REPERTORIO D.M. N. 451423/R - CODICE CND V0801



RINA

ISO 13485:2015
Certified for Medical Devices



RINA

ISO 9001:2015
Certified for Quality Management

Si diffida a riprodurre sia pure in parte o di passare a terzi il presente disegno. L'azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso, tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune.
It is not authorized copying, however in part, or using of the present drawing. The Company reserves the right to introduce all technical and/or aesthetical modifications deemed necessary to their products without prior notice.

Malvestio S.p.A. - 35010 Vitarone (Padova) Italy - Via Carana, 121 - Tel. 049/9289511 - Fax 049/9289500
cap. soc. 2.450.000,00 € I.v. - C.C.I.A.A. di Padova 119204 - reg. imprese, c.f. e p.iva 00197770281
www.malvestio.it - e-mail: info@malvestio.it

GM. Medica Srl

2016/2220 13/12/16

SCHIENALE IN LAMINATO PLASTICO

346032

LETTO ELETTRICO (SOLO PER SCHEDE)

Immagine Indicativa / Indicative Example

MD10 Rev. 01 data 29/03/11




Schienale in laminato plastico radiotrasparente spessore 8 mm , con telaio di supporto aperto nel lato superiore.

346018

LETTA ELETTRICO (SOLO PER SCHEDE)

Imagine Indicativa / Indicative Example

MD10 Rev. 01 data: 23/03/12

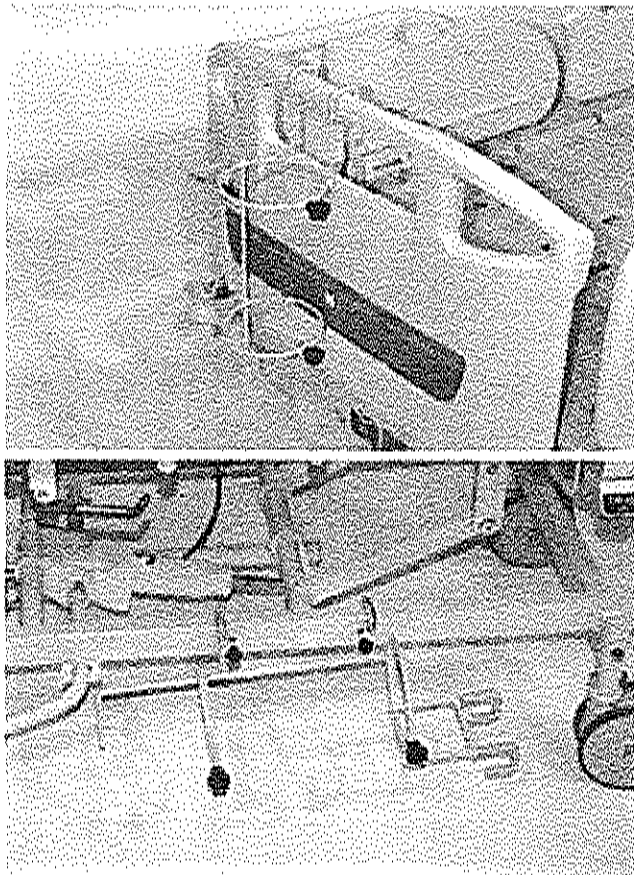

Struttura realizzata in acciaio verniciato con agganci per fissaggio al basamento (posizione orizzontale) oppure alle spalle del letto (posizione verticale). Diametro regolabile tramite morsetti.

GM. Medica Srl

2016/2220 13/12/16



**LETTO ELETTRICO A 4 SEZIONI CON
MOVIMENTO SU COMPASSI, PIANO IN ABS,
SCHIENALE E BACINO TRASLANTI,
TRENDELENBURG E CONTROTRENDELENBURG
ELETTRICI CON BILANCIA - COMMANDER**

346860HB

LETTO ELETTRICO (SOLO PER SCHEDE)

Immagine Indicativa / Indicative Example

MD10 Rev. 01 data. 27/05/16

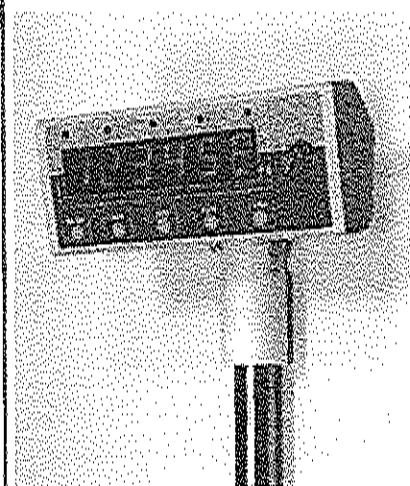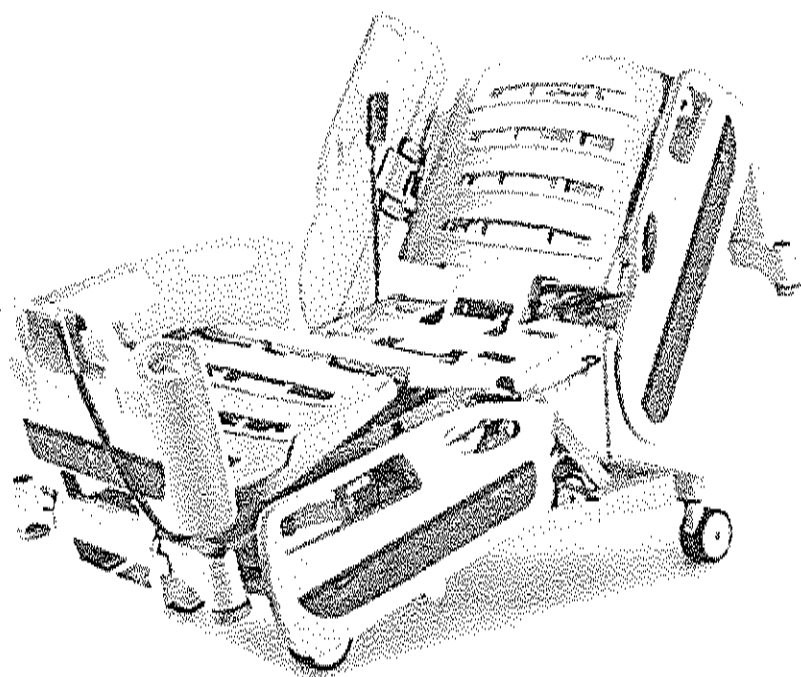

Letto elettrico a 4 sezioni, di cui 3 snodate e 1 fissa centrale.

Il piano di coricamento è realizzato in abs facilmente sanificabile ed asportabile (rimovibile) senza spigoli vivi, completo di ferma-materasso integrati.

Il basamento è realizzato da due longheroni e due traversi in acciaio saldati e verniciati, con alle estremità i meccanismi di bloccaggio delle ruote e dotato di coperture in abs termoformato.

Il telaio intermedio è realizzato in traversi in trafilato verniciato sostenente il piano dotato di predisposizione per il montaggio di sponde a compasso o a bastoni abbattibili, su ambo i lati del telaio è saldata una barra porta accessori in struttura metallica verniciata con n. 2 ganci in materiale plastico, ognuno con portata di 3 kg, scorrevoli e riposizionabili. Completo di apposite sedi per l'inserimento di asta sollevamaterasso, aste flebo ed accessori dedicati ai 4 angoli.

Pag 5 di 14

GM. Medica Srl

2016/2220 13/12/16

**LETTO ELETTRICO A 4 SEZIONI CON
MOVIMENTO SU COMPASSI, PIANO IN ABS,
SCHIENALE E BACINO TRASLANTI,
TRENDELENBURG E CONTROTRENDELENBURG
ELETTRICI CON BILANCIA - COMMANDER**

346860HB

LETTO ELETTRICO (SOLO PER SCHEDE)

La regolazione in altezza è ottenuta tramite una coppia di attuatori elettrici a bassa tensione 24 V, con carico di sollevamento in sicurezza di 260 kg.

Il letto ha di serie una pulsantiera in uso al paziente ed una consolle comando "SUPERVISOR" ad uso esclusivo del personale specializzato.

Il comando a pulsantiera secondario per paziente è integrabile alle sponde con cavo spiralato ed ha le seguenti funzioni:

- tasto di attivazione/spegnimento di sicurezza, con led di accensione
- sollevamento/abbassamento schienale con indicazione a led per funzione inibita;
- sollevamento/abbassamento femorale con indicazione a led per funzione inibita;
- sollevamento/abbassamento contemporaneo di schienale e femorale;
- sollevamento/abbassamento altezza variabile con indicazione a led per funzione inibita;

Tutti i comandi elettrici della pulsantiera paziente sono disattivabili da parte del personale direttamente dalla tastiera operatore.

Il comando a tastiera "SUPERVISOR" per operatore è integrabile alle spalle ed alle sponde o in apposita sede lato piedi con cavo spiralato e dotato dei seguenti tasti funzione:

- tasto di attivazione/spegnimento di sicurezza, con coppia di led di accensione indicanti il tipo di alimentazione, rete o batteria in funzione al momento dell'accensione. Quando il letto è alimentato tramite rete, il led batteria segnala lo stato di carica della batteria.
- sollevamento/abbassamento altezza variabile con indicazione a led per funzione disattivata;
- sollevamento/abbassamento schienale con indicazione a led per funzione disattivata;
- sollevamento/abbassamento femorale con indicazione a led per funzione disattivata;
- sollevamento/abbassamento contemporaneo schienale-femorale (autocontour);
- tasto inibizione funzioni pulsantiera paziente;
- tasto posizione sedia cardiologica con unico comando progressivo;
- coppia tasti comando trendelenburg - controtrendelenburg;
- tasto per l'azzeramento piani rete con contemporaneo sollevamento ad altezza visita (posizione visita);
- tasto per l'azzeramento veloce piani rete con contemporanea discesa ad altezza minima (posizione rianimazione) e uscita sicura letto;
- tasto per l'azzeramento veloce piani rete con contemporaneo movimento di trendelenburg di emergenza (posizione anti-shock).

Le pulsantiere sono dotate di avviso acustico per la segnalazione delle funzioni inibite.

Dopo alcuni minuti di non utilizzo delle pulsantiere, la centralina entra automaticamente in auto-spegnimento, per garantire un bassissimo consumo di energia. Il sistema si riattiva istantaneamente azionando un qualsiasi comando.

Lo schienale ed il femorale traslano automaticamente quando vengono alzati, in modo da compensare la spinta del paziente verso il fondo del letto, alleggerire la compressione nella zona torace/bacino, favorire la respirazione e le corrette posture, riducendo la possibilità di formazione di piaghe da decubito ed evitando il continuo riposizionamento del paziente. Lo schienale trasla di cm 12 mentre il femorale trasla di cm 4,5 con una traslazione complessiva di cm 16,5.

GM. Medica Srl

2016/2220 13/12/16

**LETTO ELETTRICO A 4 SEZIONI CON
MOVIMENTO SU COMPASSI, PIANO IN ABS,
SCHIENALE E BACINO TRASLANTI,
TRENDLENBURG E CONTROTRENDLENBURG
ELETTRICI CON BILANCIA - COMMANDER**

346860HB

LETTO ELETTRICO (SOLO PER SCHEDE)

In caso di emergenza, lo schienale è abbattibile manualmente tramite la leva di sblocco rapido posto su ambo i lati (cpr); il tutto è controllato da un sistema di sicurezza anticaduta accidentale servoassistito da doppia molla a gas, le leve sono facilmente individuabili in qualsiasi posizione del letto, anche ad altezza minima, e con le sponde sia in uso che abbassate.

Il letto è dotato di batteria ausiliaria ricaricabile, che assicura il movimento anche durante il trasporto ed in assenza di corrente elettrica.

La zona gambale è regolabile manualmente mediante cremagliere ed è dotata di un controllo meccanico di sicurezza per evitare un'errata angolazione/controrotazione negativa del ginocchio.

Il vassoio portabiancheria con vano porta pulsantiera è integrato a scomparsa nella zona piedi.

Le spalle del letto in materiale plastico con tubolari di innesto e rinforzo in acciaio inox, hanno una particolare conformazione studiata per l'aggancio della tastiera operatore e per la contemporanea eventuale collocazione del compressore per materasso ad aria, con sedi per il passaggio/sostegno delle relative tubature.

Le spalle sono inserite sul letto in apposite sedi dotate di blocco di sicurezza antisfilamento, sbloccabile tramite levette ad eccentrico integrate nella struttura.

La spalla lato testa è solidale al piano rete e ne segue tutte le movimentazioni.

È presente un sistema di allarme acustico di segnalazione in caso di allacciamento alla presa elettrica e ruote non frenate.

Il letto è completamente verniciato con polveri epossidiche contenenti un particolare additivo antibatterico, il biocote, a base di ioni naturali d'argento.

Viene garantita la lavabilità e la disinfezione.

Dati tecnici:

Dimensioni piano rete: lung. cm 201x87 idoneo all'uso di materassi compatibili con la tipologia di accessorio-sponde prescelte (in conformità alla norma UNI CEI EN 60601-2-52).

Dimensioni senza sponde: cm 219x92

Dimensioni con sponde in uso: cm 219x99 (max)

Dimensioni con sponde abbattute: cm 219x98 (max)

Altezza piano rete: H min. cm 40 H max cm 80

Inclinazione schienale: 0°- 71°

Inclinazione femorale: 0°- 30°

Inclinazione gambale: 0°- 20°

Inclinazione trendelenburg/controtrend. +/- 17°

Peso del letto (senza accessori): 120 kg.

Carico di lavoro sicuro: 260 kg.

Caratteristiche elettriche:

Alimentazione: 230 V +/- 10 % 50 HZ trasformata in 24 V; spina tipo SCHÜKO

Potenza massima assorbita: 370 VA Classe di isolamento: I - TIPO: B

Grado di protezione: attuatori schienale e femorale: IPX6, attuatori di sollevamento: IPX4; batteria: IP55; centralina: IP56.

GM. Medica Srl

2016/2220 13/12/16

**LETTO ELETTRICO A 4 SEZIONI CON
 MOVIMENTO SU COMPASSI, PIANO IN ABS,
 SCHIENALE E BACINO TRASLANTI,
 TRENDELENBURG E CONTROTRENDELENBURG
 ELETTRICI CON BILANCIA - COMMANDER**

346860HB
LETTO ELETTRICO (SOLO PER SCHEDE)

Il letto è completamente collegato tra i vari componenti tramite ponticelli in rame per eseguire una connessione equipotenziale. Il letto è dotato di connettore equipotenziale.

N.B.: le ruote e le sponde sono accessori a richiesta quotati a parte

Il letto è dotato di bilancia elettronica integrata con visualizzatore elettronico.

Caratteristiche sistema di pesatura:

- 4 sensori del peso integrati nella struttura. La scelta di 4 sensori posti nei 4 angoli è dovuta al fatto di limitare le flessioni e sollecitazioni dei sensori, e di garantire una maggior durata nel tempo e una maggior distribuzione del carico.
- Visore del peso con display ampio e ben leggibile, collocato su un supporto fisso. Il visore girevole e sfilabile in caso di urgenza.
- Dotato di batteria che garantisce il perfetto funzionamento in assenza di corrente elettrica (4 ore).
- PORTATA 150 Kg divisione 50 g (standard) oppure PORTATA 300 Kg multidivisione: 0-150 kg div. 50 g / 150-300 kg div. 100 g (su richiesta)
- CLASSE DI PRECISIONE III

Funzioni visore:

- TASTO ZERO azzeramento manuale;
- TASTO AGGIUNGI/TOGLI PESO annulla il peso di oggetti durante il ciclo di pesatura;
- TARA MANUALE impostazione di una tara direttamente da tastiera;
- IMPOSTAZIONE SOGLIE ALLARME (sonoro/visivo) per diminuzione/aumento peso paziente;
- ALLARME ASSENZA PAZIENTE (sonoro/visivo) per controllare la discesa dal letto
- FUNZIONE CONGELA PESO memorizza peso, ora, data del paziente.
- Selezione lingua di utilizzo (ITALIANO / INGLESE).
- Funzione di allarme batteria HI-LOW: indica lo stato HIGH-OK-LOW.


Caratteristiche visore:

- Display di peso: Numerico a 6 digit led rossi a 7 segmenti (h=20 mm)
- Led: 5 led indicatori da 5 mm
- Tastiera: a 5 tasti multifunzione
- Dimensioni d'ingombro: 184mm x 80mm x 72mm (l x h x p)
- Porta seriale: Rs232 e Rs485 a scelta;
- Possibilità di comandi funzione via seriale
- Porta LAN
- Porta USB
- Materiale contenitore: ABS
- Grado di protezione: IP60
- Alimentazione: 5 / 7,5 Vcc con alimentatore esterno 230Vac
- Assorbimento max: 6 W
- Isolamento: Classe II


346032

Imagine Indicative / Indicative Example

MD10 Rev 01 date 29/03/11

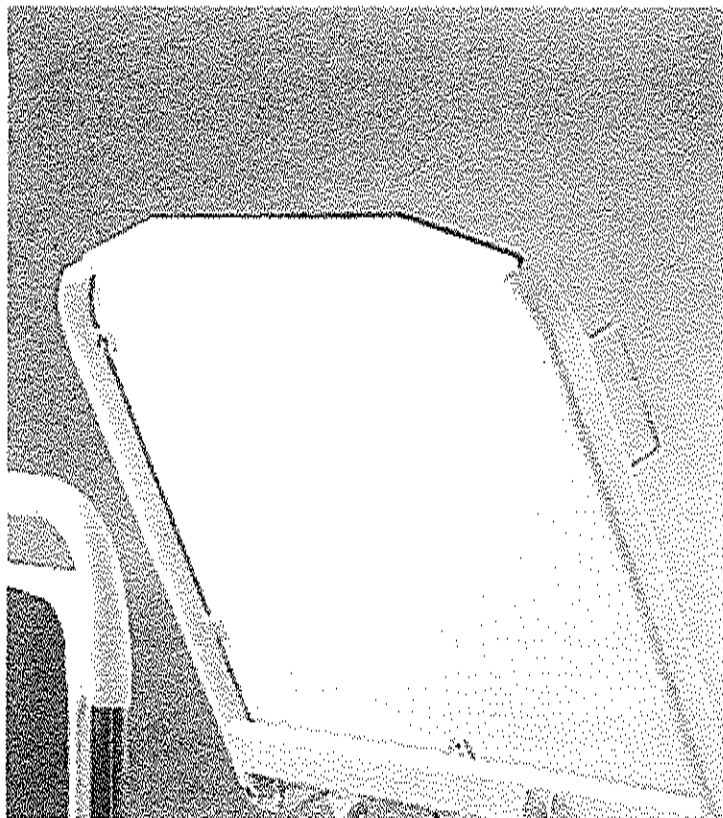

RINA
 Registro Italiano Navale
 ASSOCIATO ALL'UNIONE ITALIANA DELLO SCACCO



Si concede a riprodurre sia pure in parte o di passare ai terzi il presente disegno, l'azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso, tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune.
It is not authorized copying, however in part, or using of the present drawing. The Company reserves the right to introduce all technical and/or aesthetical modifications deemed necessary to its products without prior notice.

Melvestro S.p.A. - 35010 VERONA (Padova) Italy - Via Catena, 121 - Tel. (045) 9299511 - Fax 045/9299500
 cap. soc. 2.450.000,00 € - e-mail: info@melvestro.it - www.melvestro.it - reg.viniprese.cj.cpa.it 00197370281

GM. Medica Srl

2016/2220 13/12/16


**PORTABOMBOLA DA APPLICARE SU PIU' PUNTI
DEL LETTO**

346018

LETTO ELETTRICO (SOLO PER SCHEDE)

Immagine Indicativa / Indicative Example

MD10 Rev. 01 data 23/03/12

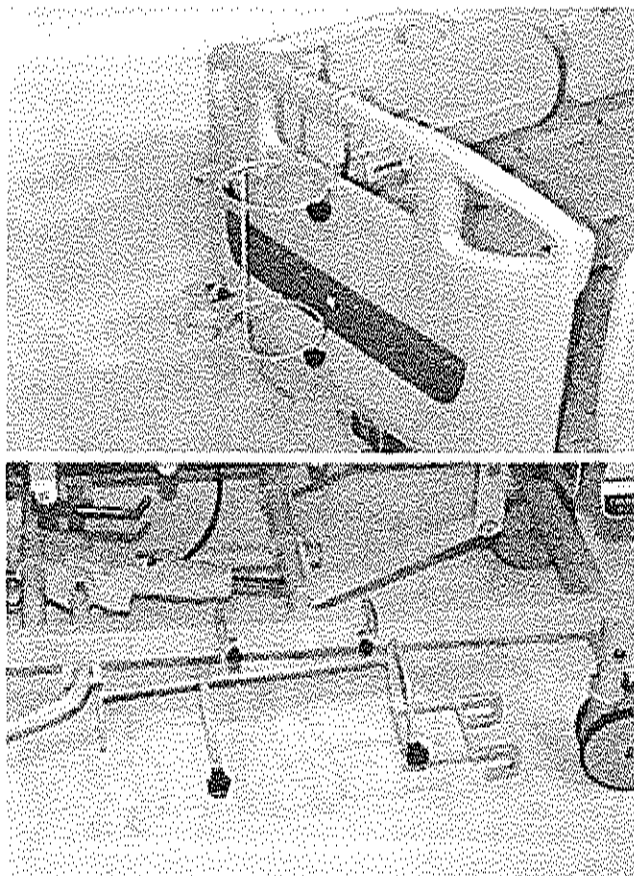

Struttura realizzata in acciaio verniciato con agganci per fissaggio al basamento (posizione orizzontale) oppure alle spalle del letto (posizione verticale). Diametro regolabile tramite morsetti.

acquistinretepa.it
 il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	1457118
Nome RDO	RDO per aggiudicazione Fornitura 9 letti di degenza
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (9 letti per TI CARDIOCHIRURGIA)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Partita IVA	02201130610
Indirizzo	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono	0823232462
Fax	0823232512
E-mail di Contatto	PROVVEDITORATO@OSPEDALE.CASERTA.IT
Punto Ordinante	CAVALLO DONATO
RUP	donato cavallo

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	NUOVA IMEL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	01796140927
Codice Fiscale Impresa	01796140927
Provincia sede registro imprese	CA
Numero iscrizione registro imprese	143879
Codice Ditta INAIL	4266207
n. P.A.T.	21969546/87
Matricola aziendale INPS	1703832912
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	COMMERCIO ALL'INGROSSO ARREDI IN GENERE
Indirizzo sede legale	VIA GIULIO DOLCETTA 12 - CAGLIARI (CA)
Telefono	070275581
Fax	070283368
PEC Registro Imprese	NUOVAIMEL@PEC.IT
Offerta sottoscritta da	Arghittu Giovanni Giuseppe

L'Offerta irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2016 17:35
--	------------------

OGGETTO (1 DI 2) DELL'OFFERTA	
Descrizione	Letti degenza
Metaprodotto	Letti degenza
Quantità Richiesta	7
Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Marca	MALVESTIO
Codice Articolo Produttore	346900Q+300240
Nome Commerciale	LETTO ELETTRICO 4 SEZIONI
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unità di misura	Pezzo
Tipo contratto	Acquisto
Attuatori elettrici	SI
Altezza dal suolo del piano di coricamento	VARIABILE
Sezioni piano di coricamento [numero]	4
Sollevamento del piano di coricamento	ELETTRICO
Regolazione schienale	SI
Regolazione sezione femorale	SI
Regolazione sezione gambale	SI
Movimentazione trendelemburg e antitrendelemburg	SI
Carico di funzionamento / Portata massima in sicurezza [kg]	260KG
Tipologia ruote	
Servizio di progettazione	
Certificazioni fornitore	
Certificazioni produttore	
Iscrizione al repertorio del riciclaggio	
Codice CND	
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	3712

OGGETTO (2 DI 2) DELL'OFFERTA	
Descrizione	Letti degenza
Metaprodotto	Letti degenza
Quantità Richiesta	2

Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Marca	MALVESTIO
Codice Articolo Produttore	346940HBICU
Nome Commerciale	LETTO ELETTRICO 4 SEZIONI CON BILANCIA
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unità di misura	Pezzo
Tipo contratto	Acquisto
Attuatori elettrici	SI
Altezza dal suolo del piano di coricamento	VARIABILE
Sezioni piano di coricamento [numero]	
Sollevamento del piano di coricamento	ELETTRICO
Regolazione schienale	SI
Regolazione sezione femorale	SI
Regolazione sezione gambale	SI
Movimentazione trendelemburg e antitrendelemburg	SI
Carico di funzionamento / Portata massima in sicurezza [kg]	260KG
Tipologia ruote	
Servizio di progettazione	
Certificazioni fornitore	
Certificazioni produttore	
Iscrizione al repertorio del riciclaggio	
Codice CND	
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	6848

OFFERTA ECONOMICA		
VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA ECONOMICA	39680,00 (Euro)	trentanovemilaseicentoottanta /00 (Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e compresi nell'Offerta		(non specificati)
Costi della Sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, compresi nell'Offerta		0,00 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

- Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 15 giorni dalla stipula
- Dati di Consegna:
Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
- Dati di Fatturazione:
Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
- Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo verrà spedita a:

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA / CODICE FISCALE:
02201130610
- Termini di pagamento:
60 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Accettazione sopra indicata.
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni

Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.



**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

LETTO ELETTRICO A 4 SEZIONI CON MOVIMENTO SU COLONNE, PIANO IN ABS, SCHIENALE E BACINO TRASLANTI, ALLUNGALETTO INTEGRATO, TRENDELENBURG E CONTROTRENDELENBURG ELETTRICI.

346900Q

IMMAGINE INFORMATIVA - INFORMATIVE PICTURE

54D10 Rev. 05 data: 29/07/16

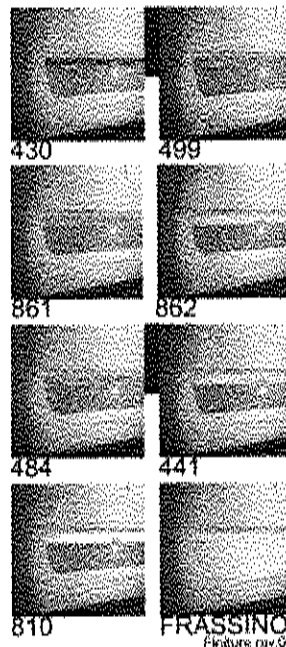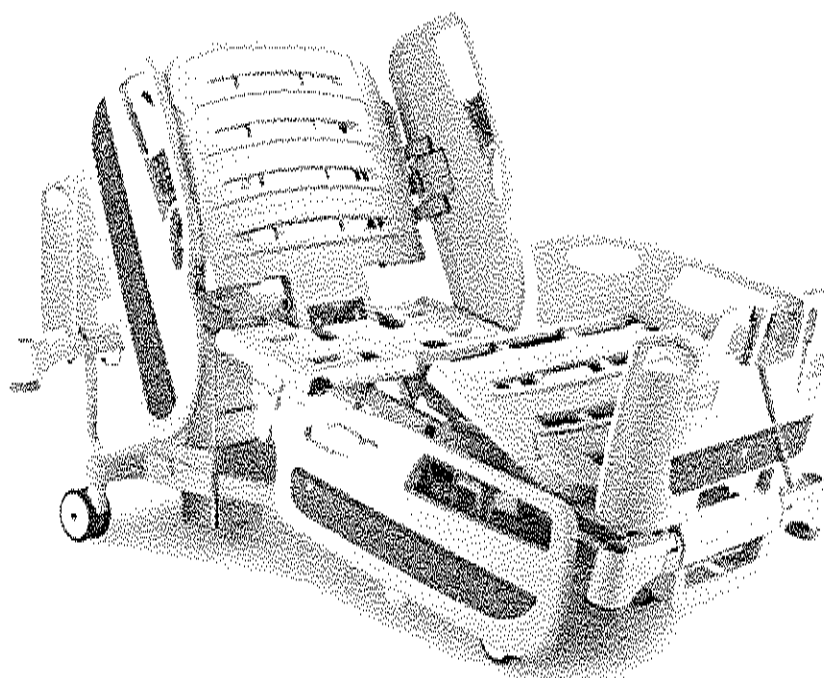

Letto elettrico a 4 sezioni, di cui 3 snodate e 1 fissa centrale ad altezza variabile su due colonne rettangolari, a 3 stadi, motorizzate elettricamente.

Il piano di coricamento e' realizzato in abs facilmente sanificabile ed asportabile (rimovibile) senza spigoli vivi, completo di ferma-materasso integrati.

Il basamento e' realizzato da due longheroni e due trasversi in acciaio saldati e verniciati, con alle estremita' i meccanismi di bloccaggio delle ruote e dotato di coperture in abs termoformato.

Il telaio intermedio e' realizzato in trasversi in trafilato verniciato sostenente il piano dotato di predisposizione per il montaggio di sponde a compasso o a bastoni abbattibili, su ambo i lati del telaio è saldata una barra porta accessori in struttura metallica verniciata con n. 2 ganci in materiale plastico, ognuno con portata di 3 kg, scorrevoli e riposizionabili. Completo di apposite sedi per l'inserimento di asta sollevamato, aste flebo ed accessori dedicati ai 4 angoli.

La regolazione in altezza e' ottenuta tramite una coppia di colonne di sollevamento a tre stadi a bassa tensione 24 V, con carico di sollevamento in sicurezza di 260 kg.

Il letto ha di serie una pulsantiera in uso al paziente ed una consolle comando "SUPERVISOR" ad uso

esclusivo del personale specializzato.

Il comando a pulsantiera secondario per paziente e' integrabile alle sponde con cavo spiralato ed ha le seguenti funzioni:

- tasto di attivazione/spegnimento di sicurezza, con led di accensione
- sollevamento/abbassamento schienale con indicazione a led per funzione inibita;
- sollevamento/abbassamento femorale con indicazione a led per funzione inibita;
- sollevamento/abbassamento contemporaneo di schienale e femorale;
- sollevamento/abbassamento altezza variabile con indicazione a led per funzione inibita;

Tutti i comandi elettrici della pulsantiera paziente sono disattivabili da parte del personale direttamente dalla tastiera operatore.

Il comando a tastiera "SUPERVISOR" per operatore e' integrabile alle spalle ed alle sponde o in apposita sede lato piedi con cavo spiralato e dotato dei seguenti tasti funzione:

- tasto di attivazione/spegnimento di sicurezza, con coppia di led di accensione Indicanti il tipo di alimentazione, rete o batteria in funzione al momento dell'accensione. Quando il letto e' alimentato tramite rete, il led batteria segnala lo stato di carica della batteria.
- sollevamento/abbassamento altezza variabile con indicazione a led per funzione disattivata;
- sollevamento/abbassamento schienale con indicazione a led per funzione disattivata;
- sollevamento/abbassamento femorale con indicazione a led per funzione disattivata;
- sollevamento/abbassamento contemporaneo schienale-femorale (autocontour);
- tasto inibizione funzioni pulsantiera paziente;
- tasto posizione sedia cardiologica con unico comando progressivo;
- coppia tasti comando trendelenburg - controtrendelenburg;
- tasto per l'azzeramento piani rete con contemporaneo sollevamento ad altezza visita (posizione visita);
- tasto per l'azzeramento veloce piani rete con contemporanea discesa ad altezza minima (posizione rianimazione) e uscita sicura letto;
- tasto per l'azzeramento veloce piani rete con contemporaneo movimento di trendelenburg di emergenza (posizione anti-shock).

Le pulsantiere sono dotate di avviso acustico per la segnalazione delle funzioni inibite.

Dopo alcuni minuti di non utilizzo delle pulsantiere, la centralina entra automaticamente in auto-spegnimento, per garantire un bassissimo consumo di energia. Il sistema si riattiva istantaneamente azionando un qualsiasi comando.

Lo schienale ed il femorale traslano automaticamente quando vengono alzati, in modo da compensare la spinta del paziente verso il fondo del letto, alleggerire la compressione nella zona torace/bacino, favorire la respirazione e le corrette posture, riducendo la possibilita' di formazione di piaghe da decubito ed evitando il continuo riposizionamento del paziente. Lo schienale trasla di cm 12 mentre il femorale trasla di cm 4,5 con una traslazione complessiva di cm 16,5.

In caso di emergenza, lo schienale e' abbattibile manualmente tramite la leva di sblocco rapido posto su ambo i lati (cpr); il tutto e' controllato da un sistema di sicurezza anticaduta accidentale servoassistito da doppia molla a gas, le leve sono facilmente individuabili in qualsiasi posizione del letto, anche ad altezza minima, e con le sponde sia in uso che abbassate.

Il letto e' dotato di batteria ausiliaria ricaricabile, che assicura il movimento anche durante il trasporto ed in assenza di corrente elettrica.

La zona gambale e' regolabile manualmente mediante cremagliere ed e' dotata di un controllo meccanico di sicurezza per evitare un'errata angolazione/controrotazione negativa del ginocchio.

Il piano rete e' fornito di serie di allunghetto integrato, estraibile e regolabile su due posizioni, con comando a maniglia posta sotto la pediera. Estrazione totale 330mm.

Il vassoio portabiancheria con vano porta pulsantiera e' integrato a scomparsa nella zona piedi.

Le spalle del letto in materiale plastico con tubolari di innesto e rinforzo in acciaio inox, hanno una particolare conformazione studiata per l'aggancio della tastiera operatore e per la contemporanea eventuale collocazione del compressore per materasso ad aria, con sedi per il passaggio/sostegno delle relative tubature.

Le spalle sono inserite sul letto in apposite sedi dotate di blocco di sicurezza antisfilamento, sbloccabile tramite levette ad eccentrico integrate nella struttura.

La spalla lato testa e' solidale al basamento, in modo da garantire una costante distanza dalla parete testaleto, indipendentemente dalle movimentazioni del piano rete.

E' presente un sistema di allarme acustico di segnalazione in caso di allacciamento alla presa elettrica e ruote non frenate.

Il letto e' completamente verniciato con polveri epossidiche contenenti un particolare additivo antibatterico, il biocote, a base di ioni naturali d'argento.

Viene garantita la lavabilita' e la disinfezione.

Dati tecnici:

Dimensioni piano rete: lung. cm 201x87 idoneo all'uso di materassi compatibili con la tipologia di accessorio-sponde prescelte (in conformita' alla norma UNI CEI EN 60601-2-52).

Dimensioni senza sponde: cm 222x92

Dimensioni con sponde in uso: cm 222x99 (max)

Dimensioni con sponde abbattute: cm 222x98 (max)

Altezza piano rete: H min. cm 40 h max cm 80

Inclinazione schienale: 0°- 71°

Inclinazione femorale: 0°- 30°

Inclinazione gambale: 0°- 20°

Peso del letto (senza accessori): 145 kg.

Carico di lavoro sicuro: 260 kg.

Caratteristiche elettriche:

Alimentazione: 230 V +/- 10 % 50 HZ trasformata in 24 V spina tipo SCHÜKO

Potenza massima assorbita: 370 VA

Classe di isolamento: II - tipo: B

Grado di protezione: attuatori schienale e femorale: IPX6, colonne di sollevamento: IPX6; batteria: IP55; centralina: IP56.

Il letto e' completamente collegato tra i vari componenti tramite ponticelli in rame per eseguire una connessione equipotenziale. Il letto e' dotato di connettore equipotenziale.

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/47/CE.

NORME TECNICHE APPLICATE: CEI EN 60601-1; CEI EN 60601-1-2; UNI CEI EN 60601-2-52.

DISPOSITIVO MEDICO REALIZZATO IN CONFORMITA' ALLA CERTIFICAZIONE ISO 9001 E ISO 13485.



REPERTORIO D.M. N. 451438/R - CODICE CND V0801

**4 RUOTE DIAM. 150 MM GEMELLATE,
DI CUI UNA DIREZIONALE E
BLOCCABILI CONTEMPORANEAMENTE**

300240

IMMAGINE INDICATIVA / INDICATIVE EXAMPLE

MD10 Rev. 03 data 05/02/06

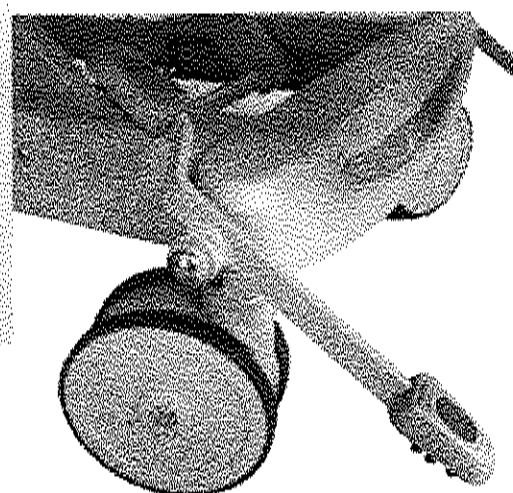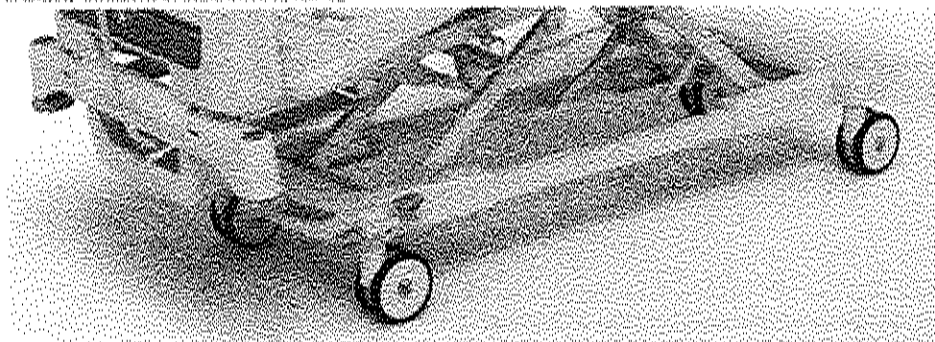

Quattro ruote gemellate in gomma termoplastica di diametro 150 mm antitraccia e antifilo, complete di supporti in materiale plastico.

L'operazione di frenatura simultanea e inserimento di una direzionale avviene dolcemente e senza sforzo, comandata da pedali posti su ambo i lati del basamento al lato piedi.

Pedale e leva freno in fusione di lega leggera verniciata.

Traversi di rinvio della frenatura in profilato esagonale zincato inserito all'interno del basamento.

- con pedale in posizione 1 = blocco simultaneo
- con pedale in posizione 2 = sblocco totale
- con pedale in posizione 3 = blocco ruota direzionale.

**LETTO ELETTRICO SU COMPASSI COMPLETO DI
RUOTE DA 150 GEMELLATE CON SISTEMA
ANTISTATICO, SCHIENALE IN LAMINATO PLASTICO
CON GUIDE, QUINTA RUOTA, BATTERIA, PEDALIERA
ELETTRICA E SPONDE A 4 SETTORI CON COMANDI
INTEGRATI E BILANCIA**

346940HBICU

IMMAGINE INDICATIVA - INDICATIVE EXAMPLE

MD10 Rev.02 Data: 27/07/15 L.



etto elettrico a 4 sezioni, di cui 3 snodate e 1 fissa centrale.

Il piano di coricamento è realizzato in abs facilmente sanificabile ed asportabile (rimovibile) senza spigoli vivi, completo di ferma-materasso integrati.

Il basamento e' realizzato da due longheroni e due traversi in acciaio saldati e verniciati, con alle estremita' i meccanismi di bloccaggio delle ruote e dotato di coperture in abs termoformato. Il telaio intermedio e' realizzato in traversi in trafilato verniciato sostenente il piano dot ato di predisposizione per il montaggio di sponde a compasso o a bastoni abbattibili, su ambo il lati del telaio è salda ta una barra porta accessori in struttura metallica verniciata con n. 2 ganci in materiale plastico, ognuno con portata di 3 kg, scorrevoli e riposizionabili. Completo di apposite sedi per l'inserimento di asta sollevamato, aste flebo ed accessori dedicati ai 4 angoli. La regolazione in altezza e ' ottenuta tramite una coppia di attuatori elettrici a bassa tensione 24 V, con carico di sollevamento in sicurezza di 260 kg.

Il letto ha di serie una pulsantiera in uso al paziente ed una consolle comando "SUPERVISOR" ad uso esclusivo del personale specializzato.

Il comando a pulsantiera secondario per paziente e' integrato alle sponde del letto lato testa ed ha le seguenti

funzioni:

- tasto di attivazione/spegnimento di sicurezza, con led di accensione
- sollevamento/abbassamento schienale con indicazione a led per funzione inibita;
- sollevamento/abbassamento femorale con indicazione a led per funzione inibita;
- sollevamento/abbassamento contemporaneo di schienale e femorale;
- sollevamento/abbassamento altezza variabile con indicazione a led per funzione inibita.

Tutti i comandi elettrici della pulsantiera paziente sono disattivabili da parte del personale direttamente dalla tastiera operatore.

Il comando a tastiera "SUPERVISOR" per operatore e' integrabile alle spalle ed alle sponde o in apposita sede lato piedi con cavo spiralato e dotato dei seguenti tasti funzione:

- tasto di attivazione/spegnimento di sicurezza, con coppia di led di accensione indicanti il tipo di alimentazione (rete o batteria) in funzione al momento dell'accensione. Quando il letto e' alimentato tramite rete, il led batteria segnala lo stato di carica della batteria;
- sollevamento/abbassamento altezza variabile con indicazione a led per funzione disattivata;
- sollevamento/abbassamento schienale con indicazione a led per funzione disattivata;
- sollevamento/abbassamento femorale con indicazione a led per funzione disattivata;
- sollevamento/abbassamento contemporaneo schienale-femorale (autocontour);
- tasto inibizione funzioni pulsantiera paziente;
- tasto posizione sedia cardiologica con unico comando progressivo;
- coppia tasti comando trendelenburg - controtrendelenburg;
- tasto per l'azzeramento piani rete con contemporaneo sollevamento ad altezza visita (posizione visita);
- tasto per l'azzeramento veloce piani rete con contemporanea discesa ad altezza minima (posizione rianimazione) e uscita sicura letto;
- tasto per l'azzeramento veloce piani rete con contemporaneo movimento di trendelenburg di emergenza (posizione anti-shock).

Le pulsantiere sono dotate di avviso acustico per la segnalazione delle funzioni inibite. Dopo alcuni minuti di non utilizzo delle pulsantiere, la centralina entra automaticamente in auto-spegnimento, per garantire un basso consumo di energia. Il sistema si riattiva istantaneamente azionando un qualsiasi comando.

Lo schienale ed il femorale traslano automaticamente quando vengono alzati, in modo da compensare la spinta del paziente verso il fondo del letto, alleggerire la compressione nella zona torace/bacino, favorire la respirazione e le corrette posture, riducendo la possibilita' di formazione di piaghe da decubito ed evitando il continuo riposizionamento del paziente. Lo schienale trasla di cm 12 mentre il femorale trasla di cm 4,5 con una traslazione complessiva di cm 16,5.

In caso di emergenza, lo schienale e' abbattibile manualmente tramite la leva di sblocco rapido posto su ambo i lati (cpr); il tutto e' controllato da un sistema di sicurezza anticaduta accidentale servoassistito da doppia molla a gas, le leve sono facilmente individuabili in qualsiasi posizione del letto, anche ad altezza minima, e con le sponde sia in uso che abbassate.

Il letto e' dotato di batteria ausiliaria ricaricabile, che assicura il movimento anche durante il trasporto ed in assenza di corrente elettrica. La zona gambale e' regolabile manualmente mediante cremagliere ed e' dotata di un controllo meccanico di sicurezza per evitare un'errata angolazione/controrotazione negativa del ginocchio. Il piano rete e' fornito di serie di allungaletto integrato, estraibile e regolabile su due posizioni, con comando a maniglia posta sotto la pediera. Estrazione totale 330mm.

Il vassoio portabiancheria con vano porta pulsantiera e' integrato a scomparsa nella zona piedi.

Le spalle del letto in materiale plastico con tubolari di innesto e rinforzo in acciaio inox, hanno una particolare

conformazione studiata per l'aggancio della tastiera operatore e per la contemporanea eventuale collocazione del compressore per materasso ad aria, con sedi per il passaggio/sostegno delle relative tubature. Le spalle sono inserite sul letto in apposite sedi dotate di blocco di sicurezza antisfilamento, sbloccabile tramite levette ad eccentrico integrate nella struttura. La spalla lato testa e' solidale al basamento, in modo da garantire una costante distanza dalla parete testaleto, indipendentemente dalle movimentazioni del piano rete.

E' presente un sistema di allarme acustico di segnalazione in caso di allacciamento alla presa elettrica e ruote non frenate.

Il letto e' completamente verniciato con polveri epossidiche contenenti un particolare additivo antibatterico, il Biocote®, a base di ioni naturali d'argento.

Viene garantita la lavabilita' e la disinfezione.

Il letto è inoltre completo di:

- 4 RUOTE DIAM. 150 mm GEMELLATE , DI CUI UNA DIREZIONALE, BLOCCABILI CONTEMPORANEAMENTE, CON SISTEMA ANTISTATICO

- SCHIENALE IN LAMINATO PLASTICO COMPLETO DI GUIDE NELLA PARTE POSTERIO RE

- QUINTA RUOTA CENTRALE

- SISTEMA RILEVAMENTO SICUREZZA PIANO: N° 2 LED ad elevata luminosità, uno di colore verde ed uno di colore arancione, fissati sul basamento del letto lato piedi e puntati verso il pavimento, hanno la funzione di segnalare, tramite la loro accensione, se il letto si trova o meno ad altezza minima e quindi in posizione adatta all'uscita sicura del paziente. Il led verde si accende se il letto è ad altezza minima, mentre quello arancione è acceso in caso opposto, richiamando quindi l'attenzione degli operatori.

- COPPIA PEDALIERA ELETTRICA

- SPONDE 4 SETTORI CON MOVIMENTO A RIBALTA

- COMANDI ELETTRICI INTERNI-ESTERNI

DATI TECNICI:

Dimensioni piano rete: lung. cm 201x87 idoneo all'uso di materassi compatibili con la tipologia di accessorio-sponde prescelte (in conformità alla norma UNI CEI EN 60601-2-52).

Dimensioni senza sponde: cm 219x92

Dimensioni con sponde in uso: cm 219x99 (max)

Altezza piano rete: h min. cm 46 H max cm 86

Inclinazione schienale: 0°- 71°

Inclinazione femorale: 0°- 30°

Inclinazione gambale: 0°- 20°

Inclinazione trendelenburg/controtrend +/- 17°

Peso del letto (senza accessori): 120 kg.

Carico di lavoro sicuro: 260 kg.

Caratteristiche elettriche: Alimentazione: 230 V +/- 10 % 50 HZ trasformata in 24 V spina tipo SCHÜKO

Potenza massima assorbita: 370 VA Classe di

isolamento: II - tipo: B

Grado di protezione: attuatori schienale e femorale: IPX6, attuatori di sollevamento: IPX4; batteria: IP55; centralina: IP56.

Il letto e' completamente collegato tra i vari componenti tramite ponticelli in rame per eseguire una connessione equipotenziale. Il letto e' dotato di connettore equipotenziale.

Il letto è dotato di bilancia elettronica integrata con visualizzatore elettronico.

Caratteristiche sistema di pesatura:

- 4 sensori del peso integrati nella struttura. La scelta di 4 sensori posti nei 4 angoli è dovuta al fatto di limitare le flessioni e sollecitazioni dei sensori, e di garantire una maggior durata nel tempo e una maggior distribuzione del carico.
- Visore del peso con display ampio e ben leggibile, collocato su un supporto fisso. Il visore girevole e sfilabile in caso di urgenza.
- Dotato di batteria che garantisce il perfetto funzionamento in assenza di corrente elettrica (4 ore).
- PORTATA 150 Kg divisione 50 g (standard) oppure PORTATA 300 Kg multidivisione: 0-150 kg div. 50 g / 150-300 kg div. 100 g (su richiesta)
- CLASSE DI PRECISIONE III

Funzioni visore:

- TASTO ZERO azzeramento manuale;
- TASTO AGGIUNGI/TOGLI PESO annulla il peso di oggetti durante il ciclo di pesatura;
- TARA MANUALE impostazione di una tara direttamente da tastiera;
- IMPOSTAZIONE SOGLIE ALLARME (sonoro/visivo) per diminuzione/aumento peso paziente;
- ALLARME ASSENZA PAZIENTE (sonoro/visivo) per controllare la discesa dal letto
- FUNZIONE CONGELA PESO memorizza peso, ora, data del paziente.
- Selezione lingua di utilizzo (ITALIANO / INGLESE).
- Funzione di allarme batteria HI-LOW: indica lo stato HIGH-OK-LOW.

Caratteristiche visore:

- Display di peso: Numerico a 6 digit led rossi a 7 segmenti (h=20 mm)
- Led: 5 led indicatori da 5 mm
- Tastiera: a 5 tasti multifunzione
- Dimensioni d'ingombro: 184mm x 80mm x 72mm (l x h x p)
- Porta seriale: Rs232 e Rs485 a scelta;
- Possibilità di comandi funzione via seriale
- Porta LAN
- Porta USB
- Materiale contenitore: ABS
- Grado di protezione: IP60
- Alimentazione: 5 / 7,5 Vcc con alimentatore esterno 230Vac
- Assorbimento max: 6 W
- Isolamento: Classe II
- Categoria d'installazione: Cat. II
- Temperatura di funzionamento: -10°C / +50°C (umidità max 85%)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C / +60°C
- Connessioni: Connettori DSUB 9 e Jack di alimentazione circolare
- Alimentazione celle di carico: 5Vcc/120mA (max 8 celle da 350Ω) protetta da cortocircuito
- Sensibilità d'ingresso: 0.02 µV min. Linearità: < 0.002% del fondoscala
- Deriva in temperatura: < 0.001% del fondoscala / °C
- Risoluzione interna: 24 bit
- Campo di misura: Configurabile da 1mV/V a 0,5V/V
- Frequenza di acquisizione peso: 4 Hz – 60 Hz
- Filtro digitale: Selezionabile 0.1 Hz – 25 Hz

- Conformità alle normative: EN45501

Dispositivo Medico, in Classe Im, conforme alla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE, modificata dalla Direttiva 2007/47/CE.

Norme Tecniche applicate: CEI EN 60601-1; CEI EN 60601-1-2; UNI CEI EN 60601-2-52.

Norme Tecniche applicate Sistema di pesatura: EN 45501.

Dispositivo Medico Certificato dall'Organismo Notificato KIWA CERMET ITALIA Spa – CE0476 (Reg. Numero MED 31211).

Dispositivo Medico realizzato in conformità alla Certificazione ISO 9001 e ISO 13485.

Repertorio D.M. N. 1424427 - Codice CND Z12099003

ALLEGATO N. 2

1/4

acquistinretepa.it

* Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione *

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1457118
Descrizione RdO	Fornitura 9 letti di degenza
Lotto oggetto della Stipula	1 (9 letti per TI CARDIOCHIRURGIA)
CIG	ZE41C9AFA9
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	CAVALLO DONATO /CVLDNT72D16H703P
RUP	donato cavallo
Firmatario del Contratto di Stipula	CAVALLO DONATO /CVLDNT72D16H703P
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	GM. MEDICA SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	05025691212
Codice Fiscale Impresa	05025691212
Indirizzo sede legale	VIA BRECCE A S. ERASMO N. 112/114 - NAPOLI (NA)
Telefono / Fax	0812411827 / 0812417322
PEC Registro Imprese	INFO@GMMEDICA.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	05025691212
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	28/02/2005 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18343539

INPS: Matricola aziendale	5128342326
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20463243/46
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO E TERZIARIO / COMMERCIO E TERZIARIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	3196691
Offerta sottoscritta da	MARIGO ALESSANDRO
Email di contatto	INFO@GMMEDICA.IT
Offerta presentata il	21/12/2016 17:32
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2016 17:35
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore complessivo dell'offerta Economica	39900,00 Euro (trentanovemilanovecento Euro)
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 0,00	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	15 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)

Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
----------------------	--------------------------------

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 27/12/2016 16:31

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Autorizzazione				Provvedimento				Importo	Descrizione
UFF. Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UAQZ1	2016	1	50					48 678,00	fornitura nr.9 letti di degenza.rdo nr.1457118.CIG ZE41C9AFA9

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
48 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 678,00

A.O.S. ANNA E S. SEBASTIANO
CASERTA
IL Direttore U.O.C. Provveditorato
ed Económico
avv. Donato Cavallo



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
DI CASERTA

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n° del

Budget Economico: 2016

Codice Conto: 101020401

Descrizione: ATTREZZATURE SANITARIE

Presente Autorizzazione: ? 48678 1 SUB 50

Caserta, li 29/12/2016

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
DI CASERTA**

Determina Dirigenziale N. 8 del 03/01/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: E-Procurement della Pubblica Amministrazione - Acquisizioni in economia ai sensi dell'art.36 D.Lgs. n.50/2016 mediante RDO (richiesta di offerta) su market place Consip. RDO n.1457118 per la fornitura di n.9 letti di degenza per T.I. Cardiocirurgica - CIG ZE41C9AFA9.

Pubblicata dal 03/01/2017 al 13/01/2017

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Giovanni De Masi

Elenco firmatari

Donato Cavallo - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Giovanni De Masi - UOC AFFARI GENERALI E LEGALI