



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 12 del 16/01/2020

PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

**OGGETTO: INTERVENTO PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURA
ELETTROMEDICALE: FRIGORIFERO BIOLOGICO KW APPARECCHI
SCIENTIFICI SRL, MOD. UKS 1801, MATR. 20041 - 5_2020 - CIG:Z502B7F0F8**

Oggetto: INTERVENTO PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE: FRIGORIFERO BIOLOGICO KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL, MOD. UKS 1801, MATR. 20041 - 5_2020 - CIG:Z502B7F0F8

IL DIRETTORE UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

1. U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA

- 1.1. Con richiesta effettuata sul portale biogest prot. n. 2019/01618 del 29/10/2019, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di intervento tecnico di riparazione, o, in alternativa, di sostituzione a causa dell’usura, della strumentazione di seguito specificata:
 - 1.1.1. Frigorifero Biologico KW Apparecchi Scientifici Srl, mod. UKS 1801, matr. 20041, n. inv. T002187;
- 1.2. con nota del 28/11/2019, la società Hospital Consulting S.p.a., trasmetteva la richiesta di intervento tecnico, prot. n. 2019/01618 del 29/10/2019 della u.o.c. Ostetricia e Ginecologia, comunicando che il predetto intervento rientrava nella manutenzione straordinaria e, pertanto, manifestava la disponibilità a procedere, previa autorizzazione alla risoluzione della problematica in questione;
- 1.3. con mail del 09/12/2019, la scrivente u.o.c. ha inviato richiesta alla società KW Apparecchi Scientifici per intervento tecnico di riparazione o, in alternativa, di sostituzione del seguente strumentario, di seguito specificato:
 - 1.3.1. Frigorifero Biologico KW Apparecchi Scientifici Srl, mod. UKS 1801, matr. 20041, n. inv. T002187;
- 1.4. Con mail del 12/12/2019 in atti giacenti, la società KW Apparecchi Scientifici ha trasmesso, con prot. n°2019_224_MANCOR del 12/12/2019, preventivo per la sostituzione del predetto strumentario per un costo complessivo pari ad € 1.056,60, oltre i.v.a.;
- 1.5. con mail del 12/12/2019, la scrivente u.o.c. ha provveduto a richiedere alla società KW Apparecchi Scientifici l’applicazione di uno sconto sul sopraindicato preventivo;
- 1.6. aderendo alla suddetta richiesta, la società KW Apparecchi Scientifici con mail del 12/12/2019, in atti giacente, ha concesso uno sconto del 6% sul preventivo prot. n° n°2019_224_MANCOR del 12/12/2019, per un totale pari ad € 993,20 oltre i.v.a. 22%, ossia di € 1.212,00 i.v.a 22% compresa;
- 1.7. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla sostituzione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n° n°2019_224_MANCOR del 12/12/2019, con uno sconto applicato del 6%,

Determina Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

presentato dalla società KW Apparecchi Scientifici per un importo complessivo totale pari ad € 1.212,00 i.v.a 22% compresa.

TABELLA N°1 RIEPILOGO INTERVENTI

N°	Società	Bene/i oggetto dell'intervento	Offerta/Preventivo	U.O.C./U.O.S.D. Utilizzatore Bene	Prezzo senza i.v.a.
1	KW Apparecchi Scientifici	Sostituzione registratore grafico	preventivo n° n°2019_224_MANC OR del 12/12/2019, con uno sconto applicato del 6% concesso con mail del 12/12/2019	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	€ 993,20
Totali senza I.V.A.					€ 993,20
I.V.A. 22%					€ 218,80
Totali I.V.A. 22% compresa					€ 1.212,00

Visti

- il D.Lgs. 163/2006;
- il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
- il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
- la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536 pubblicata sulla G.U. n° 265 del 13/11/2012;
- il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 06 del 13/01/2017 e modificato con deliberazione del Direttore Generale n°110 del 23/08/2017, esecutive ai sensi di legge;

Rilevato

che la spesa complessiva derivante dall'approvazione di ciascuna delle offerte in pre messa emarginate, risulta inferiore ai € 50.000,00 e che, pertanto, ai sensi dei succitati decreti, non è necessario ottenere l'autorizzazione preventiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;

Ritenuto

procedere con l'approvazione dell'offerta menzionata in pre messa, riportate nella tabella 1;

Determina Dirigenziale

Considerato

infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- approvare il preventivo riportato in premessa relativo a riparazione di apparecchiatura elettromedicale;
- imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 1.212,00 i.v.a. 22% compresa, come di seguito indicato:
 - per € 1.212,00 i.v.a. 22% compresa sul conto economico 5030301013 – MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI - del bilancio 2019;
- attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, alla riparazione *de qua* il CIG riportato nella tabella 2, di seguito specificata:

Tabella 2

INTERV. N°	SOCIETA’	IMPORTO I.V.A. 22% ESCLUSA	IMPORTO I.V.A. 22% COMPRESA	CIG
1	KW APPARECCHI SCIENTIFICI	€ 993,20	€ 1.212,00	Z502B7F0F8

- prevedere per la riparazione *de qua* la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora venissero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e, per le rispettive competenze, alle unità operative complesse Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea e al Controllo di Gestione;
- pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

**IL DIRETTORE U.O.C.
TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo**

Determina Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Determina Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Oggetto **R: R: Richiesta riparazione per apparecchiatura: Frigorifero biologico KW Apparecchi scientifici Srl mod. UKS 1801 matr. 20041**

Mittente <assistenza@kwkw.it>

Destinatario <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>

Data 12/12/2019 14:54



- 2019_224_MANCOR.pdf (~67 KB)

A voi

-----Messaggio originale-----

Da: tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it
<tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>

Inviato: giovedì 12 dicembre 2019 13:29

A: assistenza@kwkw.it

Oggetto: Re: R: Richiesta riparazione per apparecchiatura: Frigorifero biologico KW Apparecchi scientifici Srl mod. UKS 1801 matr. 20041

In merito al preventivo inviato si chiede l'applicazione di uno sconto.

Cordiali saluti

UOC Tecnologia ospedaliera e HTA

*completato.
fax ricevuto.*

Il 12/12/2019 12:06 assistenza@kwkw.it ha scritto:

Buongiorno,
invio il preventivo richiesto.

Cordiali Saluti
Paolo Rossi Paccani

KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL
Via della Resistenza n. 117-119
I - 53035 MONTERIGGIONI (SI)

Tel. +39 0577 309143-4-5
Fax +39 0577 309142

E-mail assistenza@kwkw.it
Web www.kwkw.it

Informativa Privacy (Reg. UE/679/2016 e D.lgs 196/03): in ottemperanza alla legge sulla tutela dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed indirizzate al destinatario. qualsiasi uso improprio è vietato. se lo avete ricevuto per errore, vogliate avvertire il mittente e distruggerlo. In ogni momento l'interessato, destinatario del messaggio, può esercitare i diritti di accesso sui propri dati, tra i quali chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione, inviandoci una e-mail.

The information contained in this communication is confidential, may be privileged and is intended for the exclusive use of the above named addressee. Accordingly to the law, if you are not the addressee of the message, you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution, or use of it or in reliance of it is strictly prohibited. If you received the message in error, please notify us immediately. The privacy of this communication is protected by the

European law. For any communication, send an e-mail.
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.

-----Messaggio originale-----

Da: tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it
< tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>
Inviato: lunedì 9 dicembre 2019 11:12
A: assistenza@kwkw.it
Oggetto: Richiesta riparazione per apparecchiatura: Frigorifero biologico KW Apparecchi scientifici Srl mod. UKS 1801 matr. 20041

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico per riparazione effettuata dal reparto Ostetricia e Ginecologia dell'apparecchiatura: Frigorifero Biologico KW Apparecchi Scientifici Srl, mod. UKS 1801, matr. 20041 n.inv. T002187, è stata riscontrata la rottura dell'involucro del registratore grafico e dell'asta del pennino ad inchiostro.

Pertanto, si chiede l'invio di un preventivo per la riparazione del suddetto materiale.

Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.

Cordiali saluti

UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA



KW APPARECCHI SCIENTIFICI

VIA DELLA RESISTENZA 119 – 53035 MONTERIGGIONI – SIENA-ITALIA
ASSISTENZA KW TEL.+39-577-309144
e-mail _ assistenza@kwkw.it
REFERENTE : Paolo Rossi Paccani

2019_224_MANCOR

Monteriggioni, lì 12.12.2019

**SPETT.LE
OSPEDALE DI CASERTA**

C.A UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

**OGGETTO:
PREVENTIVO PER SOSTITUZIONE REGISTRATORE A DISCO SU
MOD. UKS 1801 MATR. 20041**

DESCRIZIONE INTERVENTO: SOSTITUZIONE REGISTRATORE GRAFICO

COSTO INTERVENTO (CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI NAPOLI)

Materiale considerato nella sostituzione:

Nr. 1 registratori 35/35 (inclusi 100 dischi e 1 pennino scorta) € 705,60

Manodopera

Manodopera ore 3 x € 85,00 € 255,00

Viaggio

Diritto di chiamata € 96,00

**EVENTUALI SOSTITUZIONI DI MATERIALE ED ULTERIORI EVENTUALI ORE DI MANODOPERA,
SARANNO QUOTATE A PARTE SECONDO NOSTRO LISTINO**

TOTALE	€ 1056,60
Sconto 6%	€ 993,20

Nota : prezzi senza I.V.A.

In attesa di ricevere il V/s gradito ordine,

Vi porgiamo cordiali saluti
Assistenza KW
Paolo Rossi Paccani

S. auton. 13.12.2019
UOC Tecnologia ospedaliera
Innovazione Tecnologica e HTA
Il Direttore

VISITATE IL NOSTRO SITO www.kwkw.it



Oggetto **Re: R: Richiesta riparazione per apparecchiatura: Frigorifero biologico KW Apparecchi scientifici Srl mod. UKS 1801 matr. 20041**

Mittente <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>

Destinatario <assistenza@kwkw.it>

Data 12/12/2019 13:28

In merito al preventivo inviato si chiede l'applicazione di uno sconto.
Cordiali saluti
UOC Tecnologia ospedaliera e HTA

Il 12/12/2019 12:06 assistenza@kwkw.it ha scritto:

Buongiorno,
invio il preventivo richiesto.

Cordiali Saluti
Paolo Rossi Paccani

KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL
Via della Resistenza n. 117-119
I - 53035 MONTERIGGIONI (SI)

Tel. +39 0577 309143-4-5
Fax +39 0577 309142

E-mail assistenza@kwkw.it
Web www.kwkw.it

Informativa Privacy (Reg. UE/679/2016 e D.lgs 196/03): in ottemperanza alla legge sulla tutela dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed indirizzate al destinatario. qualsiasi uso improprio è vietato. se lo avete ricevuto per errore, vogliate avvertire il mittente e distruggerlo. In ogni momento l'interessato, destinatario del messaggio, può esercitare i diritti di accesso sui propri dati, tra i quali chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione, inviandoci una e-mail.

The information contained in this communication is confidential, may be privileged and is intended for the exclusive use of the above named addressee. Accordingly to the law, if you are not the addressee of the message, you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution, or use of it or in reliance of it is strictly prohibited. If you received the message in error, please notify us immediately. The privacy of this communication is protected by the European law. For any communication, send an e-mail.

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.

-----Messaggio originale-----
Da: tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it
<tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>
Inviato: lunedì 9 dicembre 2019 11:12
A: assistenza@kwkw.it
Oggetto: Richiesta riparazione per apparecchiatura: Frigorifero biologico KW Apparecchi scientifici Srl mod. UKS 1801 matr. 20041

Oggetto **R: Richiesta riparazione per apparecchiatura:
Frigorifero biologico KW Apparecchi scientifici
Srl mod. UKS 1801 matr. 20041**

Mittente <assistenza@kwkw.it>

Destinatario <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>

Data 12/12/2019 12:06



- 2019_224_MANCOR.pdf (~66 KB)

Buongiorno,
invio il preventivo richiesto.

Cordiali Saluti
Paolo Rossi Paccani

KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL
Via della Resistenza n. 117-119
I - 53035 MONTERIGGIONI (SI)

Tel. +39 0577 309143-4-5
Fax +39 0577 309142

E-mail assistenza@kwkw.it
Web www.kwkw.it

Informativa Privacy (Reg. UE/679/2016 e D.lgs 196/03): in ottemperanza alla legge sulla tutela dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed indirizzate al destinatario. qualsiasi uso improprio è vietato. se lo avete ricevuto per errore, vogliate avvertire il mittente e distruggerlo. In ogni momento l'interessato, destinatario del messaggio, può esercitare i diritti di accesso sui propri dati, tra i quali chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione, inviandoci una e-mail.

The information contained in this communication is confidential, may be privileged and is intended for the exclusive use of the above named addressee. Accordingly to the law, if you are not the addressee of the message, you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution, or use of it or in reliance of it is strictly prohibited. If you received the message in error, please notify us immediately. The privacy of this communication is protected by the European law. For any communication, send an e-mail.

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.

-----Messaggio originale-----

Da: tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it
tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it
Invia: lunedì 9 dicembre 2019 11:12
A: assistenza@kwkw.it
Oggetto: Richiesta riparazione per apparecchiatura: Frigorifero biologico KW Apparecchi scientifici Srl mod. UKS 1801 matr. 20041

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico per riparazione effettuata dal reparto Ostetricia e Ginecologia dell'apparecchiatura:
Frigorifero Biologico KW Apparecchi Scientifici Srl, mod. UKS 1801, matr. 20041 n.inv. T002187, è stata riscontrata la rottura dell'involucro del registratore grafico e dell'asta del pennino ad inchiostro.

Pertanto, si chiede l'invio di un preventivo per la riparazione del suddetto materiale.

Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.

Cordiali saluti

UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA



KW APPARECCHI SCIENTIFICI

VIA DELLA RESISTENZA 119 – 53035 MONTERIGGIONI – SIENA-ITALIA
ASSISTENZA KW TEL.+39-577-309144
e-mail _ assistenza@kww.it
REFERENTE : Paolo Rossi Paccani

2019_224_MANCOR

Monteriggioni, lì 12.12.2019

**SPETT.LE
OSPEDALE DI CASERTA**

C.A UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

OGGETTO:

**PREVENTIVO PER SOSTITUZIONE REGISTRATORE A DISCO SU
MOD. UKS 1801 MATR. 20041**

DESCRIZIONE INTERVENTO: SOSTITUZIONE REGISTRATORE GRAFICO

COSTO INTERVENTO (CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI NAPOLI)

Materiale considerato nella sostituzione:

Nr. 1 registratore 35/35 (inclusi 100 dischi e 1 pennino scorta) € 705,60

Manodopera

Manodopera ore 3 x € 85,00 € 255,00

Viaggio

Diritto di chiamata € 96,00

**EVENTUALI SOSTITUZIONI DI MATERIALE ED ULTERIORI EVENTUALI ORE DI MANODOPERA,
SARANNO QUOTATE A PARTE SECONDO NOSTRO LISTINO**

TOTALE	€ 1056,60
Nota : prezzi senza I.V.A.	

In attesa di ricevere il V/s gradito ordine,

Vi porgiamo cordiali saluti
Assistenza KW
Paolo Rossi Paccani

VISITATE IL NOSTRO SITO www.kww.it

Oggetto **Richiesta riparazione per apparecchiatura:
Frigorifero biologico KW Apparecchi scientifici
Srl mod. UKS 1801 matr. 20041**

Mittente <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>

Destinatario <design@kwkw.it>

Data 09/12/2019 11:43



In riferimento alla richiesta di intervento tecnico per riparazione effettuata dal reparto Ostetricia e Ginecologia dell'apparecchiatura: Frigorifero Biologico KW Apparecchi Scientifici Srl, mod. UKS 1801, matr. 20041 n.inv. T002187, è stata riscontrata la rottura dell'involucro del registratore grafico e dell'asta del pennino ad inchiostro.

Pertanto, si chiede l'invio di un preventivo per la riparazione del suddetto materiale.

Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.

Cordiali saluti

UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA

Oggetto **Richiesta riparazione per apparecchiatura:
Frigorifero biologico KW Apparecchi scientifici
Srl mod. UKS 1801 matr. 20041**

Mittente <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>

Destinatario <assistenza@kwkw.it>

Data 09/12/2019 11:11



In riferimento alla richiesta di intervento tecnico per riparazione effettuata dal reparto Ostetricia e Ginecologia dell'apparecchiatura: Frigorifero Biologico KW Apparecchi Scientifici Srl, mod. UKS 1801, matr. 20041 n.inv. T002187, è stata riscontrata la rottura dell'involucro del registratore grafico e dell'asta del pennino ad inchiostro.

Pertanto, si chiede l'invio di un preventivo per la riparazione del suddetto materiale.

Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.

Cordiali saluti

UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA



H.C. Hospital Consulting S.p.A.
Via Di Scolvigne, 60/1 – Loc. Grassina
50012 Bagno a Ripoli – Firenze – Italia
Tel (+39) 055 6498 51
Fax (+39) 055 6498 680
www.hospital-consulting.it

Società Unipersonale
Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.
C.F./ P. IVA e Reg. Imprese: FI03010380487
C.C.I.A.A. FI REA: 293209



ASSOCIAZIONE Oice

Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
Via F. Palasciano
81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 28/11/2019
W1911292

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.

**Proposta di riparazione per apparecchiatura: Frigorifero Biologico KW
Apparecchi Scientifici Srl mod. UKS 1801 matr. 20041 n°inv. T002187 in
dotazione al reparto Ostetricia e Ginecologia.**

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico, 2019/01618 del 29/10/2019 relativa all'apparecchiatura in oggetto, si riscontra rottura dell'involucro del registratore grafico e dell'asta del pennino ad inchiostro.

Poiché l'intervento rientra nella manutenzione straordinaria (guasto riconducibile a guasto accidentale), si comunica la disponibilità, previa autorizzazione, ad effettuare la relativa sostituzione del suddetto registratore come di seguito:

Descrizione	Nº	Importo oltre IVA
REGISTRATORE GRAFICO Compresi 100 dischi ed 1 pennino scorta	1	€ 917,28

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

X Silvana

S. cust. na 5/12/2013

UOC Tecnologia Ospedaliera
Innovazione Tecnologica e HTA
Il Direttore

HC Hospital Consulting S.p.A.
ing. Maurizio Caputo

ASSISTENZA@KUKW.IT



Allegati: FdL, Foto

W1911292

1/1

Direzione e Coordinamento di HERMED (GERMANIA) – GRUPPO VAMED



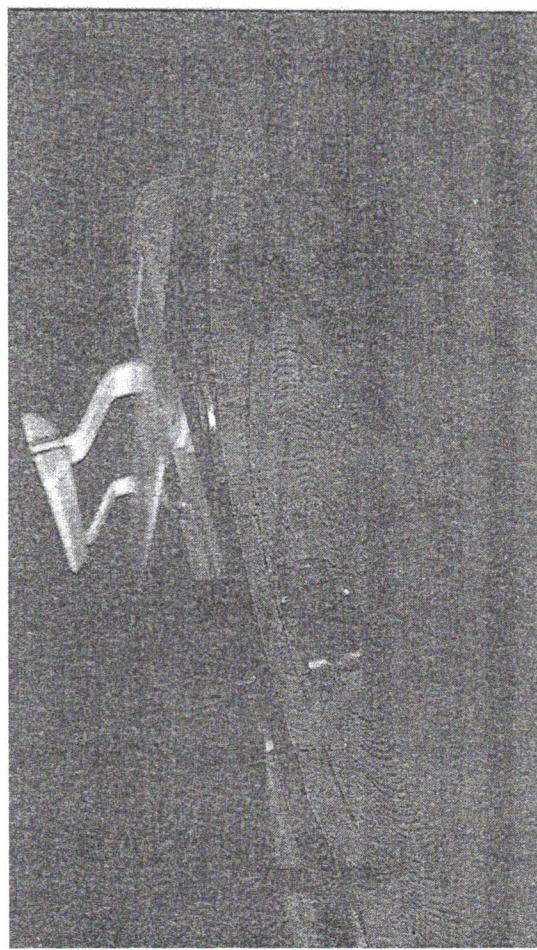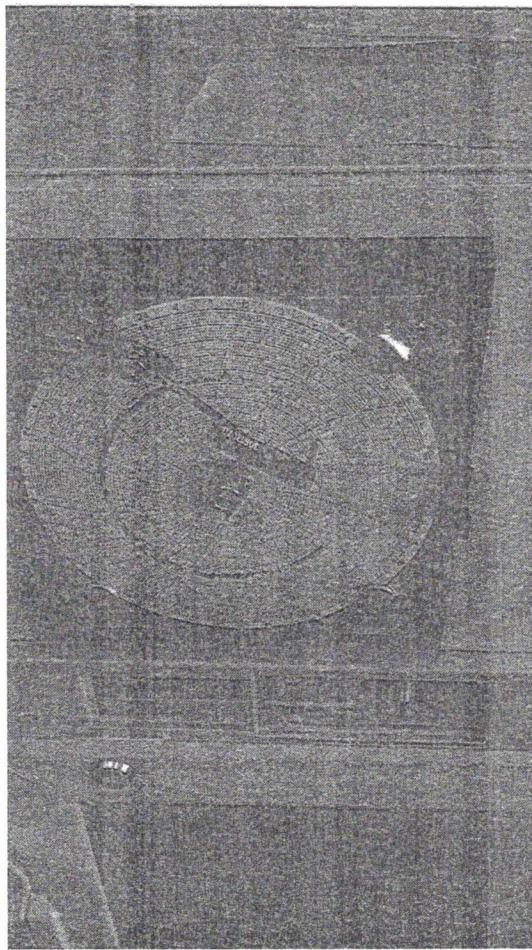

A.O. S.Anna e S.Sebastiano di Caserta
RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETtagli Intervento

Codice 2019/01618/01	Tipo Correttiva
Data Inizio 29/10/2019	Date Fine 29/10/2019
Ora Inizio 14:44	Ora Fine 15:44

DETtagli APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio T002187	Presidio Ospedale S.Anna e S.Sebastiano
Descrizione FRIGORIFERO BIOLOGICO	Reparto OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Costruttore KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	Stanza PREANESTESIA E RISVEGLIO
Modello UKS 1801	Matricola 20041 Inventario Ente 21593

GUASTO RISCONTRATO

si riscontra rottura accidentale registratore grafico temperatura

DESCRIZIONE INTERVENTO

necessita sostituzione registratore grafico

Ore lavoro 01:00

Ore viaggio 00:00

ESITO INTERVENTO

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico Santillo Antonio Firma Tecnico



Cognome Nome Utente GUARINO

Firma Utente





**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

**INTERVENTO PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE: FRIGORIFERO BIOLOGICO
KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL, MOD. UKS 1801, MATR. 20041 - 5_2020 - CIG:Z502B7F0F8**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €993,20

- è di competenza dell'esercizio 2019 , imputabile al conto economico 5030301013 - Manutenzione ord. attrez. san. piccoli interventi da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 16/01/2020

**il Dirigente GEF incaricato
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri**



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 12 del 16/01/2020

PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

**OGGETTO: INTERVENTO PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE:
FRIGORIFERO BIOLOGICO KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL, MOD. UKS 1801, MATR.
20041 - 5_2020 - CIG:Z502B7F0F8**

In pubblicazione dal 16/01/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI