
Determina Dirigenziale N. 597 del 09/07/2021

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI N. UN SISTEMA IDROCHIRURGICO PER LA CURA DELLE FERITE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE.CIG[ZE4323EEF0]

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 09/07/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI N. UN SISTEMA IDROCHIRURGICO PER LA CURA DELLE FERITE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE.CIG[ZE4323EEF0]

Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con nota prot. n.15820 del 18.05.2021, il Responsabile dell'U.O.C. Chirurgia Vascolare ha richiesto la fornitura di n°1 sistema idrochirurgico per il debridement di tessuti necrotici e danneggiati quali presenti nelle lesioni del piede e delle ulcere difficili;
- con annotazione posta a margine della succitata nota, il Direttore Sanitario ha autorizzato l'acquisto del sistema succitato;

Considerato che

- in relazione all'oggetto della fornitura ed all'importo necessario per l'affidamento dei beni di che trattasi, è possibile procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che

- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che *“per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto”*;
- all'interno del portale degli *“Acquisti in Rete della PA”* gestito dalla ConsipS.p.A., non risulta attiva, al momento, alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro contenente la tipologia di beni da acquisire;

Rilevato che

- in data 24.06.2021, è stata condotta, quindi, sulla piattaforma MEPA la trattativa diretta n.1751816 con l'operatore economico SMITH & NEPHEW SRL, che ha offerto un importo di € 39.800,0 oltre IVA per la fornitura di n.1 sistema idrochirurgico VERSAJET comprensivo di n.100 manipoli monouso delle diverse tipologie;

Evidenziato che

il suddetto importo è da considerarsi congruo;

Ritenuto

di dover prendere atto dell'esito della trattativa diretta n. 1751816 attivata su MEPA Consip e per l'effetto, di affidare la fornitura di n. 1 sistema idrochirurgico VERSAJET comprensivo di n.100 manipoli monouso all'operatore economico SMITH & NEPHEW SRL per un importo complessivo di € 39.800,00 oltre IVA;

Attestata

la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

Determinazione Dirigenziale

DETERMINA

1. di prendere atto dell'esito della trattativa diretta n. 1751816 attivata su MEPA Consip e per l'effetto, di affidare la fornitura di n. 1 sistema idrochirurgico VERSAJET comprensivo di n.100 manipoli monouso, all'operatore economico SMITH & NEPHEW SRL per un importo complessivo di € 39.800,00 oltre IVA, per le esigenze della u.o.c. Chirurgia Vascolare;
2. di imputare la spesa complessiva pari a € 48.556,00 iva inclusa sul conto economico 5010107010- DISPOSITIVI MEDICI del corrente bilancio 2021;
3. di attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, alla fornitura *de quibus* il seguente CIG [ZE4323EEF0];
4. di dare atto che nei documenti allegati, al presente provvedimento, qualora compaiano dati personali, gli stessi sono stati oscurati nel rispetto delle normative vigenti in materia;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ed all'UU.OO.CC. Gestione Economico Finanziaria, U.O.C. Chirurgia Vascolare Farmacia e Provveditorato e Farmacia;
6. di pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

18/05/2021 12.30-20210015820



11.06

allec. A.

In g. Romano
Vedete le valutazioni dell'apparacchiature
elettroniche definite relativamente
all'attuale sviluppo dell'U.O.C. dopo
la riunione svolta nell'U.O.C.
Le supposte tecniche fornite dalla
Tecosol. Osped. e elencate
oggetto: richiesta sistema idrochirurgico per la cura delle ferite

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIOLOGICHE E
VASCOLARI
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
DI CHIRURGIA VASCOLARE ED ENDOVASCOLARE
Direttore: Prof. Eugenio Martelli

Alla U.O.C. Farmacia

Alla U.O.C. Provveditorato

Alla U.O.C Tecnologia Ospedaliera
loro sedi

H. Direttore Sanitario
Angela ANNECHIARICO

per le necessità della nostra U.O.C. si richiede sistema idrochirurgico per il debridement di tessuti necrotici e danneggiati quali quelli presenti nelle lesioni del piede diabetico e delle ulcere difficili, trattati quotidianamente presso la nostra U.O.C.

Il sistema idrochirurgico richiesto per essere efficace deve consentire il taglio, l'ablazione e la rimozione del tessuto danneggiato o necrotico dalle lesioni cutanee sfruttando il cosiddetto "effetto Venturi" per un valido debridement delle ferite.

Generalmente il sistema idrochirurgico è composto da una consolle operativa e da manipoli monouso in varie misure.

In particolare, per le esigenze della nostra U.O.C. si stima un fabbisogno annuo di manipoli monouso così come di seguito elencato:

manipoli Plus da 15°/14 mm pezzi n. 5

manipoli Plus da 45°/14 mm pezzi n. 20

manipoli Plus da 45°/08 mm pezzi n. 5

manipoli Exact da 15°/14 mm pezzi n. 5

manipoli Exact da 45°/14 mm pezzi n. 10

manipoli Exact da 45°/08 mm pezzi n. 5

In attesa di favorevole riscontro si porgono distinti e cordiali saluti.

Caserta, 18.05.2021

A.O.R.N.
Sant'Anna e San Sebastiano
Il Primario CONFERMANO
U.O.C. Chirurgia Vascolare
Prof. Eugenio Martelli
Dott. E. Martelli


Direttore: Prof. E. Martelli

Dirigenti medici:

Dr. A. Bauleo
Dr. R. Carbone
Dr. D. Ceriello
Dr. G. Coppola
Dr. C. De Gregorio
Dr. G. Guarino
Dr. G. Sabino

U.O.C. Chirurgia Vascolare
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
Sant'Anna e San Sebastiano Caserta
Via Palasciano 81100 - Caserta
Tel. 0823-32783
e-mail: chirurgiavascolare@ospedale.caaserta

 smith&nephew
VERSAJET® II
Hydrosurgery System

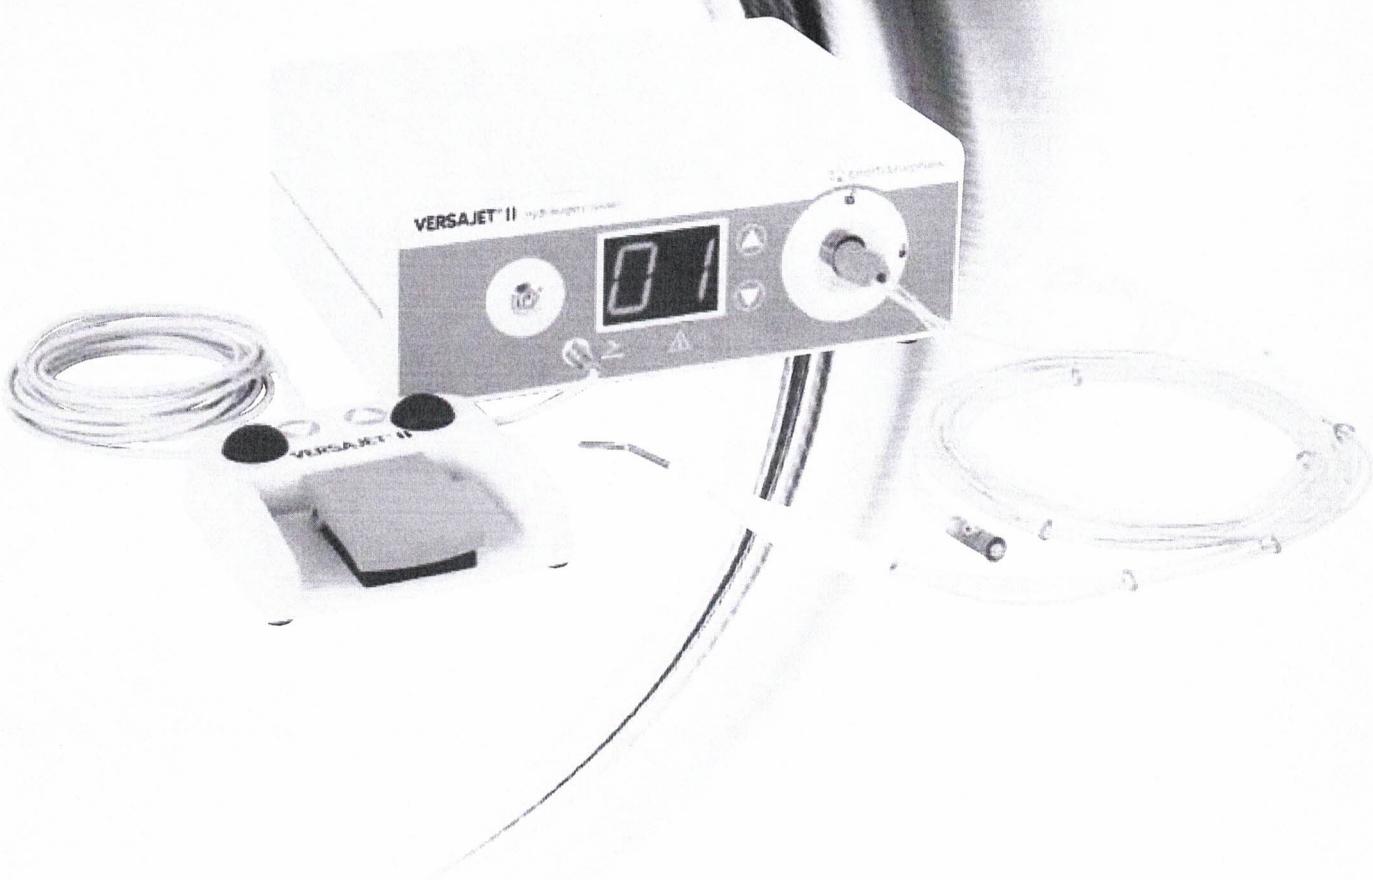

Debridement chirurgico selettivo

Preserva il tessuto vitale e riduce il tempo di chiusura^{1,2}

Smith & Nephew è al tuo fianco per ridurre i costi umani ed economici delle ferite.
Per i pazienti. Per il budget. Adesso.®

Rimozione precisa

Ottimizzare il debridement chirurgico con l'idrobisturi VERSAJET® II

Il sistema VERSAJET II permette al chirurgo una grande precisione nel selezionare, distaccare ed evacuare il tessuto non vitale, i batteri ed altri contaminanti dal letto da ferite, ustioni* e altre lesioni ai tessuti molli utilizzando una tecnica rispettosa dei tessuti sani.^{1,3,4}

La tecnologia avanzata dell'idrobisturi contribuisce a ridurre il tempo necessario alla chiusura delle ferite, fattore che può diminuire il costo globale del trattamento.^{1,3}



Precisione e controllo

Idrobisturi, l'acqua che taglia

Il sistema VERSAJET II utilizza un getto di soluzione salina ad alta pressione per ottimizzare il debridement chirurgico.^{1,3,5}

Quando il manipolo viene mosso tangenzialmente sopra la ferita, il sottilissimo getto d'acqua del dispositivo rimuove rapidamente il tessuto necrotico, i batteri e il *debris*, risparmiando il tessuto vitale intorno.¹⁻⁵


VERSAJET II prepara rapidamente un letto di ferita pulito e uniforme, rimuovendo contemporaneamente diverse barriere alla guarigione.^{2,3,4}

Movimento tangenziale con un getto di soluzione salina ad alta velocità



Selezione

Isola il tessuto necrotico e il *debris* utilizzando il vuoto localizzato^{1,3-5}

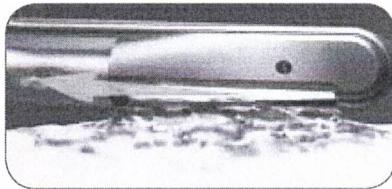

Rimuove

Stacca il tessuto non vitale con la massima precisione^{1,3-5}




Allontana

Aspira il *debris* e lo *slough* mentre preserva il tessuto sano^{1,3-5}


*Ustioni a spessore totale devono essere prima trattate con bisturi.

Precisione per preservare i tessuti sani

Rimozione chirurgica tradizionale

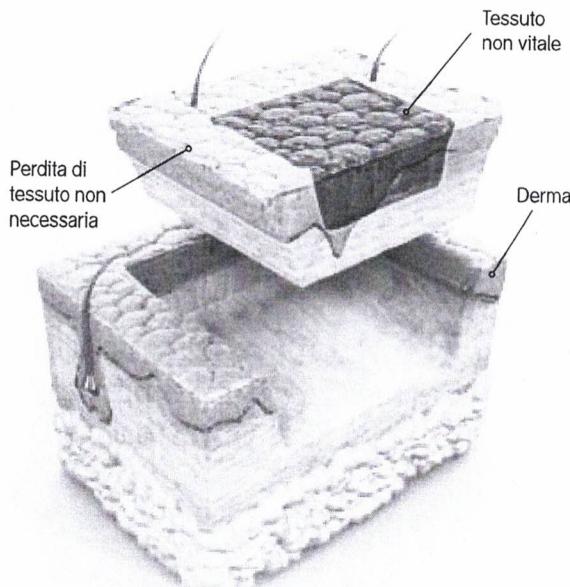


Rimozione con VERSAJET® II

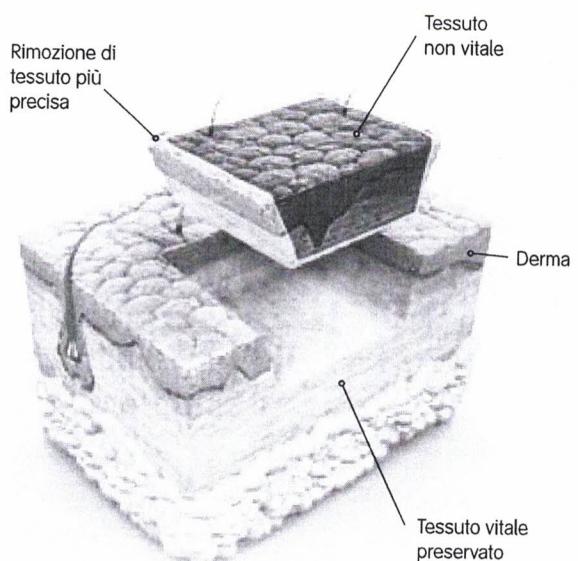


Adattato da: Cubison TC, Pape SA, Jeffery SL. *Burns*. 2006;32:714-720.

Ottener la massima conservazione dei tessuti

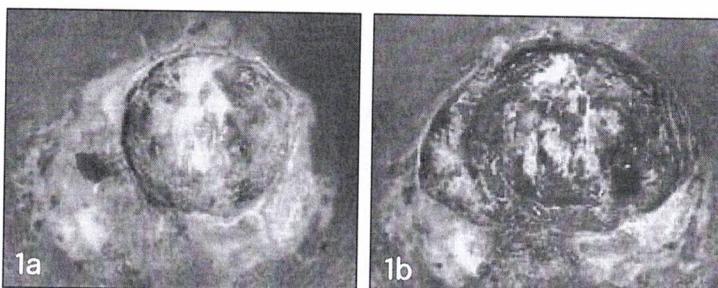

Perdita di tessuto

Debridement centripeto:
ulcera da pressione sacrale
di IV stadio prima (1a) e dopo
(1b) un intervento di rimozione
chirurgica tradizionale⁶

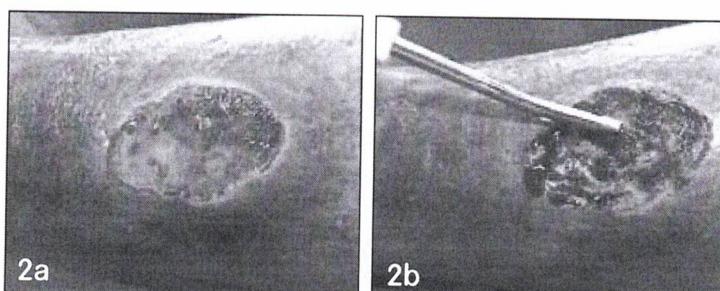

Conservazione del tessuto

Debridement centrifugo:
ulcera cronica agli arti
inferiori prima (2a) e dopo
(2b) la rimozione precisa con
VERSAJET⁶

Adattato da: Abernathie B, Granick MS.
J Wound Technol. 2009;5:10-11.

Controlla con precisione la profondità del debridement⁷

Escissione tangenziale (Bisturi Goulian, 10 gradi)

Rimozione ad una profondità
di 750µm⁷

Sistema VERSAJET

Permette una rimozione precisa ad
una profondità di 50µm⁷

Precisione e performance

Efficacia clinica

Aiuta a ridurre il tempo necessario alla chiusura della ferita^{1,2}


Crea un letto uniforme che migliora i risultati degli innesti e delle medicazioni sintetiche⁴

Riduce la carica batterica e altri elementi inibitori^{1,2,3}


Rimuove il tessuto in eccesso e i contaminanti, mentre preserva il tessuto sano^{1,3,5}

Permette di accedere ad aree difficili da raggiungere con semplicità e controllo^{4,5}


Tempo di chiusura della ferita ridotto del 33%⁸

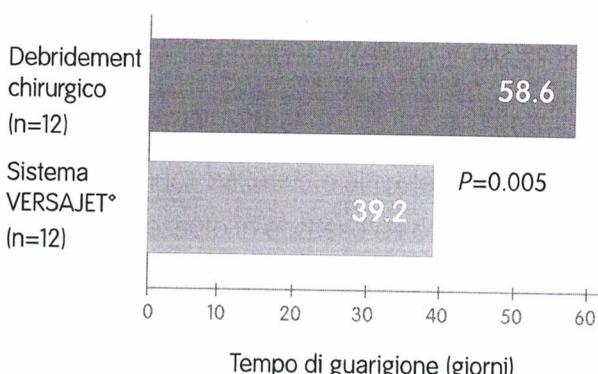


Una sola procedura operatoria richiesta nel 76% dei pazienti²

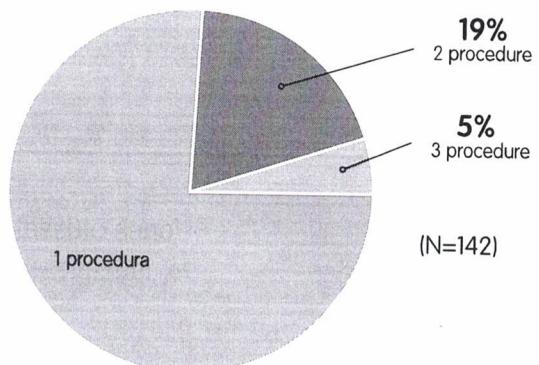


Carica batterica ridotta di 3 log²

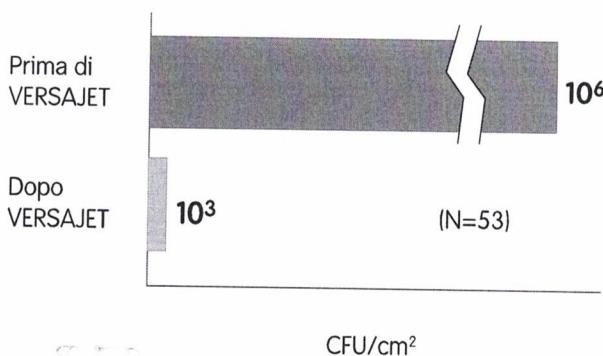

Attecchimento immediato nel 95% delle procedure di innesto⁴

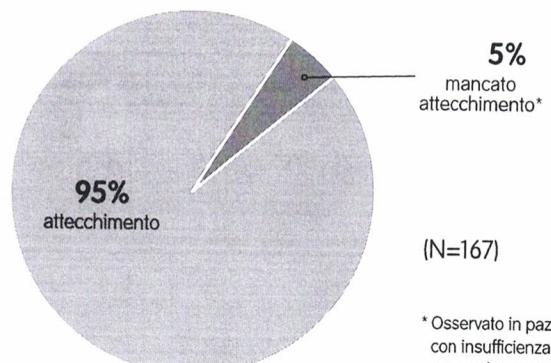

* Osservato in pazienti con insufficienza venosa lasciata non controllata nel periodo post-operatorio.

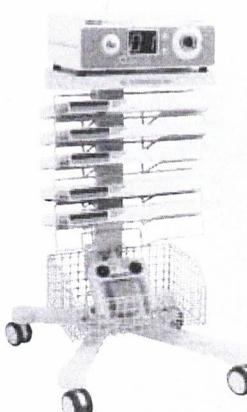

Il sistema VERSAJET II

Separà il tessuto
non vitale

Risparmia il
tessuto vitale

Precisione e valore

Efficacia dei costi

Richiede meno procedure di debridement, fattore che può migliorare i profitti dell'ospedale¹


Aiuta a ridurre il tempo necessario alla chiusura della ferita, potenzialmente accorciando la permanenza in ospedale^{1,2}

Rimuove i batteri aiutando a ridurre i rischi di infezione^{1,2,3}


Velocizza le procedure permettendo un maggiore utilizzo della sala operatoria^{1,3,9}

Permette di utilizzare meno strumenti e materiali, potenzialmente riducendo i costi per procedura⁹


Risparmio di \$1900 per paziente, come risultato del minor numero di procedure¹

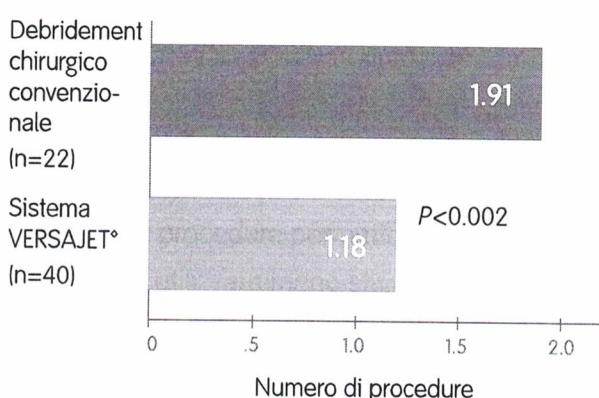

Tempo necessario al debridement ridotto del 39% per ogni paziente⁹

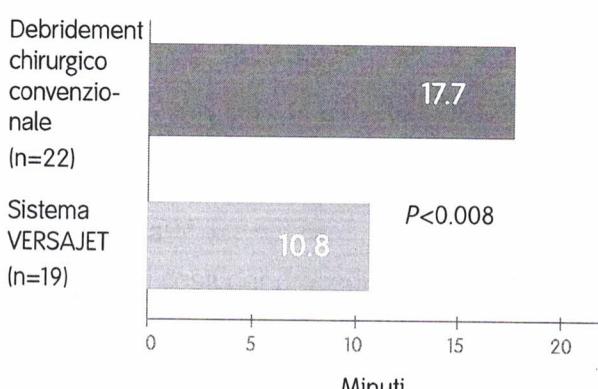

La durata media dell'ospitalizzazione risulta ridotta di circa 3 giorni²

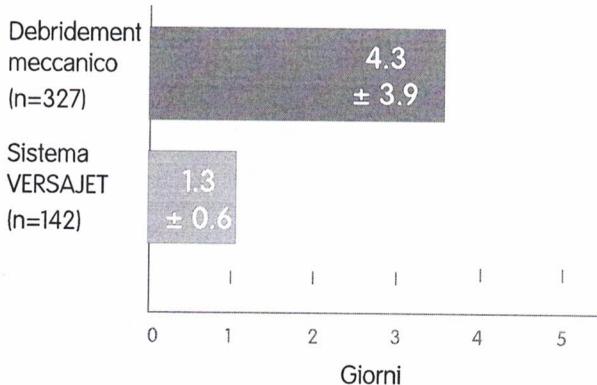

“In un sistema che dipende da pagamenti prospettici basati sulle diagnosi [DRG], ogni riduzione nel numero di procedure ospedaliere impatta direttamente nei margini di profitto dell'ospedale”.¹

Riduce il tempo alla chiusura

Riduce i costi di trattamento

Migliora i risultati

Il nuovo idrobisturi Versajet® II

Progettato per ottimizzare i risultati clinici ed economici.

Grazie all'esperienza maturata negli anni e condivisa con i clinici di tutto il mondo, sono state apportate una serie di migliorie al sistema Versajet.

Tutte le novità introdotte vanno nella direzione di mantenere l'efficacia del sistema e di aumentarne l'efficienza, allo scopo di garantire la costanza delle performance e arricchire l'esperienza di utilizzo.


Sistema ri-ingegnerizzato

- Set-up del dispositivo più rapido e veloce
- Migliore controllo delle operazioni





Connessione intuitiva

- Meccanismo di bloccaggio «a serratura»
- Set-up più rapido¹⁰
- Performance costante

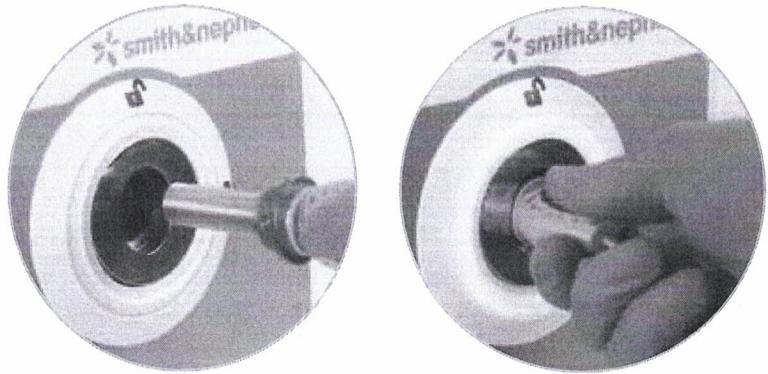

Indicatore di bloccaggio luminoso

- I simboli indicano le corrette posizioni di bloccaggio e sbloccaggio
- La luce verde indica l'avvenuto armamento del manipolo

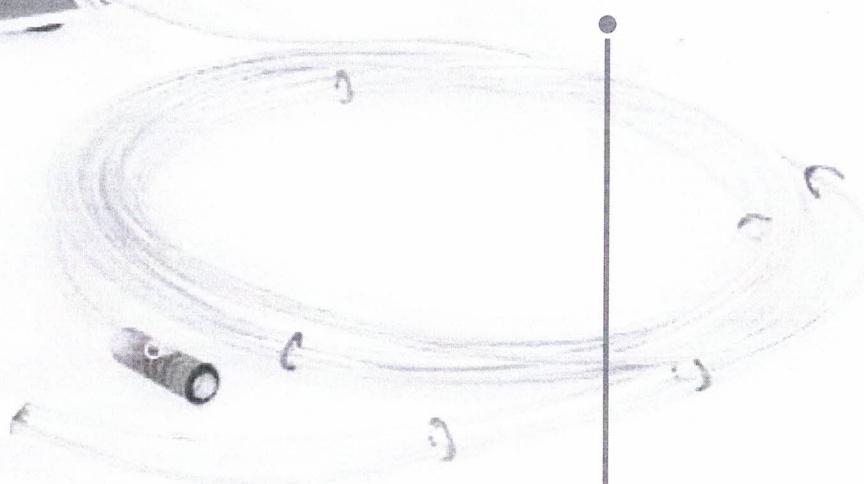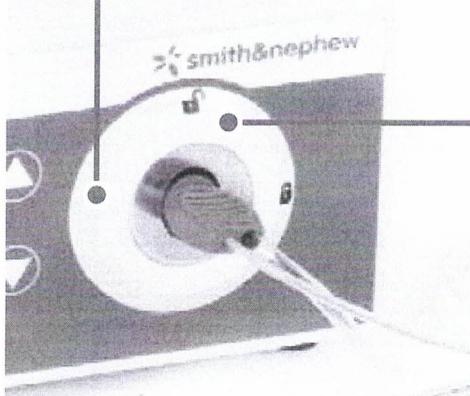

Display LED di grandi dimensioni

- Misure aumentate del 150%
- Chiara lettura della potenza impostata fino a 5 m di distanza



Iniettore a gravità

- Connessione linea acqua più rapida
- Riduce i tempi di set-up¹⁰

Informazioni sui MANIPOLI




Manipoli VERSAJET® II Exact

Per la massima preservazione del derma
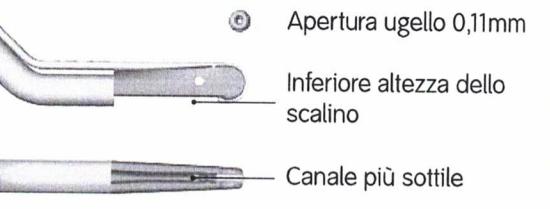
| Cod. | Descrizione |
|--|---|
|  | VERSAJET II Exact Manipolo monouso (45°/14mm) |
|  | VERSAJET II Exact Manipolo monouso (45°/8mm) |
|  | VERSAJET II Exact Manipolo monouso (15°/14mm) |
|  <ul style="list-style-type: none"> ● Apertura ugello 0,11mm Inferiore altezza dello scalino Canale più sottile | |


Manipoli VERSAJET® II Plus

Per la migliore rimozione di tessuto non vitale e contaminanti[†]
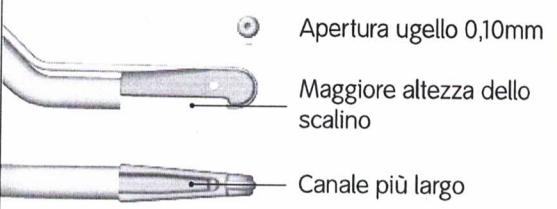
| Cod. | Description |
|--|--|
|  | VERSAJET II Plus Manipolo monouso (45°/14mm) |
|  | VERSAJET II Plus Manipolo monouso (45°/8mm) |
|  | VERSAJET II Plus Manipolo monouso (15°/14mm) |
|  <ul style="list-style-type: none"> ● Apertura ugello 0,10mm Maggiore altezza dello scalino Canale più largo | |

[†] Il manipolo VERSAJET II Plus è più potente rispetto a VERSAJET II Exact. VERSAJET II Plus seleziona, stacca e asporta il tessuto più velocemente e in maniera più aggressiva. VERSAJET II Plus va usato solo in sala operatoria e solo da personale adeguatamente formato.

Smith & Nephew accompagna la guarigione del paziente con una gamma di prodotti completa



RENASYS® e PICO®

Sistemi per la Terapia a Pressione Negativa per la **preparazione** e la **promozione** della granulazione.




ACTICOAT®

Barriera all'argento nanocristallino per **proteggere** le ferite a rischio di infezione.



ALLEVYN®

Gestione dei fluidi per creare il corretto ambiente umido e promuovere la guarigione dopo la NPWT.



BIOBRANE®

Sostituto epidermico per la **protezione** della ferita e la **promozione** della riepitilizzazione.

Riferimenti bibliografici:

- Granick MS, Posnett J, Jacoby M, Noruthun S, Ganchi PA, Datiashvili RO. Efficacy and cost-effectiveness of a high-powered parallel waterjet for wound debridement. *Wound Repair Regen.* 2006;14:394-397.
- Mosti G, Mattaliano V. The debridement of chronic leg ulcers by means of a new, fluidjet-based device. *Wounds.* 2006;18:227-237.
- Granick M, Boykin J, Gamelli R, Schultz G, Tenenhaus M. Toward a common language: surgical wound bed preparation and debridement. *Wound Repair Regen.* 2006;14:S1-S10.
- Cubison TC, Pape SA, Jeffery SL. Dermal preservation using the Versajet hydrosurgery system for debridement of paediatric burns. *Burns.* 2006;32:714-720.
- Vanwijck R, Kaba L, Boland S, Gonzalez y Azero M, Delange A, Tourbach S. Immediate skin grafting of sub-acute and chronic wounds debrided by hydrosurgery. *J Plast Reconstr Aesthet Surg.* 2010;63:544-549.
- Abernathie B, Granick MS. Centrifugal debridement: tissue sparing surgical treatment of chronic wounds. *J Wound Technol.* 2009;5:10-11.
- Jeffery SLA. Device related tangential excision in burns. *Injury, Int J Care Injured.* 2007;38:S35-S38.
- Paola LD, Brocco E, Senesi A, De Vido D, Merico M, Ninkovic S. The use of VERSAJET in the limb salvage following failure of minor amputation in diabetic foot. Data on file report 4649/5025.
- Caputo WJ, Beggs DJ, Defede JL, Simm L, Dharma H. A prospective randomised controlled clinical trial comparing hydrosurgery debridement with conventional surgical debridement in lower extremity ulcers. *Int Wound J.* 2008;5:288-294.
- Lieber C, et al. A volunteer evaluation of the functionality and device performance comparing a next generation Hydrosurgery System to the current Hydrosurgery System. 2011 Eur. Burn Assn.,P114

Wound Management

Smith & Nephew S.r.l.
Via De Capitani, 2A
20864 Agrate Brianza (MB)

T +39 039 60941
F +39 039 65153
Numero verde: 800 39 30 60

contattaci@smith-nephew.com
www.smith-nephew.it/wound

*Marchio di Smith & Nephew

PROSPETTO AGGIUDICAZIONE

Smith & Nephew Srl
Via dei Capitani nr. 2A - 20864 Agrate Brianza (MB)
P.IVA: 00953780962

| Q.tà mesi | descrizione articolo | CIG | Codice | CND | NR. REP. DM. | prezzo unitario | Totale |
|--------------|--|------------|----------------------------------|-------|--------------|--------------------|--------------------|
| 42 | VERSAJET II EXACT - set manipolo monouso di alimentazione con tubo flessibile, cartuccia con pompa integrata, tubi flessibili per irrigazione ad alta e bassa pressione. Tubo flessibile di aspirazione 15° fin 14mm 45° fin 14mm 45° fin 8mm | Z7220853E0 | 66800040 66800041 66800042 | K0199 | 471258/R | € 459,00 | € 19.278,00 |
| | VERSAJET II PLUS - set manipolo monouso di alimentazione con tubo flessibile, cartuccia con pompa integrata, tubi flessibili per irrigazione ad alta e bassa pressione. Tubo flessibile di aspirazione 15° fin 14mm 45° fin 14mm 45° fin 8mm | | 66800043 66800044 66800045 | K0199 | 473028/R | | |
| | | | | | | IVA 22% | € 4.241,16 |
| | | | | | | totale | € 23.519,16 |

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

| | |
|--|--|
| Numero Trattativa | 1751816 |
| Descrizione | Fornitura in comodato d'uso gratuito, installazione e collaudo in loco di N. 1 sistema VERSAJET comprensivo di materiale di consumo |
| Tipologia di trattativa | Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) |
| Soglia di rilevanza comunitaria | Sotto soglia |
| Modalità di svolgimento della procedura | Telematica (on line) |
| Modalità di definizione dell'offerta | Prezzo a corpo |
| CIG | ZE4323EEF0 |
| CUP | Non inserito |
| Amministrazione titolare del procedimento | AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA 02201130610 81100 Via Tescione CASERTA (CE) |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | 551B2G |
| Punto Ordinante | VITTORIO EMANUELE ROMALLO / RMLVTR63R04L219T |
| Soggetto stipulante | VITTORIO EMANUELE ROMALLO / RMLVTR63R04L219T AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA |
| Data e ora inizio presentazione offerta | 24/06/2021 14:22 |
| Data e ora termine ultimo presentazione offerta | 28/06/2021 18:00 |
| Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore) | 28/06/2022 18:00 |
| Ulteriori note | IL RUP è L'ING. VITTORIO E. ROMALLO. Si richiede il comodato d'uso di durata biennale, a partire dalla data di collaudo con esito positivo, e la fornitura biennale di n. 100 manipoli a scelta tra i codici indicati nell'offerta n. 29716/2021ltrv |
| Bandi / Categorie oggetto della Trattativa | Forniture specifiche per la Sanità (BENI) |
| Fornitore | SMITH & NEPHEW S.R.L. |
| Valore dell'offerta economica | 39999 |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta | Non specificato |
| Termini di pagamento | 60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi |
| Dati di Consegnna | VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA |

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

| | |
|----------------------------|--|
| Nome Scheda Tecnica | Fornitura in comodato d'uso gratuito, installazione e collaudo |
|----------------------------|--|

| | |
|-----------------|--|
| | in loco di N. 1 sistema VERSAJET comprensivo di n. 100 manipoli, come da offerta n. 29716/2021ltrv |
| Quantità | 1 |

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica | Tipologia | Regola di Ammissione | Valori |
|-----|--|-----------|------------------------|----------|
| 1 | FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO | Tecnico | Nessuna regola | |
| 2 | Tipo contratto | Tecnico | Valore massimo ammesso | ACQUISTO |

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

| Descrizione | Nome file |
|-------------|-------------------|
| DGUE | Allegato DGUE.DOC |

RICHIESTE AL FORNITORE

| Descrizione | Firmato digitalmente |
|---|----------------------|
| 1) Offerta economica comprensiva di marca da bollo di € 16,00 | Sì |
| 2) DGUE | Sì |
| 3) Dichiarazione di conformità CE | Sì |
| 4) Scheda tecnica | Sì |
| 5) Manuale d'uso | Sì |
| 6) CND e numero di repertorio | Sì |

Smith & Nephew S.r.l.
Via De Capitani, 2A
20864 Agrate Brianza (MB)
Italia



Agrate Brianza, 28/06/2021

Cod. Cliente 150151

**Spett.le
AO ORNAS S.ANNA E S.SEBASTIANO
VIA F. PALASCIANO
81100 CASERTA (CE)**

**Offerta N° 30758/2021Itrv
(citare in comunicazioni ed ordini)**

**Oggetto : TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1751816 PER LA FORNITURA IN COMODATO
D'USO GRATUITO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO IN LOCO DI N.1 SISTEMA VERSAJET
COMPRENSIVO DI MATERIALE DI CONSUMO**

La sottoscritta [REDACTED], nata a [REDACTED] (MB) il [REDACTED] e residente a Concorezzo (MB) 20863 - In Via Magellano, 1 [REDACTED] in qualità di Procuratore della scrivente Smith & Nephew S.r.l. con sede legale ed amministrativa in Agrate Brianza (MB) - Via De Capitani 2/A - tel. 039/60941 e fax 039/651535 - P.I.: 00953780962 e C.F.: 09331210154, regolarmente iscritta c/o la CCIAA di Monza e Brianza al n. 09331210154 dal 20/07/2007, nonchè c/o il Tribunale di Monza al n. 39845 - Ufficio II.DD. territorialmente competente di Vimercate, c.s. di € 2.560.000, 00.= i.v., codice attività 464630 (tel. 039/60941 - fax 039/6094424 - servizi@smith-nephew.com), con la presente sottopone la propria migliore offerta per la fornitura del seguente materiale:

VERSAJET II Sistema idrochirurgico per il debridement delle ferite

VERSAJET II Console operativa -
CND: Z120106 RDM: 1436596 CLASSE: IIb
Codice: 66800039

FORNITA IN COMODATO D'USO GRATUITO

VERSAJET II Manipolo versione

Exact monouso 15°/14 mm -

CND: K0199 RDM: 1465564 CLASSE: IIa

Codice: 66800040

Confezione Indivisibile da 1 pezzi

Quantità: 1 (uno)

Importo unitario: € 398.00000 (trecentonovantaotto/00000) + IVA 22%

Cap. Soc. € 2.560.000,00 i.v. =

Società unipersonale - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Smith & Nephew plc
R.E.A. MB 1285693 - Reg. Imp. Monza e Brianza 09331210154 - C.F. 09331210154 - P. IVA 00953780962 -
C.C. Post. 57.418.204

Società con sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 – Pec smith.finance@pec.it

VERSAJET II Manipolo versione**Exact monouso 45°/14 mm -**

CND: K0199 RDM: 1465565 CLASSE: IIa

Codice: 66800041

Confezione Indivisibile da 1 pezzi

Quantità: 1 (uno)

Importo unitario: € 398,00000 (trecentonovantaotto/00000) + IVA 22%

VERSAJET II Manipolo versione**Exact monouso 45°/8 mm -**

CND: K0199 RDM: 1465566 CLASSE: IIa

Codice: 66800042

Confezione indivisibile da 1 pezzi

Quantità: 1 (uno)

Importo unitario: € 398,00000 (trecentonovantaotto/00000) + IVA 22%

VERSAJET II Manipolo versione**Plus monouso 15°/14 mm -**

CND: K0199 RDM: 1465572 CLASSE: IIa

Codice: 66800043

Confezione Indivisibile da 1 pezzi

Quantità: 1 (uno)

Importo unitario: € 398,00000 (trecentonovantaotto/00000) + IVA 22%

Importo a confezione Indivisibile: € 398,00000 (trecentonovantaotto/00000) + IVA 22%

VERSAJET II Manipolo versione**Plus monouso 45°/14 mm -**

CND: K0199 RDM: 1465573 CLASSE: IIa

Codice: 66800044

Confezione Indivisibile da 1 pezzi

Quantità: 1 (uno)

Importo unitario: € 398,00000 (trecentonovantaotto/00000) + IVA 22%

VERSAJET II Manipolo versione**Plus monouso 45°/8 mm -**

CND: K0199 RDM: 1465574 CLASSE: IIa

Codice: 66800045

Confezione Indivisibile da 1 pezzi

Quantità: 1 (uno)

Importo unitario: € 398,00000 (trecentonovantaotto/00000) + IVA 22%

TOTALE FORNITURA € 398,00 X 100 = € 39.800,00 + IVA 22%
(trentanove mila ottocento/00)

=====

Condizioni di fornitura :

Imballo : compreso nel prezzo

Consegne : secondo Vostre Istruzioni ed in base alla disponibilità

Pagamento: 60 GG DF (D.L. 231/2002 - D.L. 833/78)

I.V.A.: a Vostro carico

Eventuali ordini potranno essere inoltrati a Customer Service Smith & Nephew:

- ü Fax: 039 6094260
- ü Mail: Milan-CustomerService@smith-nephew.com
- ü PEC: smith.nephew.customerservice@pec.it

Eventuali comunicazioni potranno essere inoltrate a Ufficio Gare Smith & Nephew:

- ü Fax: 039 6094424; 039 6094303
- ü Mail: milan-gare@smith-nephew.com
- ü PEC: smith.nephew.asdtender@pec.it

Le informazioni, le condizioni ed i prezzi contenute nel presente documento sono da ritenersi confidenziali, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso scritto dell'altra parte o per obbligo di legge. Le parti si impegnano altresì a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi. Il cliente garantisce altresì la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei propri archivi dei dati elaborati e dei documenti ed informazioni pervenute da Smith&Nephew.

Distinti saluti

Smith & Nephew S.r.l.


Silvana Passoni
Un Procuratore

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

| | |
|-------------------------|---|
| Numero Trattativa | 1751816 |
| Descrizione | Fornitura in comodato d'uso gratuito, installazione e collaudo in loco di N. 1 sistema VERSAJET comprensivo di materiale di consumo |
| Tipologia di trattativa | Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) |
| CIG | ZE4323EEF0 |
| CUP | Non inserito |

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

| | |
|---|---|
| Nome Ente | AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA |
| Codice Fiscale Ente | 02201130610 |
| Nome Ufficio | UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA |
| Indirizzo Ufficio | Via Tescione 81100 CASERTA (CE) |
| Telefono / FAX Ufficio | 3204307959 / 0823232465 |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | 551B2G |
| Punto Ordinante | VITTORIO EMANUELE ROMALLO / CF: RMLVTR63R04L219T |
| Firmatari del Contratto | VITTORIO EMANUELE ROMALLO / CF: RMLVTR63R04L219T |

FORNITORE

| | |
|--|---|
| Ragione o denominazione Sociale | SMITH & NEPHEW S.R.L. |
| Codice Identificativo dell'Operatore Economico | 00953780962 |
| Codice Fiscale Operatore Economico | 09331210154 |
| Partita IVA di Fatturazione | NON INSERITO |
| Sede Legale | VIA DE CAPITANI N. 2/A 20864 AGRATE BRIANZA (MB) |
| Telefono | 0396094237 |
| PEC Registro Imprese | SMITH.NEPHEW.ASDTENDER@PEC.IT |
| Tipologia impresa | Società a Responsabilità Limitata |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 09331210154 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 20/07/2007 00:00 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | MB |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DP.MONZABRIANZA. UTVIMERCATE@AGENZIAENTRATE.IT |

| | |
|--|-----------------------|
| CCNL applicato / Settore | COMMERCIO / COMMERCIO |
| <i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i> | |
| BENI | |

| | |
|--|---|
| Nessun dato rilasciato. | |
| BENI | |
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) | I 111100104 01000 000000000000 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | Sig. St [REDACTED], nato a Pistoia (PT), residente a Pistoia (PT) codice fiscale MRCSPN70F10C1R01, operante in qualità di Legale Rappresentante; Sig. Giuseppe Cattaneo [REDACTED] nato a Milano, residente a Milano codice fiscale CTMSP170C23F2000, operante in qualità di Procuratore; |
| (*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula | |
| DATI DELL'OFFERTA | |
| Identificativo univoco dell'offerta | 1067230 |
| Offerta sottoscritta da | SILVANA PASSONI |
| Email di contatto | MILAN-GARE@SMITH-NEPHEW.COM |
| L'offerta è irrevocabile fino al | 28/06/2022 18:00 |

| OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1) | |
|--------------------------------------|--|
| Bando | Forniture specifiche per la Sanità |
| Categoria | BENI |
| Descrizione Oggetto di Fornitura | Forniture specifiche per la sanità |
| Quantità richiesta | 1 |
| PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
| FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA | FORNITURA IN COMODATO D'USO GRATUITO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO IN LOCO DI N.1 SISTEMA VERSAJET COMPRENSIVO DI MATERIALE DI CONSUMO |
| Tipo contratto | ACQUISTO |

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA

| | |
|---|---|
| Modalità di definizione dell'Offerta | Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 39.999,00 EURO) |
| Valore dell'Offerta | 39.800,00 EURO |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (<i>non specificato</i>) | |
| Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 39,80 (Euro) | |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|---------------------------------|---|
| Dati di Consegna | VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA |
| Termini di Pagamento | 60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi |

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI N. UN SISTEMA IDROCHIRURGICO PER LA CURA DELLE FERITE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE.CIG[ZE4323EEF0]

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €48.556,00

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 06/07/2021

**il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri**