



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 31 del 14/01/2021

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALL'INSTALLAZIONE DELLA NUOVA RADIOLOGIA DIGITALE - MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N.288 DEL 14.10.2020

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 14/01/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE
Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA
Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA
Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALL'INSTALLAZIONE DELLA NUOVA RADIOLOGIA DIGITALE - MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N.288 DEL 14.10.2020

IL DIRETTORE UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 14/10/2020 sono stati affidati all'operatore economico *Technoproject Srl* i lavori propedeutici all'installazione di n. 4 sistemi radiologici digitali presso le seguenti ubicazioni:
 1. n.1 sistema telecomandato GMS modello "*Sirevix*" presso l'u.o.c. Diagnostica per immagini (piano 1 edificio F);
 2. n.1 sistema telecomandato Siemens modello "*Multitom RAX*" presso l'u.o.c. Diagnostica per immagini (piano 1 edificio F);
 3. n.1 sistema telecomandato GMS modello "*Sirevix*" presso l'u.o.c. Pronto Soccorso (piano 0 edificio N);
 4. n.1 sistema telecomandato Siemens modello "*Multitom RAX*" presso l'u.o.c. Ortopedia e Traumatologia (piano 5 edificio N);
- con nota prot. 31519 del 27.10.2020, quindi, il Direttore della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA, nel prendere atto della sopraggiunta indisponibilità del suddetto locale al 5° piano dell'edificio N, in cui era prevista l'installazione del sistema *Multitom RAX*, ha richiesto al Direttore Sanitario l'autorizzazione all'installazione del nuovo sistema radiologico presso un locale della u.o.c. Pronto Soccorso, situato al piano terra del medesimo edificio;
- con annotazione posta a margine della suddetta nota prot. 31519 del 27/10/2020, il Direttore Sanitario, ha espresso parere favorevole all'installazione del sistema radiologico *Multitom RAX* presso la sopraccitata nuova ubicazione, tenendo altresì conto del benessere fornito dal Direttore della U.O.C. Pronto Soccorso;
- durante il mese di novembre 2020, a causa della seconda ondata della pandemia "Coronavirus", la Direzione Sanitaria ha disposto il trasferimento dei reparti Neurochirurgia e Ortopedia dal 5° piano dell'edificio F. Tali locali sono stati destinati all'assistenza di pazienti "Covid-19";

Preso atto

- della disposizione suddetta della Direzione Sanitaria e della conseguente indisponibilità dei locali ubicati al piano 5° dell'edificio N per l'installazione del sistema radiologico "*Multitom Rax*";

Considerato che

- è necessario modificare il progetto esecutivo dei lavori, al fine di tener conto dell'installazione del suddetto sistema "*Multitom Rax*" in un locale ubicato al piano terra edificio N, nell'u.o.c. Pronto Soccorso, anziché al 5° piano dello stesso edificio come stabilito nella deliberazione n.288 del 14.10.2020;

Deliberazione del Direttore Generale

Dato atto che

- per i motivi sopra riportati è stato richiesto alla società *Technoproject Srl* di esperire i necessari sopralluoghi e di produrre un nuovo preventivo aggiornato che tenesse conto dell'esecuzione delle opere necessarie per l'installazione del sistema radiologico nella nuova ubicazione;
- con nota email del 16/12/2020, l'operatore economico *Technoproject Srl* (P.IVA 07167410633) ha trasmesso il preventivo aggiornato dei lavori comprendente l'installazione del sistema Multitom Rax nella nuova ubicazione;
- il computo metrico aggiornato fornito dal suddetto operatore economico è da ritenersi congruo e non comporta variazioni di prezzo rispetto a quanto già approvato con Deliberazione n. 288 del 14/10/2020;

Considerato che

- si rende necessaria l'approvazione del progetto dei lavori aggiornato, al fine di procedere con l'esecuzione dei lavori propedeutici necessari all'installazione e messa in funzione dei n.4 sistemi radiologici;

Attestata

la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di prendere atto della necessità di installare il nuovo sistema radiologico Siemens *Multitom RAX* in un locale dell'u.o.c. Pronto Soccorso, ubicato al piano terra dell'edificio N, anziché al piano 5° del medesimo edificio;
2. di prendere atto ed approvare il preventivo aggiornato dell'operatore economico *Technoproject Srl* per l'esecuzione dei lavori propedeutici all'installazione dei nuovi sistemi di radiologia digitale;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi rispetto a quanto previsto con Deliberazione n. 288 del 14/10/2020;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alle UU.OO.CC. Gestione Economico Finanziaria, Ingegneria Ospedaliera, Diagnostica per immagini, Pronto Soccorso, Ortopedia, Neurochirurgia;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

IL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Acquisito il parere favorevole Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportato:


Il Direttore Amministrativo Avv.to Amalia Carrara

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. prendere atto della necessità di installare il nuovo sistema radiologico Siemens *Multitom RAX* in un locale dell'u.o.c. Pronto Soccorso, ubicato al piano terra dell'edificio N, anziché al piano 5° del medesimo edificio;
2. prendere atto ed approvare il preventivo aggiornato dell'operatore economico *Technoproject srl* per l'esecuzione dei lavori propedeutici all'installazione dei nuovi sistemi di radiologia digitale;
3. dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi rispetto a quanto previsto con Deliberazione n. 288 del 14/10/2020;
4. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alle UU.OO.CC. Gestione Economico Finanziaria, Ingegneria Ospedaliera, Diagnostica per immagini, Pronto Soccorso, Ortopedia, Neurochirurgia;
5. pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale.

**Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa**

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

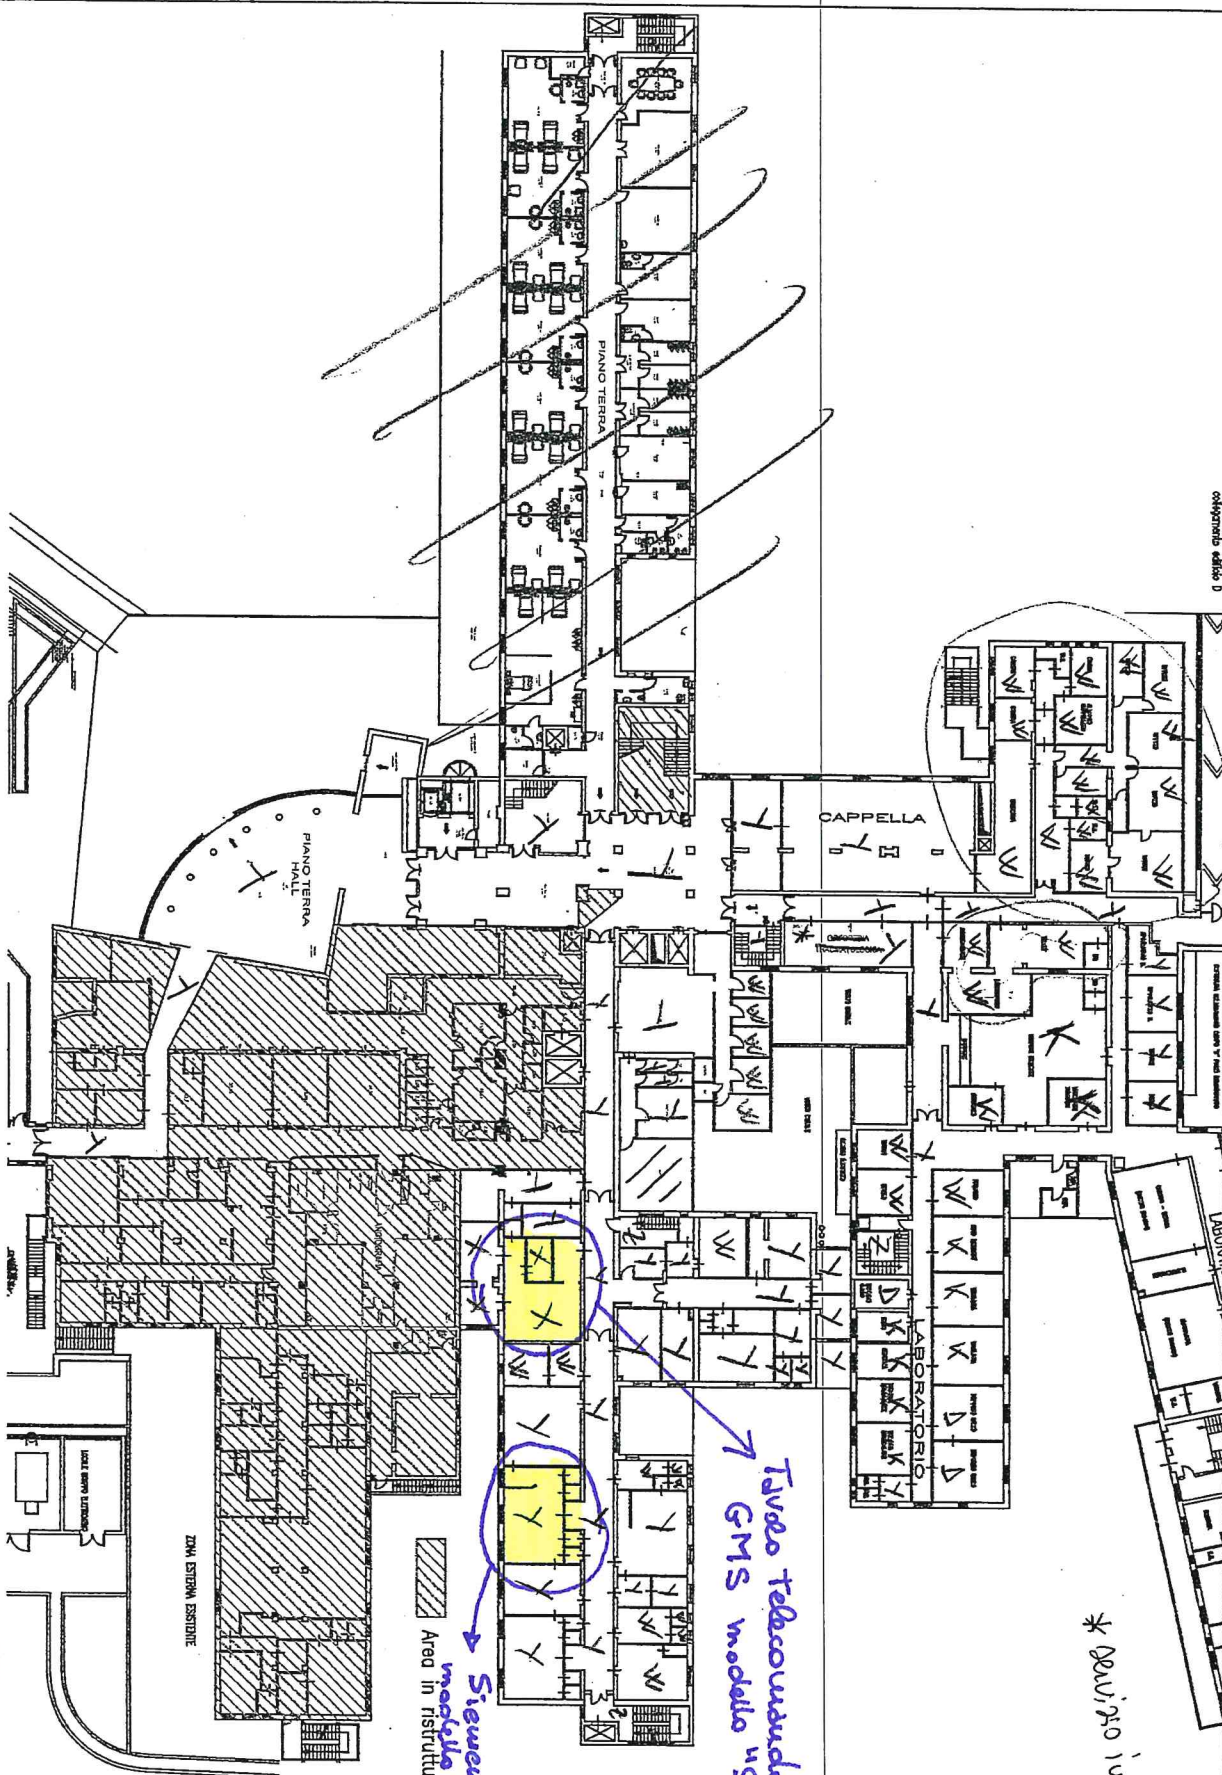

* Deviato idr.

↳ Tavoletta telecomunicata
↳ GMS modello "Siemens"

↳ Siemens MultiBox RAX
modello "MultiBox RAX"

EDIFICIO F (RADIO 6-1A)
PIANO TERRA





EDIFICIO N

PIANTA PIANO TERRA