



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 788 del 10/10/2022

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: FORNITURA DI N.22 ELETTROCARDIOGRAFI DI ALTA FASCIA PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO. – AGGIUDICAZIONE [CIG:91402851CC]

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 10/10/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI



Oggetto: FORNITURA DI N.22 ELETTROCARDIOGRAFI DI ALTA FASCIA PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO. – AGGIUDICAZIONE [CIG:91402851CC]

IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con nota prot. n. 7532 del 07.03.2022 il Direttore u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA chiedeva al Direttore Sanitario l'autorizzazione ad avviare una procedura di gara per la fornitura di n. 22 elettrocardiografi aventi requisiti congruenti con quanto raccomandato dalle Linee Guida AMCO (Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri);
- con annotazione posta a margine della suddetta nota, in pari data, il Direttore Sanitario ha autorizzato l'acquisto delle sopraindicate apparecchiature;
- per la fornitura in questione quest'Azienda, ai sensi della Legge Regionale n.5 del 2021, può procedere autonomamente e non è soggetta all'autorizzazione preventiva da parte della società regionale So.Re.Sa.;
- l'U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha attivato sulla piattaforma MEPA Consip, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la RdO (richiesta di offerta) n. 2977484 del 14.03.2022, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inerente la fornitura di n. 22 elettrocardiografi di alta fascia per le esigenze di diverse UU.OO. per un importo complessivo a base di gara pari a € 176.000,00 oltre IVA [CIG: 91402851CC];
- alla procedura in parola sono stati invitati tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma MEPA Consip al Bando/Categoria "BENI - Forniture specifiche per la Sanità", così come riportato nei dati di riepilogo della RdO allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- in data 28.03.2022, alle ore 12:00, sono scaduti i termini e risultano pervenute n.12 offerte da parte degli operatori economici A.G.A. BIOMEDICA SRL, ALEA S.A.S., CARDIOLINE S.P.A., ELMED SERVICE SRL, GM. MEDICA SRL, M.TEK S.A.S. DI GUARRO C. & C, MEDISOL S.R.L., MORETTI S.P.A., MORTARA INSTRUMENT EUROPE, SEAB INSTRUMENTS SRL, SERVIZI OSPEDALIERI SRL e SIDEM.
- il Responsabile Unico del presente Procedimento, ex artt. 31 e 111, comma 2, del D.Lgs. 50/16 è l'ing. Vittorio E. Romallo, Direttore u.o.c. Tecnologia ospedaliera e HTA;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 266 del 07.04.2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle suddette offerte tecniche pervenute;

Preso atto che

- con verbale n.1 (all.1) in seduta riservata, del 24.05.2022, il RUP, valutata la Documentazione Amministrativa pervenuta dalle Società concorrenti, ha proceduto all'esclusione dell'operatore economico SERVIZI OSPEDALIERI SRL;
- con verbale n.1 (all.2) in seduta riservata, del 02.08.2022, la commissione giudicatrice ha valutato la conformità alle caratteristiche tecniche minime delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti, previste dalla documentazione di gara, ed ha ammesso le n. 11 società A.G.A. BIOMEDICA SRL, ALEA S.A.S., CARDIOLINE S.P.A., ELMED SERVICE SRL, GM. MEDICA

Deliberazione del Direttore Generale

- SRL, M.TEK S.A.S. DI GUARRO C. & C, MEDISOL S.R.L., MORETTI S.P.A., MORTARA INSTRUMENT EUROPE, SEAB INSTRUMENTS SRL e SIDEM alle fasi successive per l'attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi;
- con verbale n.2 (all.3) in seduta riservata, del 19.09.2022, la commissione giudicatrice ha proceduto alla all'attribuzione dei punteggi qualitativi, di cui alle offerte pervenute, così come riportato nella tabella allegata al presente verbale;
 - con il predetto verbale, la commissione giudicatrice esclude la società MORETTI S.P.A. dalle successive fasi di gara in quanto la sommatoria emersa dall'attribuzione del punteggio tecnico qualitativo non raggiunge il punteggio minimo di 36/70;
 - con verbale n.3 (all.4) in seduta riservata, del 20.09.2022, la commissione giudicatrice ha proceduto all'inserimento, sul portale telematico, dei punteggi qualitativi attribuiti e, successivamente, ad aprire la busta telematica economica;
 - dalle risultanze dei punteggi tecnici ed economici, la graduatoria di merito della RDO n. 2977484 del 14.03.2022 che ne deriva è stata riportata in apposita tabella di seguito specificata:

Tabella 1

Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio complessivo
A.G.A. BIOMEDICA SRL	€ 58.300,00	62,00	23,50	85,50
ALEA S.A.S.	€ 74.536,00	39,00	18,38	57,38
CARDIOLINE S.P.A.	€ 155.540,00	70,00	8,81	78,81
ELMED SERVICE SRL	€ 104.500,00	48,00	13,11	61,11
GM. MEDICA SRL	€ 82.500,00	49,00	16,61	65,61
M.TEK S.A.S. DI GUARRO C. & C	€ 45.672,00	55,00	30,00	85,00
MEDISOL S.R.L.	€ 85.800,00	61,00	15,97	76,97
MORTARA INSTRUMENT EUROPE	€ 83.348,00	67,00	16,44	83,44
SEAB INSTRUMENTS SRL	€ 95.040,00	61,00	14,42	75,42
SIDEM	€ 70.642,00	38,00	19,40	57,40

Visto

il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;

Ritenuto

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

- di procedere alla conferma della RDO n. 2977484 del 14.03.2022, inerente la fornitura di n. 22 Elettrocardiografi di alta fascia per le esigenze di diverse UU.OO., all'operatore economico A.G.A. BIOMEDICA SRL (P. IVA 01128810650) per l'importo complessivo pari ad € 58.300,00 oltre 22% iva;

Attestata

la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di procedere alla conferma della RDO n. 2977484 del 14.03.2022, inerente la fornitura di n. 22 Elettrocardiografi di alta fascia per le esigenze di diverse UU.OO., all'operatore economico A.G.A. BIOMEDICA SRL (P. IVA 01128810650) per l'importo complessivo pari ad € 58.300,00 oltre 22% iva;
2. di imputare la spesa complessiva di € 71.126,00 iva 22% inclusa, sul conto economico n. 1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio 2022;
3. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. di attribuire alla presente procedura il seguente CIG: [91402851CC];
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. di rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di utilizzare l'apparecchiatura;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alla Direzione Sanitaria ed alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera ed HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Acquisito il parere favorevole Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportato:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anneschiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv.to Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. procedere alla conferma della RDO n. 2977484 del 14.03.2022, inerente la fornitura di n. 22 Elettrocardiografi di alta fascia per le esigenze di diverse UU.OO., all'operatore economico A.G.A. BIOMEDICA SRL (P. IVA 01128810650) per l'importo complessivo pari ad € 58.300,00 oltre 22% iva;
2. imputare la spesa complessiva di € 71.126,00 iva 22% inclusa, sul conto economico n. 1010204010-ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio 2022;
3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. attribuire alla presente procedura il seguente CIG: [91402851CC];
5. pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di utilizzare l'apparecchiatura;
7. trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alla Direzione Sanitaria ed alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

**Verbale n. 1 del 24/05/2022
del Responsabile Unico del Procedimento**

SEDUTA RISERVATA

Oggetto: Fornitura di n. 22 Elettrocardiografi di alta fascia per le esigenze di varie UU.OO.CC. – RDO MEPA n. 2977484 – CIG 91402851CC

L'anno 2022 il giorno 24 del mese di maggio alle ore 15:00, presso il proprio ufficio, il R.U.P. della Procedura di Gara in oggetto, ing. Vittorio Emanuele Romallo, ha attivato la seduta riservata per la valutazione delle risultanze del soccorso istruttorio.

PREMESSO CHE

In data 16 maggio 2022 si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti, come elencati nella deliberazione n. 266 del 07.04.2022.

All'esito delle verifiche effettuate, il RUP ha disposto, ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., l'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio nei confronti dell'operatore economico SERVIZI OSPEDALIERI SRL a causa dell'incompletezza della documentazione presentata.

Il RUP, in data 17.05.2022, a mezzo pec ha avviato il soccorso istruttorio nei confronti della società SERVIZI OSPEDALIERI SRL al fine di sanare le anomalie riscontrate.

DATO ATTO CHE

l'operatore economico SERVIZI OSPEDALIERI SRL ha risposto al soccorso istruttorio entro il termine tassativo previsto per le ore 12:00 del 24 maggio 2022.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il RUP procede alla verifica della documentazione pervenuta a seguito del soccorso istruttorio e rileva quanto segue:

- l'integrazione documentale prodotta dalla società SERVIZI OSPEDALIERI SRL non risulta essere rispondente a quanto richiesto dall'art. 15 del Disciplinare di Gara in merito al contenuto della "Busta A – Documentazione Amministrativa" in particolare non sono stati prodotti i seguenti documenti firmati digitalmente:
 - o Domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 2.A;
 - o Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
 - o Attestazione del pagamento del contributo a favore dell'ANAC di € 20,00.

In conclusione, il RUP decide di escludere il concorrente SERVIZI OSPEDALIERI SRL.





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Alle ore 15:30 termina la seduta riservata relativa alla valutazione del soccorso istruttorio riguardante la procedura di gara in oggetto.
Il presente Verbale consta di n. 2 pagine.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il RUP
Ing. Vittorio E. Romallo

OGGETTO: Affidamento della fornitura di n.22 elettrocardiografi di alta fascia per le esigenze di diverse uu.oo. - RDO n. 2977484 del 14.03.2022.

VERBALE SEDUTA RISERVATA n. 1 del 02.08.2022

In data 02.08.2022, alle ore 10:00 circa presso gli uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è riunita la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche telematiche pervenute dalle Società concorrenti, nominata giusta deliberazione n.266 del 07.04.2022 - composta come segue:

- ✓ Dott. Gianfranco Lauria – Supporto al RUP – Presidente;
- ✓ Ing. Gianluca Giaconia – Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA A.O.R.N. "Ospedali dei Colli" – Componente;
- ✓ Ing. Pasquale Raucci – Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Biomedico U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Componente;
- ✓ Sig.ra Simona Gravina – Assistente Amministrativo U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Segretaria.

Premesso che

- ✓ i componenti della predetta Commissione hanno compilato e sottoscritto l'apposito modulo per la dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità (all. 1,2,3,4).
- ✓ hanno partecipato alla procedura di gara, i seguenti operatori economici:
 1. A.G.A. BIOMEDICA SRL;
 2. ALEA S.A.S.;
 3. CARDIOLINE SPA;
 4. ELMED SERVICE SRL;
 5. GM. MEDICA SRL;
 6. M.TEK S.A.S. DI GUARRO C. & C.;
 7. MEDISOL S.R.L.;
 8. MORETTI S.P.A.;
 9. MORTARA INSTRUMENT EUROPE;
 10. SEAB INSTRUMENT SRL;
 11. SIDEM.

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione effettua la valutazione delle offerte tecniche telematiche presentate dagli operatori economici concorrenti, e procede alla verifica parziale della conformità delle stesse in merito al possesso dei requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara.

La Commissione sospende i lavori e decide di riunirsi a data da stabilire.

Terminate le predette operazioni, il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante. La seduta viene chiusa alle 13:15 circa.


Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Gianfranco Lauria

Ing. Gianluca Giaconia

Ing. Pasquale Raucci

Sig.ra Simona Gravina

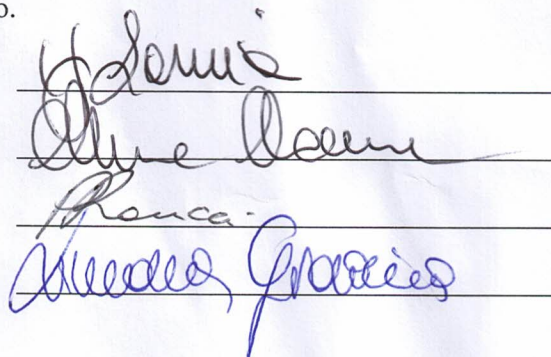

OGGETTO: Affidamento della fornitura di n.22 elettrocardiografi di alta fascia per le esigenze di diverse uu.oo. - RDO n. 2977484 del 14.03.2022.

VERBALE SEDUTA RISERVATA n. 2 del 19.09.2022

In data 19.09.2022, alle ore 16:15 circa presso gli uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è riunita la Commissione giudicatrice ed ha ripreso i lavori di valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società concorrenti, nominata giusta deliberazione n.266 del 07.04.2022 - composta come segue:

- ✓ Dott. Gianfranco Lauria – Supporto al RUP – Presidente;
- ✓ Ing. Gianluca Giaconia – Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA A.O.R.N. “Ospedali dei Colli” – Componente;
- ✓ Ing. Pasquale Raucci – Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Biomedico U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Componente;
- ✓ Sig.ra Simona Gravina – Assistente Amministrativo U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Segretaria.

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.


La Commissione effettua la valutazione delle offerte tecniche telematiche presentate dalle società concorrenti e procede all'attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi, così come riportato nella tabella allegata (All.1).

La società MORETTI S.P.A., a seguito della sommatoria emersa dall'attribuzione del punteggio tecnico qualitativo, così come previsto nel Disciplinare di Gara, viene esclusa dalle successive fasi di gara in quanto non raggiunge il punteggio minimo di 36/70.

Terminate le predette operazioni, il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante. La seduta viene chiusa alle 19:00 circa.

Letto, confermato e sottoscritto.


Dott. Gianfranco Lauria



Ing. Gianluca Giaconia



Ing. Pasquale Raucci



Sig.ra Simona Gravina

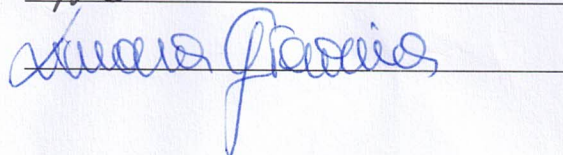


TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO (1/4) – MAX 70 PUNTI
Fornitura di n. 22 Elettrocardiografi di alta fascia per le esigenze di varie UU.OO.CC.
RDO MEPA n. 2977484

Parametro di valutazione	Criterio di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	A.G.A. BIOMEDICA SRL	ALEA S.A.S.	CARDIOLINE S.P.A.
			Wuhan Zoncare Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Shenzhen BIO-CARE Bio-Medical Equipment Co., Ltd.	Cardioline TouchECG System Digital Premium HD+ 15
Banda passante del segnale ECG:	Quantitativo: • 0,05 – 150 Hz: punti 0; • 0,05 – 250 Hz: punti 4; • oltre 0,05 – 250 Hz: punti 10.	Max 10 punti	0,01 – 350 Hz	0,05 – 250 Hz	0,05 – 300 Hz
			Punti 10	Punti 4	Punti 10
Frequenza in registrazione e analisi e memorizzazione:	Quantitativo: • 500 KHz/canale: punti 0; • da 501 a 750 KHz/canale: punti 4; • da 751 a 900 KHz/canale: punti 6; • oltre 900 Hz/canale: punti 10.	Max 10 punti	1000 Hz/canale	1000 Hz/canale	1000 Hz/canale
			Punti 10	Punti 10	Punti 10
Frequenza di campionamento del segnale ECG:	Quantitativo: • 8 KHz/canale: punti 0; • da 9 a 15 KHz/canale: punti 4; • da 16 a 35 KHz/canale: punti 6; • oltre 35 KHz/canale: punti 10.	Max 10 punti	32 KHz/canale	8 KHz/canale	128 KHz/canale
			Punti 6	Punti 0	Punti 10

Conversione A/D in bit:	<ul style="list-style-type: none"> • Quantitativo: • 12 bit: punti 0; • da 13 a 18 bit: punti 5; • oltre 18 bit: punti 10. 	Max 10 punti	24 bit	24 bit	24 bit
			Punti 10	Punti 10	Punti 10
Dimensioni display ECG oltre 8"	Quantitativo: Per ogni ">8 sarà attribuito 1 punto.	Max 5 punti	10,4"	9"	19,5"
			Punti 2	Punti 1	Punti 5
			SI	SI	SI
Rispondenza alle linee guida internazionali AHA, ACC, HRS.	Tabellare (SI/NO)	5 punti	Punti 5	Punti 5	Punti 5
			SI	Non rilevabile dalle schede tecniche prodotte.	SI
Capacità di individuare patologie, con misure e interpretazioni automatiche, come da linee guida nazionali ANMCO/AIIC/SIT.	Tabellare (SI/NO)	5 punti	Punti 5	Punti 0	Punti 5
			Il giudizio complessivo è buono. Si apprezzano l'elevato valore di CMRR, il ridotto tempo di ricarica, la possibilità di salvataggio dati in diversi formati.	Il giudizio complessivo è non pienamente sufficiente. Le caratteristiche offerte sono allineate alle minime richieste. Tuttavia si apprezzano il display touchscreen e la tastiera impermeabilizzata.	Il giudizio complessivo è ottimo. Si apprezzano la possibilità di acquisizione simultanea di 15 derivazioni, l'elevato valore di CMRR, l'ottimo valore di sensibilità, la possibilità di salvataggio dati in diversi formati.
Elementi migliorativi ed innovativi offerti, rispetto alle caratteristiche tecniche minime obbligatorie	Discrezionale	Max 4 punti	Punti 3	Punti 1	Punti 4

Autonomia batterie, in funzionamento continuo, superiore a 2 h	Quantitativo: • 2 h: punti 0; • da 2 h a 4 h: punti 3; • oltre 4 h: punti 6.	Max 6 punti	8 h [rilevato da Manuale Utente (pag. 112)]	3 h	8 h
			Punti 6	Punti 3	Punti 6
Dotazione modulo trasmissione e ricezione dati via WIFI	Tabellare (SI/NO)	5 punti	SI	SI	SI
			Punti 5	Punti 5	Punti 5
PUNTEGGIO TOTALE			Punti 62	Punti 39	Punti 70

(Spina)

R

Q

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO (2/4) – MAX 70 PUNTI
Fornitura di n. 22 Elettrocardiografi di alta fascia per le esigenze di varie UU.OO.CC.
RDO MEPA n. 2977484

Parametro di valutazione	Criterio di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	ELMED	GM MEDICA	M. TEK SAS DI GUARRO C. & C
			Schiller AG CARDIOVIT AT-102G2	Progetti EPG 12M PLUS	Lumed Euro ECG 1201 Advanced
Banda passante del segnale ECG:	Quantitativo: • 0,05 – 150 Hz: punti 0; • 0,05 – 250 Hz: punti 4; • oltre 0,05 – 250 Hz: punti 10.	Max 10 punti	0,05 – 250 Hz	0,01 – 350 Hz	0,01 – 350 Hz
			Punti 4	Punti 10	Punti 10
			1000 Hz/canale	1000 Hz/canale	1000 Hz/canale
Frequenza in registrazione e analisi e memorizzazione:	Quantitativo: • 500 KHz/canale: punti 0; • da 501 a 750 KHz/canale: punti 4; • da 751 a 900 KHz/canale: punti 6; • oltre 900 Hz/canale: punti 10.	Max 10 punti	Punti 10	Punti 10	Punti 10
			32 KHz/canale	32 KHz/canale	32 KHz/canale
			Punti 6	Punti 6	Punti 6
Frequenza di campionamento del segnale ECG:	Quantitativo: • 8 KHz/canale: punti 0; • da 9 a 15 KHz/canale: punti 4; • da 16 a 35 KHz/canale: punti 6; • oltre 35 KHz/canale: punti 10.	Max 10 punti	Punti 6	Punti 6	Punti 6
			32 KHz/canale	32 KHz/canale	32 KHz/canale
			Punti 6	Punti 6	Punti 6

Conversione A/D in bit:	<p>Quantitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 12 bit: punti 0; ● da 13 a 18 bit: punti 5; ● oltre 18 bit: punti 10. 	Max 10 punti	24 bit	24 bit	24 bit
			Punti 10	Punti 10	Punti 10
			8"	10"	10"
Dimensioni display ECG oltre 8"	<p>Quantitativo:</p> <p>Per ogni ">8 sarà attribuito 1 punto.</p>	Max 5 punti	Punti 0	Punti 2	Punti 2
			SI	Non rilevabile dalle schede tecniche prodotte.	SI
			Punti 5	Punti 0	Punti 5
Rispondenza alle linee guida internazionali AHA, ACC, HRS.	<p>Tabellare (SI/NO)</p>	5 punti	Non rilevabile dalle schede tecniche prodotte.	Non rilevabile dalle schede tecniche prodotte.	SI
			Punti 0	Punti 0	Punti 5
Capacità di individuare patologie, con misure e interpretazioni automatiche, come da linee guida nazionali ANMCO/AIIC/SIT.	<p>Tabellare (SI/NO)</p>	5 punti	Non rilevabile dalle schede tecniche prodotte.	Non rilevabile dalle schede tecniche prodotte.	SI
			Punti 0	Punti 0	Punti 5
Elementi migliorativi ed innovativi offerti, rispetto alle caratteristiche tecniche minime obbligatorie	<p>Discrezionale (*)</p>	Max 4 punti	Il giudizio complessivo è sufficiente. Si apprezza l'ottimo valore di sensibilità.	Il giudizio complessivo è buono. Si apprezzano l'elevato valore di CMRR e la possibilità di salvataggio dati in diversi formati.	Il giudizio complessivo è sufficiente. Si apprezza l'elevato valore di CMRR.
			Punti 2	Punti 3	Punti 2

Dotazione modulo trasmissione e ricezione dati via WIFI	Tabellare (SI/NO)	5 punti	8 h	7 h di funzionamento senza stampa presumibilmente pari a 3 h di funzionamento con stampa	2 h
			Punti 6	Punti 3	Punti 0
PUNTEGGIO TOTALE			Punti 5	Punti 5	Punti 5
			Punti 48	Punti 49	Punti 55

Autonomia batterie, in funzionamento continuo, superiore a 2 h

- Quantitativo:
- 2 h: punti 0;
 - da 2 h a 4 h: punti 3;
 - oltre 4 h: punti 6.

Max 6 punti

Tabellare (SI/NO)

5 punti

8 h

Punti 6

SI

Punti 5

Punti 48

7 h di funzionamento senza stampa presumibilmente pari a 3 h di funzionamento con stampa

Punti 3

SI

Punti 5

Punti 49

2 h

Punti 0

SI

Punti 5

Punti 55

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO (3/4) – MAX 70 PUNTI
Fornitura di n. 22 Elettrocardiografi di alta fascia per le esigenze di varie UU.OO.CC.
RDO MEPA n. 2977484

Parametro di valutazione	Criterio di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	MEDISOL	MORETTI	MORTARA INSTRUMENT EUROPE
			GE Healthcare MAC 5 A4	Edan Instruments LTD455W REF. SE1200EXPRESS	Welch Allyn ELI280
Banda passante del segnale ECG:	Quantitativo: • 0,05 – 150 Hz: punti 0; • 0,05 – 250 Hz: punti 4; • oltre 0,05 – 250 Hz: punti 10.	Max 10 punti	0,04 – 300 Hz	0,01 – 150 Hz [rilevato da Manuale Utente (pag. 133)]	0,05 – 300 Hz
			Punti 10	Punti 0	Punti 10
			1000 Hz/canale	1000 Hz/canale [rilevato da Manuale Utente (pag. 134)]	1000 Hz/canale
Frequenza in registrazione e analisi e memorizzazione:	Quantitativo: • 500 KHz/canale: punti 0; • da 501 a 750 KHz/canale: punti 4; • da 751 a 900 KHz/canale: punti 6; • oltre 900 Hz/canale: punti 10.	Max 10 punti	Punti 10	Punti 10	Punti 10
			512 KHz/canale	10 KHz/canale [rilevato da Manuale Utente (pag. 134)]	40 KHz/canale
			Punti 10	Punti 4	Punti 10
Frequenza di campionamento del segnale ECG:	Quantitativo: • 8 KHz/canale: punti 0; • da 9 a 15 KHz/canale: punti 4; • da 16 a 35 KHz/canale: punti 6; • oltre 35 KHz/canale: punti 10.	Max 10 punti	Punti 10	Punti 10	Punti 10
			24 bit	24 bit [rilevato da Manuale Utente (pag. 133)]	20 bit
			Punti 10	Punti 10	Punti 10
Conversione A/D in bit:	Quantitativo: • 12 bit: punti 0; • da 13 a 18 bit: punti 5; • oltre 18 bit: punti 10.	Max 10 punti	Punti 10	Punti 10	Punti 10

Dimensioni display ECG oltre 8"	Quantitativo: Per ogni ">8 sarà attribuito 1 punto.	Max 5 punti	8,9"	8"	10,1"
			Punti 0	Punti 0	Punti 2
Rispondenza alle linee guida internazionali AHA, ACC, HRS.	Tabellare (SI/NO)	5 punti	SI	SI [rilevato da Brochure]	SI
			Punti 5	Punti 5	Punti 5
Capacità di individuare patologie, con misure e interpretazioni automatiche, come da linee guida nazionali ANMCO/AIIC/SIT.	Tabellare (SI/NO)	5 punti	SI	Non rilevabile dalle schede tecniche prodotte.	SI
			Punti 5	Punti 0	Punti 5
Elementi migliorativi ed innovativi offerti, rispetto alle caratteristiche tecniche minime obbligatorie	Discrezionale	Max 4 punti	Il giudizio complessivo è buono. Si apprezzano la possibilità di analisi in real-time della qualità del segnale per ogni derivazione con la selezione automatica del miglior tracciato.	Il giudizio complessivo è non pienamente sufficiente. Le caratteristiche offerte sono allineate alle minime richieste. Tuttavia si apprezza l'elevato valore di CMRR.	Il giudizio complessivo è ottimo. Si apprezzano l'elevato valore di CMRR, la funzionalità che consente di scegliere i 10s di tracciato con la migliore qualità, l'opzione di connettività PDQ (Patient Demographics Query) e l'opzione SECUR-IT (Sicurezza avanzata dei dati).

Dotazione modulo trasmissione e ricezione dati via WIFI	Tabellare (SI/NO)	5 punti	Autonomia batterie, in funzionamento continuo, superiore a 2 h		Quantitativo: • 2 h: punti 0; • da 2 h a 4 h: punti 3; • oltre 4 h: punti 6.	Max 6 punti	3 h	2,5 h	18 h di funzionamento senza stampa presumibilmente pari a 9 h di funzionamento con stampa
			Punti 3	Punti 3			Punti 6		
			SI	NO			SI		
PUNTEGGIO TOTALE			Punti 61	Punti 33	Punti 67				

Storno

[Signature]

[Signature]

[Signature]


TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO (4/4) – MAX 70 PUNTI
Fornitura di n. 22 Elettrocardiografi di alta fascia per le esigenze di varie UU.OO.CC.
RDO MEPA n. 2977484

Parametro di valutazione	Criterio di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	Punteggio	
			SEAB Edan Instruments SE-1202	SIDEM Edan Instruments SE-1200 EXPRESS
Banda passante del segnale ECG:	Quantitativo: • 0,05 – 150 Hz: punti 0; • 0,05 – 250 Hz: punti 4; • oltre 0,05 – 250 Hz: punti 10.	Max 10 punti	0,01 – 350 Hz [rilevato da Manuale Utente (pag. 89)]	[rilevato da Manuale Utente (pag. 133)]
			Punti 10	Punti 0
Frequenza in registrazione e analisi e memorizzazione:	Quantitativo: • 500 KHz/canale: punti 0; • da 501 a 750 KHz/canale: punti 4; • da 751 a 900 KHz/canale: punti 6; • oltre 900 Hz/canale: punti 10.	Max 10 punti	1000 Hz/canale	[rilevato da Manuale Utente (pag. 134)]
			Punti 10	Punti 10
			64 KHz/canale [rilevato da Manuale Utente (pag. 89)]	[rilevato da Manuale Utente (pag. 134)]
Frequenza di campionamento del segnale ECG:	Quantitativo: • 8 KHz/canale: punti 0; • da 9 a 15 KHz/canale: punti 4; • da 16 a 35 KHz/canale: punti 6; • oltre 35 KHz/canale: punti 10.	Max 10 punti	Punti 10	Punti 4
			24 bit [rilevato da Manuale Utente (pag. 89)]	[rilevato da Manuale Utente (pag. 133)]
Conversione A/D in bit:	Quantitativo: • 12 bit: punti 0; • da 13 a 18 bit: punti 5; • oltre 18 bit: punti 10.	Max 10 punti	Punti 10	Punti 10
			24 bit [rilevato da Manuale Utente (pag. 89)]	[rilevato da Manuale Utente (pag. 133)]


Dimensioni display ECG oltre 8"	Quantitativo: Per ogni ">8 sarà attribuito 1 punto.	Max 5 punti	10,1"	8"
			Punti 2	Punti 0
Rispondenza alle linee guida internazionali AHA, ACC, HRS.	Tabellare (SI/NO)	5 punti	SI [rilevato da Brochure]	SI [rilevato da Brochure]
			Punti 5	Punti 5
Capacità di individuare patologie, con misure e interpretazioni automatiche, come da linee guida nazionali ANMCO/AIIC/SIT.	Tabellare (SI/NO)	5 punti	Non rilevabile dalle schede tecniche prodotte.	Non rilevabile dalle schede tecniche prodotte.
			Punti 0	Punti 0
Elementi migliorativi ed innovativi offerti, rispetto alle caratteristiche tecniche minime obbligatorie	Discrezionale	Max 4 punti	Il giudizio complessivo è buono. Si apprezzano l'elevato valore di CMRR e l'ottimo valore di sensibilità, la possibilità di salvataggio dati in diversi formati.	Il giudizio complessivo è non pienamente sufficiente. Le caratteristiche offerte sono allineate alle minime richieste. Tuttavia si apprezza l'elevato valore di CMRR.
			Punti 3	Punti 1

Autonomia batterie, in funzionamento continuo, superiore a 2 h	Quantitativo: • 2 h: punti 0; • da 2 h a 4 h: punti 3; • oltre 4 h: punti 6.	Max 6 punti	> 4h	2,5 h
			Punti 6	Punti 3
Dotazione modulo trasmissione e ricezione dati via WIFI	Tabellare (SI/NO)	5 punti	SI	SI
			Punti 5	Punti 5
PUNTEGGIO TOTALE			Punti 61	Punti 38

Dott. Gianfranco Lauria

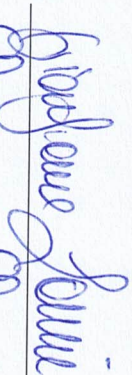

Ing. Gianluca Giacomia



Ing. Pasquale Raucchi



Sig.ra Simona Gravina





OGGETTO: Affidamento della fornitura di n.22 elettrocardiografi di alta fascia per le esigenze di diverse uu.oo. - RDO n. 2977484 del 14.03.2022.

VERBALE SEDUTA RISERVATA n. 3 del 20.09.2022

In data 20.09.2022, alle ore 12:00 circa presso gli uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è riunita la Commissione giudicatrice ed ha ripreso i lavori di valutazione delle offerte economiche presentate dalle Società concorrenti, nominata giusta deliberazione n.266 del 07.04.2022 - composta come segue:

- ✓ Dott. Gianfranco Lauria – Supporto al RUP – Presidente;
- ✓ Ing. Gianluca Giaconia – Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA A.O.R.N. "Ospedali dei Colli" – Componente;
- ✓ Ing. Pasquale Raucci – Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Biomedico U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Componente;
- ✓ Sig.ra Simona Gravina – Assistente Amministrativo U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Segretaria.

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione procede all'inserimento, sul portale telematico Me.Pa, dei punteggi qualitativi come da griglia predisposta nella documentazione di gara.

La Commissione, terminati i lavori di cui sopra, da luogo all'apertura delle offerte economiche telematiche e prende atto della graduatoria finale risultante dal portale Me.Pa (All.1).

Terminate le predette operazioni, il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante, che provvederà a trasmetterli al RUP. La seduta viene chiusa alle 12:45 circa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Gianfranco Lauria

Ing. Gianluca Giaconia

COLLEGATO DA RETRO

Ing. Pasquale Raucci

Sig.ra Simona Gravina

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2977484
Descrizione RDO:	Fornitura di n. 22 Elettrocardiografi di alta fascia per le esigenze di varie UU.OO.CC.
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	La congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
Punto Ordinante	VITTORIO EMANUELE ROMALLO
Soggetto stipulante	Nome: VITTORIO EMANUELE ROMALLO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	551B2G
Inizio presentazione offerte:	14/03/2022 15:13
Termine ultimo presentazione offerte:	28/03/2022 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	21/03/2022 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	28/03/2023 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Misura delle eventuali penali:	Indicare nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della	BENI/Forniture specifiche per la

RdO: ~ ~	Sanità
----------	--------

Lotto esaminato: 1 Fornitura di n. 22 Elettrocardiografi di alta fascia per le esigenze di varie UU.OO.CC.

CIG	91402851CC
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Fornitura di n. 22 Elettrocardiografi di alta fascia per le esigenze di varie UU.OO.CC./1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	176000,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	M.TEK S.A.S. DI GUARRO C. & C	Singola	03144680653	26/03/2022 13:26
2	CARDIOLINE S.P.A.	Singola	03153711209	28/03/2022 08:49
3	MEDISOL S.R.L.	Singola	06713240635	25/03/2022 10:40
4	MORTARA INSTRUMENT EUROPE	Singola	00673881207	28/03/2022 09:56
5	GM. MEDICA SRL	Singola	05025691212	24/03/2022 16:05
6	MORETTI S.P.A.	Singola	00306090515	24/03/2022 12:02
7	A.G.A. BIOMEDICA SRL	Singola	01128810650	28/03/2022 09:39
8	SEAB INSTRUMENTS SRL	Singola	01403831009	25/03/2022 15:38
9	ALEA S.A.S.	Singola	05067060011	25/03/2022 14:58
10	ELMED SERVICE SRL	Singola	04763721216	25/03/2022 17:05
11	SIDEM	Singola	00833160963	25/03/2022 15:48
12	SERVIZI OSPEDALIERI SRL	Singola	08815051217	28/03/2022 11:55

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	16/05/2022 12:52:24	30/06/2022

12:16:00

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
M.TEK S.A.S. DI GUARRO C. & C		nessuna		nessuna
CARDIOLINE S.P.A.		nessuna		nessuna
MEDISOL S.R.L.		nessuna		nessuna
MORTARA INSTRUMENT EUROPE		nessuna		nessuna
GM. MEDICA SRL		nessuna		nessuna
MORETTI S.P.A.		nessuna		nessuna
A.G.A. BIOMEDICA SRL		nessuna		nessuna
SEAB INSTRUMENTS SRL		nessuna		nessuna
ALEA S.A.S.		nessuna		nessuna
ELMED SERVICE SRL		nessuna		nessuna
SIDEM		nessuna		nessuna
SERVIZI OSPEDALIERI SRL		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	art. 15 - Contenuto della Busta A	
	Valutazione	Note
M.TEK S.A.S. DI GUARRO C. & C	Approvato	nessuna
CARDIOLINE S.P.A.	Approvato	nessuna
MEDISOL S.R.L.	Approvato	nessuna
MORTARA INSTRUMENT EUROPE	Approvato	nessuna
GM. MEDICA SRL	Approvato	nessuna
MORETTI S.P.A.	Approvato	nessuna
A.G.A. BIOMEDICA SRL	Approvato	nessuna
SEAB INSTRUMENTS SRL	Approvato	nessuna
ALEA S.A.S.	Approvato	nessuna
ELMED SERVICE SRL	Approvato	nessuna

SIDEM	Approvato	nessuna
SERVIZI OSPEDALIERI SRL	NON Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	01/08/2022 10:31:51	20/09/2022 12:09:57

Concorrente	art. 16 - Contenuto della Busta B	
	Valutazione	Note
M.TEK S.A.S. DI GUARRO C. & C	Approvato	nessuna
CARDIOLINE S.P.A.	Approvato	nessuna
MEDISOL S.R.L.	Approvato	nessuna
MORTARA INSTRUMENT EUROPE	Approvato	nessuna
GM. MEDICA SRL	Approvato	nessuna
MORETTI S.P.A.	Approvato	nessuna
A.G.A. BIOMEDICA SRL	Approvato	nessuna
SEAB INSTRUMENTS SRL	Approvato	nessuna
ALEA S.A.S.	Approvato	nessuna
ELMED SERVICE SRL	Approvato	nessuna
SIDEM	Approvato	nessuna
SERVIZI OSPEDALIERI SRL	NON Valutato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	20/09/2022 12:16:24	20/09/2022 12:36:45

Concorrente	Offerta Economica (fac- simile di sistema)		art. 17 - Contenuto della Busta C	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
M.TEK S.A.S. DI GUARRO C. & C	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
CARDIOLINE S.P.A.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MEDISOL S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

MORTARA INSTRUMENT EUROPE	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
GM. MEDICA SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MORETTI S.P.A.	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
A.G.A. BIOMEDICA SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
SEAB INSTRUMENTS SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ALEA S.A.S.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ELMED SERVICE SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
SIDEM	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
SERVIZI OSPEDALIERI SRL	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna


Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
MORETTI S.P.A.	Concorrente escluso				
SERVIZI OSPEDALIERI SRL	Concorrente escluso				
A.G.A. BIOMEDICA SRL	58300,00000000	0,00	62,00	23,50	85,50
M.TEK S.A.S. DI GUARRO C. & C	45672,00000000	0,00	55,00	30,00	85,00
MORTARA INSTRUMENT EUROPE	84348,00000000	0,00	67,00	16,24	83,24
CARDIOLINE S.P.A.	155540,00000000	0,00	70,00	8,81	78,81
MEDISOL S.R.L.	85800,00000000	0,00	61,00	15,97	76,97
SEAB INSTRUMENTS SRL	95040,00000000	0,00	61,00	14,42	75,42
GM. MEDICA SRL	82500,00000000	0,00	49,00	16,61	65,61
ELMED SERVICE SRL	104500,00000000	0,00	48,00	13,11	61,11

SIDEM	70642,00000000	0,00	38,00	19,40	57,40
ALEA S.A.S.	74536,00000000	0,00	39,00	18,38	57,38

Note di gara	<p>Il RUP procede alla verifica della documentazione pervenuta a seguito del soccorso istruttorio e rileva quanto segue: l'integrazione documentale prodotta dalla società SERVIZI OSPEDALIERI SRL non risulta essere rispondente a quanto richiesto dall'art. 15 del Disciplinare di Gara in merito al contenuto della "Busta A – Documentazione Amministrativa" in particolare non sono stati prodotti i seguenti documenti firmati digitalmente: - Domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 2.A; - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); - Attestazione del pagamento del contributo a favore dell'ANAC di € 20,00. In conclusione, il RUP decide di escludere il concorrente SERVIZI OSPEDALIERI SRL.</p>
Note specifiche lotto 1	<p>LA SOCIETA' MORETTI S.P.A., CON IL PRODOTTO OFFERTO MARCA EDAN MODELLO SE1200 EXPRESS, E' STATA ESCLUSA DALLE FASI SUCCESSIVE DI GARA IN QUANTO, DALLA VALUTAZIONE QUALITATIVA EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, NON RAGGIUNGE LA SOGLIA DEI 36 PUNTI MINIMI COSI' COME PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA.</p>



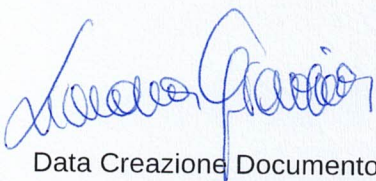



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

**FORNITURA DI N.22 ELETTROCARDIOGRAFI DI ALTA FASCIA PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO. –
AGGIUDICAZIONE [CIG:91402851CC]**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €71.126,00

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 10/10/2022

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito