



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 473 del 29/04/2025

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: FORNITURA IN URGENZA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA EX D.LGS. N.36/2023 E SMI DI N. 2 CIRCUITI ECMO DA UTILIZZARE TRAMITE L'APPARECCHIATURA IN DOTAZIONE ALLA UOC CARDIOCHIRURGIA – AGGIUDICAZIONE DITTA

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 29/04/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: FORNITURA IN URGENZA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA EX D.LGS. N.36/2023 E SMI DI N. 2 CIRCUITI ECMO DA UTILIZZARE TRAMITE L'APPARECCHIATURA IN DOTAZIONE ALLA UOC CARDIOCHIRURGIA – AGGIUDICAZIONE DITTA

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- il Direttore della UOC Cardiocirurgia, Dott. Andrea Montalto, con Prot. 13263 del 16/04/2025 (allegato n.1) indirizzato - tra l'altro - alla UOC scrivente ha richiesto, nell'iter dell'espletamento della procedura telematica l'acquisto "*urgentissimo di n. 2 Circuiti ECMO per Assistenza Cardiopolmonare a medio termine*", quali dispositivi salvavita, indispensabili per il trattamento

di un paziente, evidenziando che per ogni singola procedura cosiddetta "salvavita" occorrono "*almeno 2 circuiti*";

-la Direzione Sanitaria Aziendale ha validato la richiesta in questione (già allegato n.1);

TENUTO CONTO delle circostanze sopraesposte, in data 17/04/2025 è stata attivata iniziativa diretta di acquisto sulla piattaforma MEPA (RDO n. 5294142) per la fornitura in parola nei confronti della Ditta Getinge Italia Spa., iscritta alla categoria merceologica "altri dispositivi medici", invitandola a produrre offerta per l'importo complessivo presunto di € 16.000,00, oltre Iva al 22%;

DATO ATTO CHE entro il termine previsto (23/04/2025 – ore 09:00), la Ditta interpellata ha riscontrato l'invito, giusta consultazione della piattaforma in uso;

ATTESO CHE al fine di assicurare la correttezza dell'istruttoria *de qua*, è stato acquisito – su richiesta del Servizio scrivente – l'esito positivo della verifica di conformità effettuata, previa disamina della scheda tecnica (mail del 24/04/2025 – agli atti), dal Direttore ff della UOC Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia (allegato n.2);

VISTA l'offerta economica prodotta - tramite piattaforma MEPA - dalla stessa Ditta, da cui emerge che il prezzo complessivo proposto ammonta ad € 15.800,00 oltre Iva al 22% (prezzo unitario € 7.900,00 scontato del 29,43% sul prezzo di listino – allegato n. 3);

CONSIDERATO CHE l'acquisizione a farsi, pendente il termine per la presentazione delle offerte (02/05/2025 – ore 12.00) riferite alla nuova procedura di gara indetta (Del. DG n. 362/2025 - RDO n. 5294930 - lotto unico) per l'affidamento della fornitura annuale di n.25 Circuiti monopaziente per assistenza cardiopolmonare a medio termine (ECMO) da eseguire secondo la modalità della somministrazione periodica, con comodato d'uso di n. 2 Sistemi hardware per assistenza cardiopolmonare, assicura la continuità assistenziale;

VISTI gli artt. 17, comma 5, 25, 50, comma 1, lett. b) e 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Deliberazione del Direttore Generale

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

RITENUTO pertanto di prendere atto dell'esito dell'iniziativa di acquisto effettuata sulla piattaforma MEPA (RDO n. 5294142 – CIG n. B69B8957F3) e, per l'effetto, di affidare (art. 50, comma 1, lett. b D.Lgs. n.36/2023 e smi.) alla Ditta Getinge Italia Spa. la fornitura di n. 2 circuiti per assistenza ECMO da utilizzarsi sulla strumentazione in dotazione alla UOC Cardiocirurgia per l'importo complessivo di € 15.800,00 oltre Iva al 22%, secondo la configurazione descritta in offerta;

ATTESTATO che la presente proposta di deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conforme alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;

PROPONE

I - DI PRENDERE ATTO dell'esito dell'iniziativa di acquisto effettuata sulla piattaforma MEPA (RDO n. 5294142 – CIG n. B69B8957F3) e, per l'effetto, di affidare (art. 50, comma 1, lett. b D.Lgs. n.36/2023 e smi.) alla Ditta Getinge Italia Spa. la fornitura di n. 2 circuiti per assistenza ECMO da utilizzarsi sulla strumentazione in dotazione alla UOC Cardiocirurgia per l'importo complessivo di € 15.800,00 oltre Iva al 22%, secondo la configurazione descritta in offerta;

II - DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 19.276,00, Iva compresa, sul conto economico n. 5010107010 "Dispositivi medici" al bilancio 2025;

III - DI DARE ATTO che il RUP è il Dott. Roberto Delfino, Dirigente UOC Provveditorato ed Economato ed il DEC è la Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia, Direttore ff della Farmacia o suo delegato;

IV - DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento alla Ditta Getinge Italia Spa.;

V - DI PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e smi, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

VI - DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Cardiocirurgia e Farmacia Ospedaliera;

VII - DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'esigenza improcrastinabile di garantire tramite l'impiego dei dispositivi in questione la continuità assistenziale.

L'estensore

Dott.ssa Agnese Basilicata

Il Direttore

UOC Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Teresa Capobianco

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico Favorevole

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara Favorevole

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

I - PRENDERE ATTO dell'esito dell'iniziativa di acquisto effettuata sulla piattaforma MEPA (RDO n. 5294142 – CIG n. B69B8957F3) e, per l'effetto, di affidare (art. 50, comma 1, lett. b D.Lgs. n.36/2023 e smi.) alla Ditta Getinge Italia Spa. la fornitura di n. 2 circuiti per assistenza ECMO da utilizzarsi sulla strumentazione in dotazione alla UOC Cardiocirurgia per l'importo complessivo di € 15.800,00 oltre Iva al 22%, secondo la configurazione descritta in offerta;

II - IMPUTARE la spesa complessiva di € 19.276,00, Iva compresa, sul conto economico n. 5010107010 "Dispositivi medici" al bilancio 2025;

III - DARE ATTO che il RUP è il Dott. Roberto Delfino, Dirigente UOC Provveditorato ed Economato ed il DEC è la Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia, Direttore ff della Farmacia o suo delegato;

IV - NOTIFICARE copia del presente provvedimento alla Ditta Getinge Italia Spa.;

V - PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e smi, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

VI - TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Cardiocirurgia e Farmacia Ospedaliera;

VII - RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'esigenza improrogabile di garantire tramite l'impiego dei dispositivi in questione la continuità assistenziale.

Il Direttore Generale

Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



Dipartimento Cardiovascolare
U.O.C. Cardiochirurgia

REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"

CASERTA

all. M.1

DIRETTORE

Dott. Andrea Montalto

Tel. +39 0823232490

Dirigenti Medici

Dott. Girolamo Domiani

Dott. Matteo Galati

Dott. Rosario Gregorio

Dott. Gennaro Ismeno

Dott. Agostino La Marca Giordano

Dott. Joseph Marmo

Dott. ssa. Raffoella Provenzano

Coordinatore Infermieristica

Salin Operatoria Tel. +39 0823232545

Reparto Tel. +39 0823232624

Ambulatorio +39 0823232617

Alla Dott. Ssa Angela Anecchiarico

Direttore sanitario

Alla Dott. ssa Teresa Capobianco

Direttore UOC Provveditorato

Alla Responsabile Servizio Farmacia

Dott. ssa Maria Dezia Bisceglia

OGGETTO: Richiesta urgente Circuiti ECMO

Il sottoscritto, Dott. Andrea Montalto, nelle more del completamento della Procedura negoziata per la fornitura annuale di 25 circuiti per Assistenza Cardiopolmonare (ECMO)

CHIEDE

l'acquisto urgentissimo di **n.2 Circuiti ECMO cod. BE HLS 7050 (SIAC 459229)**, dedicati alle macchine Maquet CardioHelp in dotazione alla cardiochirurgia.

Si comunica che attualmente c'è un paziente in assistenza ECMO (Cartella clinica paziente n. 2025005963) e che trattandosi una procedura salvavita (in quanto i suddetti sistemi vicariano le funzioni cardiache e polmonari) sono necessari almeno 2 circuiti per ogni procedura in corso da utilizzare in caso di malfunzionamento del dispositivo.

Caserta, 16/04/2025

Il Direttore
UOC Cardiochirurgia



all m.2

RICHIESTA CONFORMITA'**Da** provveditorato@ospedale.caserta.it <provveditorato@ospedale.caserta.it>**A** [accettazionefarmacia](mailto:accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it) <accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it>**Data** giovedì 24 aprile 2025 - 11:32

Atteso che il Direttore della UOC Cardiochirurgia, Dott. Andrea Montalto, non ha riscontrato la richiesta di conformità circa i dispositivi in oggetto, si chiede a codesta Farmacia di procedere a tanto.
Si allega in copia scheda tecnica
Restasi in attesa di immediata risposta

*U.O.C. Provveditorato ed Economato
AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta
Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it
PEC: provveditorato@ospedalecasertapec.it*

scheda_tecnica_BE HLS 7050_Livello1.pdf

Kit di Assistenza Cardiocircolatoria e Polmonare**HLS SET ADVANCED trattato Bioline****Cod. BE HLS 7050**

*ciruito
all forme
M. Braghe*

DESCRIZIONE: Kit ossigenante per procedure ECMO

STERILIZZAZIONE: a) Tipo: Ossido di etilene
b) Validità: 1 anno

CLASSE DI APPARTENZA: III

MARCHIO CE: 50008-16-10

ORGANISMO NOTIFICATO: DEKRA - 0124

PRODUTTORE: Maquet Cardiopulmonary GmbH
Kehler Straße, 31
76437 Rastatt, Germania

CONFEZIONAMENTO: Singola confezione sterile
Vassoio
Scatola esterna
Libretto informativo
Etichette descrittive

UNITA' VENDIBILE: 1 unità

CND: C03010301

REPERTORIO: 346395

CODICE UDI: 04058863005744


CODICE SAP: 701069073

REVISIONE: 1.2 del 12/24

Società a socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di GETINGE AB. Capitale sociale: Euro 1.020.000
Codice Fiscale/Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 03992220966.
Codice ID PEPPOL 0211:IT03992220966

Il kit per assistenza cardiocircolatoria e polmonare prodotto dalla Maquet Cardiopulmonary , è un sistema costituito dai seguenti componenti:

- HLS Module Advanced
- Rivestimento BIOLINE (rivestimento di eparina e albumina)
- Raccordi dei tubi flessibili

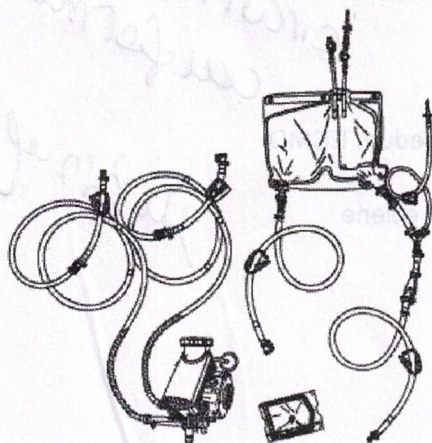

E' concepito per l'utilizzo in ECMO con cannulazione artero-venosa o veno-venosa.

E' un prodotto con **Marchio CE** per l'utilizzo continuativo fino a **30 giorni se utilizzato con le cannule HLS con rivestimento BIOLINE.**

Se utilizzato con cannule di altro produttore, la durata d'impiego massima di HLS Set Advanced è di 6 ore.

Il kit HLS Set Advanced può essere utilizzato per i trasferimenti intraospedalieri e interospedalieri.

Il kit "HLS SET ADVANCED" è pronto all'uso e comprende:

- Linee in PVC no DEHP aventi differenti caratteristiche e funzioni contrassegnate da codice colore allo scopo di offrire agli operatori una rapida individuazione sul campo operatorio
- Pompa centrifuga con ossigenatore e scambiatore di calore integrato da 7 l
- Connettori in policarbonato (unica fusione)
- Connettori a baionetta
- Rubinetti a due e tre vie
- Siringa da 50 ml
- Forbici
- Clamp
- Softbag 1900 ml
- Linea gas con filtro antibatterico

QUESTO CIRCUITO E' LATEX FREE

Sensori pressione	-500 ÷ 900 mmHg
Sensori temperatura	15 ÷ 45 °C

Il kit *HLS SET ADVANCED* è realizzato con i seguenti materiali:

Housing	Policarbonato
Fibre per ossigenanti	Polimetilpentene
Fibre dello scambiatore di calore	Poliuretano
Pompa centrifuga	Polietilene e sfera in zaffiro
Sensori di pressione	Gel in silicone, polisulfone
Linee (arteria, vena e deflussori)	PVC
Connettori	Policarbonato

Confezione singola contenente N°1 pz

Confezionamento Primario:

Vaschetta sterile : polistirolo con chiusura in Tyvek

Confezionamento Secondario:

Imballo di cartone: cartone, cartone ondulato


CONDIZIONI di CONSERVAZIONE: Il prodotto viene fornito sterile e privo di pirogeni. La sterilità rimane garantita fino a quando la confezione non viene aperta o danneggiata e non viene superata la data di scadenza. Il prodotto deve essere conservato al buio, in luogo fresco ed asciutto fino al momento del suo utilizzo.

Temperatura di stoccaggio prescritta: +10°C ... +30°C

Trattamento superficiale BIOLINE

Tutti i componenti del circuito sono sottoposti al trattamento Bioline.

Il trattamento Bioline, esclusivo della Maquet Cardiopulmonary, rende bioattive le superfici che entrano in contatto con il sangue.

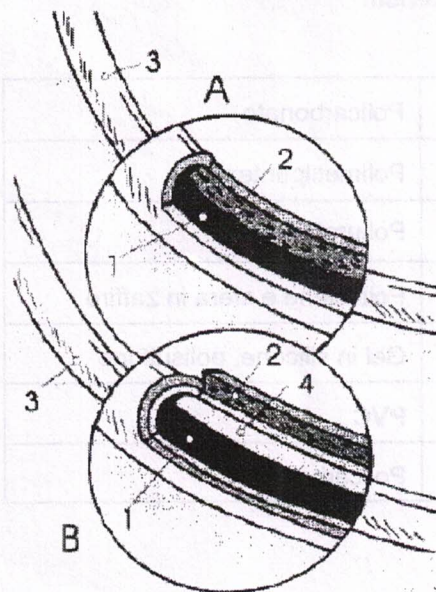

Il trattamento Bioline è infatti applicabile a tutti i componenti della circolazione extracorporea quali ossigenatore, pompa centrifuga, cardioto, filtro e tubi. Il trattamento Bioline è a base di eparina che viene legata con le superfici di contatto per mezzo di un legame chimico di tipo covalente, pertanto fortemente stabile. Nei prodotti trattati Bioline i dati clinici mostrano una riduzione dell'attivazione del complemento, degli indici infiammatori, della deplezione e aggregazione piastrinica e degli indici di emolisi.

I prodotti trattati Bioline riducono inoltre la trombogenesi e l'adesione leucocitaria.

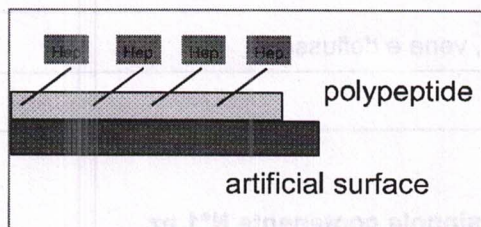


Figura A

- 1: sangue
- 2: tubo interno
- 3: tubo esterno

Figura B


- 1: sangue
- 2: tubo interno
- 3: tubo esterno
- 4: rivestimento Bioline

HLS Set Advanced 7.0 / HIT Set Advanced 7.0

O₂ Transfer

37 °C


Gas-blood flow ratio 1:1

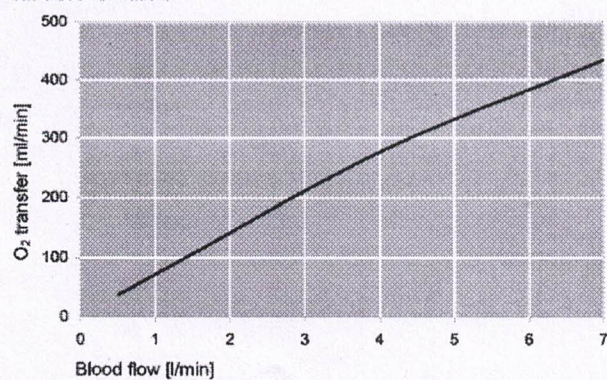


CO₂ Transfer

37 °C


Gas-blood flow ratio 1:1

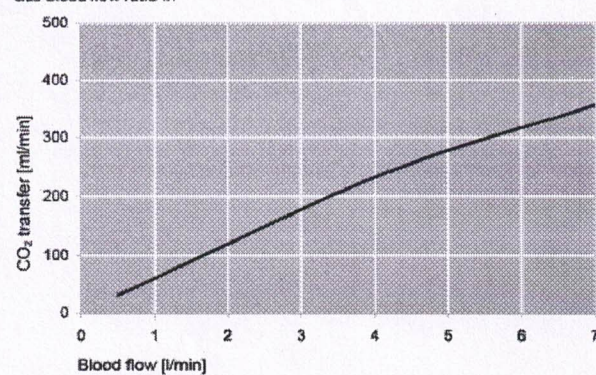

Pressure Drop Oxygenator

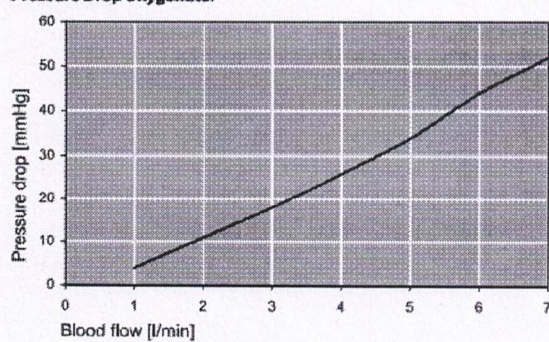


Hydraulic Performance

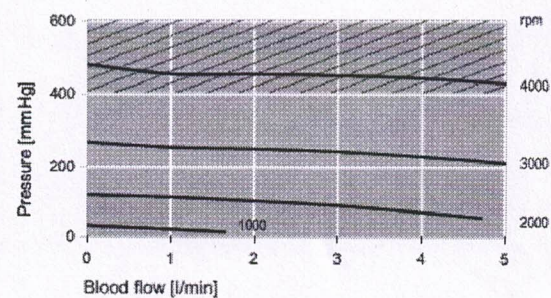


Heat Exchanger Performance

ISO 7199 Standard, 37 °C

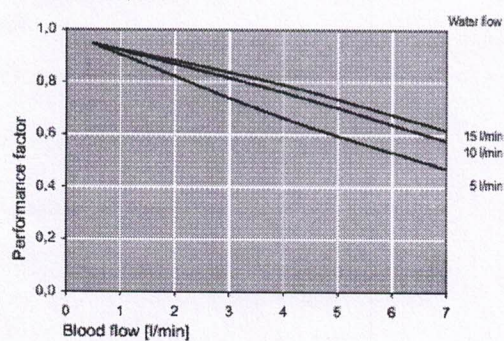

HLS Module Advanced con trattamento Bioline

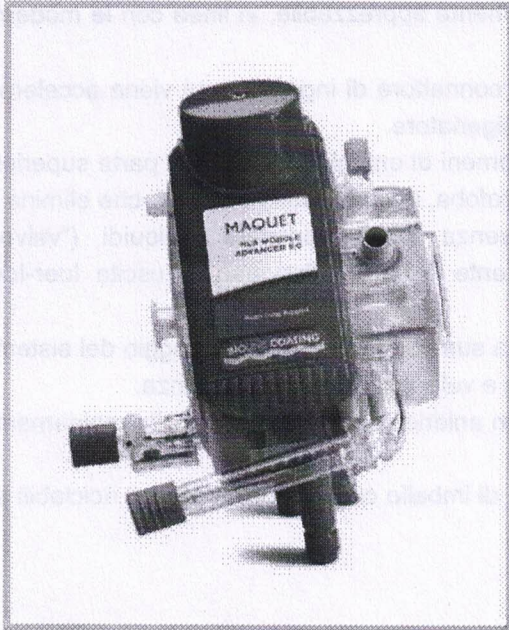

Il modulo HLS advanced è una pompa VAD (Ventricular Assist Device) con possibilità di ossigenazione. E' costituito da una pompa centrifuga omologata appositamente per l'impiego prolungato, un ossigenatore e uno scambiatore di calore con cui è possibile portare il sangue alla temperatura desiderata.

Nel modulo HLS sono integrati 3 sensori di pressione ed un sensore di temperatura del sangue arterioso.

Il comparto ossigenante è costituito da una membrana continua in polimetilpentene scambiante per diffusione e da uno scambiatore di calore in poliuretano.

La pompa VAD è una pompa centrifuga il cui rotore è sospeso in un campo magnetico. La geometria della pompa VAD è di tipo radiale e (sistema a trottola), tale principio comporta minor attrito del rotore interno e quin


di una minima generazione di calore.

La pompa VAD al suo ingresso è dotata di una cella per la misurazione venosa della saturazione venosa di ossigeno, dell'emoglobina, dell'ematocrito e della temperatura venosa del sangue.

Tutte le superfici interne componenti HLS Set sono sottoposte al **trattamento Bioline**, esclusivo della Maquet Cardiopulmonary. Tale trattamento si lega in maniera stabile alle superfici trattate, rendendole idrofile ed aumentandone la biocompatibilità. Il trattamento Bioline, inoltre, previene il fenomeno dell'aumento della pressure drop che si può riscontrare all'inizio della circolazione extracorporea.

La membrana ossigenante ha una superficie di $1,8 \text{ m}^2$, mentre la superficie dello scambiatore di calore è pari a $0,4 \text{ m}^2$. La disposizione delle fibre di membrana è stata appositamente studiata per ridurre al minimo il volume di riempimento statico, che, grazie alla presenza della campana integrata è di soli **273 ml**.

Lo scambio dei gas avviene per diffusione molecolare ed è regolato dal gradiente di concentrazione tra i gas. La membrana ossigenante, di tipo continuo, costituisce una naturale

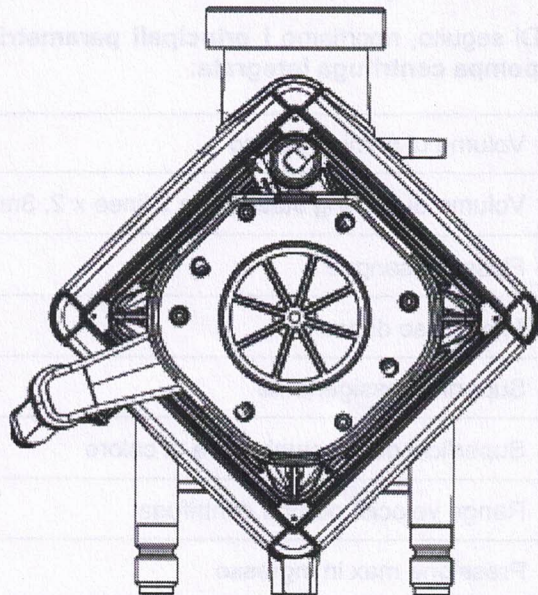

barriera tra sangue e gas. Non possono perciò verificarsi perdite di plasma. La fluidodinamica dell'ossigenatore crea un incrocio di flussi fra acqua, aria e sangue che garantisce lo scambio termico e gassoso con un'eccellente performance e una gestione ideale da parte dell'operatore.

Il sistema ossigenante risulta quindi essere particolarmente apprezzabile, in linea con le moderne tecniche di normo e/o ipotermia.

Il sangue entra nella pompa centrifuga attraverso un connettore di ingresso, qui viene accelerato dai quattro canali di flusso presenti e spinto verso l'ossigenatore.

Per aumentare la sicurezza nella prevenzione dei fenomeni di embolia gassosa, la parte superiore del sistema ossigenante è dotata di una membrana idrofoba, impermeabile ai liquidi, che elimina in continuo eventuale aria presente nel sangue, senza lasciar passare i liquidi ("valvola autoventante"). La membrana comunica con l'ambiente esterno attraverso un'uscita luer-lock munita di tappino giallo removibile.

Grazie alle dimensioni estremamente contenute ed alla sua compattezza, il montaggio del sistema sul modulo pompa risulta essere particolarmente facile e veloce, anche in emergenza.

HLS Module non ha bisogno di lavaggio preventivo con anidride carbonica, si debolla rapidamente (in soli 3 minuti) e con facilità.

HLS SET ADVANCED viene fornito in una confezione di imballo costituita da materiali riciclabili ed ecologici.

Di seguito, riportiamo i **principali parametri del modulo HLS ADVANCED con campana per pompa centrifuga integrata**:

Volume di priming statico	273 ml
Volume di priming statico con 2 linee x 2, 3m	600 ml
Flusso di sangue	da 0,5 a 7 l/min
Max flusso di gas	15 l/min
Superficie ossigenante	1,8 m ²
Superficie dello scambiatore di calore	0,4 m ²
Range velocità pompa centrifuga	0 – 5000 rpm
Pressione max in ingresso	750 mmHg
Connettori IN e OUT sangue	3/8"
Connettore linea ricircolo	1/4"
Connettore IN e OUT gas	1/4"
Connettori acqua	1/2"

all. M. 3

nome nazionalità produttore _____
Maquet Cardiopulmonary GmbH
Rastatt, Germania

dittaGETINGE ITALIA SRL
Partita iva_03992220966

101953

SCHEDA OFF. ECONOMICA - ALL. A
25TD6655CP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Descrizione prodotto	Codice prodotto Fornitore	Codice prodotto Produttore (Fabbricante) REF	codice CND	Numero Identificativo Iscrizione Repertorio Dispositivi Medici	Unità di misura	Quantità	prezzo di listino 2025 €	% di sconto praticato sul prezzo di listino	prezzo unitario offerto	Aliquota IVA %	Importo Totale Prodotto
Kit ossigenante per procedure ECMO	701069073	BE HLS 7050	C03010301	346395	Pz in Singola confezione sterile	2	11.165,00	29,243	7.900,00	22%	15.800,00

Cinisello Balsamo 22/04/2025

Roberto Chareun
Getinge Italia srl
Legale rappresentante



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto:

**FORNITURA IN URGENZA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA EX D.LGS. N.36/2023 E SMI DI N. 2 CIRCUITI
ECMO DA UTILIZZARE TRAMITE L'APPARECCHIATURA IN DOTAZIONE ALLA UOC CARDIOCHIRURGIA –
AGGIUDICAZIONE DITTA**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €19.276,00

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 28/04/2025

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito